



# ЭТАЛОН

АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

II часть

КИП I ПИРОМЕТРЫ I ФИЛЬТРЫ НА ПАВ



АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**«ЭТАЛОН»**

**МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**БЕСПРОВОДНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ**

**КИП. ПИРОМЕТРЫ**

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Часть II

Омск 2022



# СОДЕРЖАНИЕ

Услуги по пуско-наладке оборудования. Услуги цеха по ремонту КИП.....	4
Руководство АО «НПП «Эталон» .....	5
Правила продаж.....	5
Предприятие имеет лицензии на специальный вид деятельности. ....	6
Дилеры АО «НПП «Эталон» .....	6

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ..... 7

### ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ..... 7

Сравнительные характеристики ИТП и ИТПМ .....	7
Измерители температуры портативные ИТП .....	8
Измерители температуры портативные микропроцессорные ИТПМ .....	9
Измерители температуры портативные микропроцессорные ИТПМ2.....	11
Измерители температуры портативные ИТПМ (ИТП) с комплектом датчиков в чемодане.....	15
Измерители температуры портативные цифровые ИТПЦ .....	17
Измерители параметров среды стационарные ИПСС .....	18
Датчики влажности и температуры выносные ДВВ .....	19
Измерители температуры ИТ-3 .....	20
Измерители температуры ИТ-4 .....	21
Многоканальные измерители температуры МИТ-12 .....	22
Система измерения температуры СИТ.....	24

### ИЗМЕРИТЕЛИ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОвого ПОТОКА И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ..... 25

Датчики теплового потока ДТП 0924 .....	25
Измерители температуры многоканальные ИТ-6 .....	26
Измерители температуры многоканальные МИТ .....	28
Измерители физических величин многоканальные МИФВ .....	29
Измерители теплофизических величин ИТВ.....	30
Программное обеспечение для измерителей теплофизических величин ИТВ.....	31
Измерители плотности теплового потока и температуры ИТП-11 .....	33

### РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ..... 34

сравнительная таблица регуляторов температуры .....	34
Регуляторы температуры РТМ-3 .....	35
Микропроцессорные регуляторы температуры РТ2М .....	37
Микропроцессорные регуляторы температуры РТ-10 .....	39
Микропроцессорные регуляторы температуры РТ-5.....	41
4-х канальные регуляторы температуры РТМ-4К .....	42
Блоки управления БУ-7 (двенадцать модификаций) .....	44

### ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ И РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ..... 51

Устройства компенсации УК, УК-3.....	51
Преобразователи интерфейса RS-232/RS-485 .....	51



<b>БЕСПРОВОДНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.....</b>	<b>52</b>
Преобразователи интеллектуальные с радиомодемом ПИ РМ .....	52
<b>ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ.....</b>	<b>54</b>
Преобразователи измерительные ПИ 1601-ТС-4-20 с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА ...	54
<b>ПИРОМЕТРЫ .....</b>	<b>56</b>
Сравнительная таблица пирометров.....	56
Рекомендации по подбору расстояния до объекта контроля при измерении температуры пирометрами ..	56
Пирометры портативные серии ПП-1.....	57
Пирометры прецизионные серии ПД-4.....	58
Пирометры ПД-9-01.....	60
Пирометры ПТ-1 .....	61
Пирометры серии СТ-2.....	62
Пирометры оптоволоконные серии ПД-5.....	63
Пирометры оптоволоконные серии ПД-6.....	64
Пирометры оптоволоконные серии ПД-7.....	66
Пирометры-регуляторы оптоволоконные серии ПД-10.....	67
<b>ИК-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВЫХ СРЕД И РАСПЛАВОВ МЕТАЛЛОВ .....</b>	<b>68</b>
ИК-термопреобразователи стационарные ИКТС.....	68
ИК-термопреобразователи переносные ИКТП.....	70

## **МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .....**

**73**

<b>ЭТАЛОННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ.....</b>	<b>74</b>
Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые эталонные ППО .....	74
Преобразователи термоэлектрические платинородиевые эталонные ПРО .....	75
Эталонные термометры сопротивления ТСП 0307 .....	76
Эталонные термометры сопротивления ЭТС-100М1, ЭТС-100М3 3-го разряда .....	77
<b>УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЕРКИ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ.....</b>	<b>78</b>
Установка для поверки и градуировки датчиков температуры УПСТ-2М .....	78
Автоматизированное рабочее место для поверки термометров сопротивления АРМ ПТС .....	80
<b>ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ.....</b>	<b>81</b>
Измерители универсальные прецизионные В7-99 .....	81
Сервисное программное обеспечение для измерителя В7-99.....	83
<b>КРИОСТАТЫ, ТЕРМОСТАТЫ, ПЕЧИ.....</b>	<b>85</b>
Криостат КР -190.....	85
Высокопроизводительный регулируемый криостат КР -80 .....	86
Криостат КР -40-2.....	87
Термостаты нулевые ТН-1М, ТН-2М, ТН-3М .....	88
Термостат паровой ТП-2 .....	88
Термостат регулируемый ТР 20.....	89
Термостат регулируемый ТР-1М .....	89
Термостат сухоблочный ТС 600-2 .....	91
Малоинерционная трубчатая печь с терморегулятором МТП-2МР.....	92
Печь шаровая ПШ 1200.....	93
Высокотемпературная печь ВТП 1600-1 .....	94
Высокотемпературная печь ВТП 1800-1 .....	95
Малоинерционная трубчатая печь МТП 1200 .....	96



<b>КАЛИБРАТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ .....</b>	<b>97</b>
Калибраторы температуры сухоблочные КС 100-1, КС 600-1.....	97
Калибраторы температуры сухоблочные КС 1200-2 <i>разработка</i> .....	<i>99</i>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ .....</b>	<b>100</b>
Кассета для поверки стеклянных термометров .....	100
Камера вытяжная КВ-1 (КВ-1В) .....	100
Штатив для термопреобразователей.....	100
Устройство для дробления льда УДЛ-2 .....	101
Термостаты поверхностные ТПВ-2М, ТПВ-3, ТПВ-4, БВП-01 .....	101
Блоки выравнивающие для печей МТП-2МР .....	102
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РЕПЕРНЫХ ТОЧЕК ТЕМПЕРАТУРНОЙ ШКАЛЫ МТШ-90</b>	<b>103</b>
Печи для реализации реперных точек температурной шкалы МТШ-90 ПРТ 50-700, ПРТ 600-1100-2 .....	103
Отжиговая печь ОП 700-1 .....	104
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ ПИРОМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ .....</b>	<b>105</b>
Эталонный пирометр 1 разряда ПД-4-06.....	105
Эталонный пирометр 1 разряда ПД-9-02.....	106
<b>АБСОЛЮТНО ЧЕРНЫЕ ТЕЛА (АЧТ).....</b>	<b>107</b>
Излучатель в виде модели абсолютно черного тела АЧТ 70/-40/80 .....	107
Излучатели в виде модели абсолютно черного тела АЧТ-165/40/100 и АЧТ-45/100/1100 .....	108
Излучатель в виде модели абсолютно черного тела АЧТ-30/900/2500 .....	110
Излучатель в виде модели абсолютно черного тела АЧТ 75/50/600 <i>разработка</i> .....	<i>112</i>
Излучатель в виде модели протяженного черного тела ПЧТ-540/40/100.....	113
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ.....</b>	<b>115</b>
Объект-микрометр ОМ-О, ОМ-П.....	115
<b>ФИЛЬТРЫ НА ПАВ .....</b>	<b>117</b>
Фильтры на ПАВ .....	117
<b>ПАВ-МИКРОСБОРКИ.....</b>	<b>122</b>
Микросборка 04КП015.....	122
Микросборка 04ХА042.....	123
<b>НАБОРЫ ЭТАЛОННЫХ МЕР СВЧ ДИАПАЗОНА .....</b>	<b>124</b>
Набор мер КСВН и полного сопротивления 1 разряда ЭК9-140.....	124

#### **УСЛУГИ ПО ПУСКО-НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

АО «НПП «Эталон» производит услуги по пуско-наладке следующих приборов:

- излучатель в виде модели АЧТ-30/900/2500;
  - автоматизированное рабочее место поверки термометров сопротивления АРМ ПТС;
  - установка УПСТ-2М;
  - криостат К -40-2
  - система температурного мониторинга СТМ;
  - система измерения температуры СИТ;
- а так же приборов и изделий, приобретенных на нашем предприятии с последующим объединением их в общую сеть или систему.

#### **УСЛУГИ ЦЕХА ПО РЕМОНТУ КИП**

Цех по ремонту КИП является крупным центром по ремонту сложных электроизмерительных приборов; электронных и механических весов от лабораторных до автомобильных, дозаторных установок, испытательных машин, прессов, копров, твердомеров. Осуществляем монтаж и модернизацию весов. У нас Вы сможете отремонтировать практически любое по сложности оборудование, а также получить консультации по вопросам правильной эксплуатации.

По согласованию с заказчиком возьмем на себя ответственность по сдаче отремонтированных средств измерений ФГУ «Омский центр стандартизации, метрологии и сертификации».

**Осуществляем продажу:**

**весов, торговых гирь, манометров в наличии и под заказ.**

**Цех по ремонту КИП АО "НПП "Эталон" - тел. (3812) 58-40-88; адрес: 10 Лет Октября, 207 Б**



## РУКОВОДСТВО АО «НПП «ЭТАЛОН»

Генеральный директор	- Кропачев Денис Юрьевич	тел.: 36-84-00
Зам. генерального директора	- Бойцов Сергей Владимирович	тел.: 32-80-50
Главный инженер	- Айзикович Евгений Вельевич	тел.: 36-77-46
Зам. генерального директора по производству	- Шевелев Юрий Валентинович	тел.: 36-95-92
Приемная	- Перышкина Вера Ивановна	тел.: 36-84-00
И.О. начальника отдела маркетинга	- Койлыбаева Мария Тимуровна	тел.: 36-94-53, 36-79-18
Начальник СКБ	- Малышев Юрий Олегович	тел.: 36-99-67
Начальник отдела управления качеством	- Нельднер Светлана Владимировна	тел.: 36-95-92
Начальник ОМТС	- Малинин Юрий Анатольевич	тел.: 36-90-11
Мастер цеха по ремонту КИП	- Неизвестных Алеся Александровна	тел.: 58-40-88

Адрес цеха по ремонту КИП: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 207 Б  
Код АТС г. Омска - 3812

## ПРАВИЛА ПРОДАЖ

### Условия оплаты и сроки изготовления

Предпочтительно: предоплата 100%. Иные условия оговариваются в индивидуальном порядке;

Сроки изготовления зависят от вида заказываемой продукции и указываются в коммерческом предложении и/или счете в рабочих днях с момента поступления авансового платежа;

### Сроки обработки заявок

Если по заявке не требуются уточнения, то, как правило, в течение 1 – 2 рабочих дней с момента поступления заявки направляется коммерческое предложение. В отдельных случаях, когда необходима проработка заявки специалистами СКБ (продукция по индивидуальным требованиям заказчика), до 7 рабочих дней.

### Заказы на продукцию с отступлениями от документации или новую продукцию

Если требуется небольшая корректировка, то заказ выполняется по несколько увеличенной цене. Размер наценки определяется трудоемкостью корректировок, необходимой оснастки и наличием материалов.

В случае необходимости разработки полного комплекта документации, сроки и цены устанавливаются в каждом случае отдельно.

### Цены

Цены фиксированы. В случае изменения стоимости материалов и комплектующих, цены на продукцию предприятия могут быть изменены. Если срок действия счета истек, то перед оплатой счета, необходимо уточнить информацию о возможном изменении цен на данные изделия по телефонам (3812) 36-79-18, 36-94-53, 32-82-52 (отдел маркетинга), указанным в документе.

### Способы отгрузки

Самовывозом, автотранспортными компаниями, ЖДЭ, почтовыми посылками, экспресс-почтой, самолетом. Можно указать предпочтительный вид доставки непосредственно в заявке. А также, попросить включить расходы по доставке в стоимость продукции. Отгрузка может быть частичной (партиями, по мере готовности) по желанию заказчика.

### Минимальная партия заказа

От 1 штуки и более по любому изделию.

### Страховка

По умолчанию, отправка продукции не страхуется, либо учитывается минимальная обязательная сумма, принятая у перевозчика. По желанию потребителя предприятие, за дополнительную плату, проводит страхование груза в страховой компании.

### Недостача полученного товара

Каждая партия товара должна быть проверена покупателем по получении. Все претензии по утрате или недостатке товара должны быть направлены на предприятие в течение 7 дней, с даты получения товара.

### Повреждения при транспортировке

При получении груза из транспортной компании обязательно сверить количество мест по транспортной накладной, а также, упаковку на предмет внешних повреждений. Особенно, если на упаковке имеются знаки «ХРУПКОЕ».

При несопадении количества мест необходимо в присутствии представителя ТК вскрыть груз и принять товар по позициям, сверив с товарно-транспортным документом. При необходимости составить АКТ о расхождении количества мест.

При получении груза с явными признаками повреждений упаковки, необходимо составить АКТ о повреждениях. Обязательно сфотографировать все нарушения!

В виду отсутствия Актов о нарушениях Транспортные Компании имеют полное право отказать в возмещении убытков при некачественном оказании услуг.

В этом случае, отправитель также не несёт ответственности за повреждённый при перевозке груз.

### Возврат товара

Возврат товара для ремонта по гарантии не разрешается осуществляться без предварительного согласования с предприятием изготовителем.

Свяжитесь с отделом управления качеством по телефону (3812) 36-95-92 и укажите какое изделие и по какой причине Вы хотите вернуть. Сообщите номер счет-фактуры и дату заказа.

### Ремонт изделий

Предприятие проводит гарантийный и послегарантийный ремонт выпускаемой продукции.

### Экспресс-заказы

По просьбе заказчика, при наличии материалов, комплектующих и согласования с производством, сроки изготовления заказа могут быть сокращены, но цена изделий при этом увеличивается.

### Гарантийные сроки согласно КД

- ТСМ, ТСП, МЦДТ: хранения - 12 месяцев, эксплуатации - 18 месяцев;
- ТХА, ТХК, ТПП, ТПР: хранения - 12 месяцев, эксплуатации - 24 месяца;
- метрологическое оборудование, ППО, ПРО: хранения - 6 месяцев, эксплуатации - 18 месяцев;
- ЭТС-100: хранения - 6 месяцев, эксплуатации - 24 месяцев;
- электронные изделия: хранения - 6 месяцев, эксплуатация - 12 месяцев.



## ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Сертификаты соответствия:

- № РОСС RU.ИФ85.К00075 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 13.08.2021 г., выданный ООО "Центр испытаний, сертификации и аттестации";

- РОСС RU.В1869.04СУ02 № 21.023.327 ISO 9001:2015 от 21.07.2021г., выданный ФАУ "Российский морской регистр судоходства";

- лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № СДВ-(С)-12-101-2703 от 25.11.2019 г. на осуществление деятельности по конструированию и изготовлению оборудования для атомных станций;

- аттестат аккредитации федеральной службы по аккредитации № RA.RU.310666 от 03.06.16 на осуществление деятельности в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и оказания услуг по поверке средств измерений.

## ДИЛЕРЫ АО «НПП «ЭТАЛОН»

Наименование организации	Город	Контакты
ООО "БАЛТПРИБОР"	г. Санкт-Петербург	(812) 431-02-68/71; baltpribor.spb@yandex.ru; petrova6813@yandex.ru
ООО "Гранат-Е"		+7 (812) 336-90-88 +7 (812) 336-90-86; geotools@granat-e.ru
ООО «Терра Импэкс»	г. Новосибирск	383-363-18-50; info@terra-nsc.ru
ООО «КИП КОМПЛЕКТ СЕРВИС»	г. Казань	(843) 212-22-91, 295-82-77; zak4@kip-k-s.ru
ООО «Энерго-Теплоконтроль»		843-278-53-00, 278-46-06, Tk_mark@mail.ru
ЗАО ПГ «Метран»	г. Челябинск	(351)247-16-35, 799-51-51, info.metran@emerson.com
ООО «Союз Прибор»		(351)225-34-29, 225-34-39, 225-43-29, 225-43-39, szpribor@mail.ru
ООО "Энергопром"	г. Москва	495-710-70-37/38; 219@kipia.ru; 113@kipia.ru
ООО «КС-Трейдинг»		495-783-92-63, 225-54-93, info@ksrv.ru
ООО «ФОЛГрупп»		(910) 427-66-18, (495) 280-71-84, ms.folggrupp@mail.ru
ООО Фирма "Приборы контроля"		8(952) 406-81-98; sp1@asu-kip.ru
ООО "ЭнергоКонцепции"		8(495) 797-77-70; matveenkoa@energoconcept.com
ООО "ТЕХНО-АС"	г. Коломна	(496) 615-13-59, 613-51-47, 615-48-07, info@technoac.ru, marketing@technoac.ru
ООО «ТД «Автоматика»	г. Смоленск	(4812) 209-305/306/307/308/310/311, info@td-automatika.ru
ООО "АналитТеплоКонтроль"		(4812) 40-32-15, 31-17-83, info@atk-pribor.ru
ООО «Сибтеплоэлектрокомплект»	г. Томск	(3822) 705-777, sibkom@sibkom.tomsk.ru
ООО «Приборсервис-Пермь»	г. Пермь	342-219-64-71/72, psp@psp.perm.ru
ООО "Прогресс СБ"	г. Самара	(846) 979-24-26, факс (846) 979-24-26, info@progress-sb.ru
ООО "СМПВО"		8 (846) 202-44-18; 202-44-19, smpvo@smpvo.ru
ООО "ПКФ "ТСК"	Самарская область	+7 (846) 970-71-35, info+1291@pkftsk.ru
ЗАО «Машпром»	г. Нижний Новгород	(8312) 75-85-33, KolobihinSN@mashprom.biz, mashprom@intemet2.ru
ООО "Удмуртская электротехническая компания"	г. Ижевск	(3412) 900-859, факс (3412) 900-858, sga@uik.ru
ООО "РостЭкспо Технологии"	г. Уфа	8 (3472) 66-63-16; 8 (927) 33-33-867; roxtex@roxtex.ru
ООО "Центр Комплексных Технологий"	г. Екатеринбург	343-255-36-64; ndtural@ndtural.ru
ООО "Прибор-ПК"	г. Нижний Тагил	(3435) 342-380, nt@pribor-pk.ru
ООО "Энергетические технологии"	г. Красноярск	391-213-34-52, 241-04-92, факс 391-213-34-52, energo-tech@mail.ru
ТОО "АКЭП"	Р. Казахстан	(7232) 22-55-45, 22-56-05, 22-50-52; akep@akep.net
ТОО "Арал-Энергия"	г. Усть-Каменогорск	(7232) 76-78-31, факс (7232) 76-78-31, too2010@list.ru
ЧП «НЕЛЛИ»	Р. Украина, г. Харьков	/1038/-/096/-345-95-83; 8-1038-057-392-37-70; nelliamorozova@gmail.com
ООО НПП «БелэнергоКИП»	Р. Беларусь г. Минск	+375 (17) 237-50-30, +375 (29) 676-17-64, atm@belenergokip.by



# ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

## ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

### СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИТП И ИТПМ

Характеристики	ИТП	ИТПМ
Тип датчика	любой тип термопарного датчика и термопреобразователя сопротивления по желанию заказчика, с возможностью совместной калибровки прибора с конкретным датчиком для снижения погрешности измерения	ТХА(К), ТХК(Л); ТС (ТСМ (50М, 100М; $W_{100}=1,4280$ ), ТСП (50П, 100П, 500П; $W_{100}=1,3850$ , $W_{100}=1,3910$ )) - переключение конкретного типа датчика с клавиатуры, при наличии 2-х каналов типа ТС переключение типа датчика по каждому каналу осуществляется независимо, в зависимости от варианта исполнения
Возможность работы с различными типами датчиков по различным каналам (для 2-х канальных приборов)	-	для вариантов исполнений с датчиками типа ТС и ТС, ТХА(К) и ТХК(Л) по различным каналам соответственно
Диапазон измерения температуры	ограниченный поддиапазон в пределах всего диапазона измерения датчика	практически весь диапазон измерения датчика -50...+1300 для ТХА(К); -50...+800 для ТХК(Л); -100...+200 для ТСМ; -100...+850 для ТСП ( $W_{100}=1,3850$ ); -100...+1000 для ТСП ( $W_{100}=1,3910$ ).
Число измерительных каналов	1; 2, в зависимости от варианта исполнения	1; 2, в зависимости от варианта исполнения
Вид индикации	ЖКИ; 3,5 разряда	ЖКИ; 4,5 разряда
Индикация температуры двух каналов поочередно (для 2-х канальных приборов)	-	+
Разрешающая способность индикации, °С	0,1; 1, в зависимости от варианта исполнения	0,1
Основная погрешность*, % от диапазона измерения, не более	$\pm(0,25...1,5)$ , в зависимости от типа датчика и конкретного диапазона измерения	$\pm(0,1...0,2)$ ( $\pm(0,5...1,0)^\circ\text{C}$ ) в зависимости от типа датчика
Измерение разности температур (для 2-х канальных приборов)	-	+
Основная погрешность измерения разности температур (для 2-х канальных приборов), % от диапазона измерения, не более	-	$\pm(0,1...0,3)$ ( $\pm(0,7...1,4)^\circ\text{C}$ ), в зависимости от типа датчика
Связь с ЭВМ	-	RS-232
Внутренние электронные часы	-	+
Внутренняя энергонезависимая память	-	1300 значений для двухканальных приборов, 2800 значений для одноканальных приборов
Температура окружающего воздуха, °С	-10...+40	0...40 (обычное исполнение); -30...+50 (холодоустойчивое исполнение)
Питание	9 В (1 элемент «Крона»)	9 В (6 элементов типа АА)
Ток потребления, мА, не более	10	8

\* Погрешность приборов с термопарными датчиками нормируется с учетом погрешности встроенного компенсатора температуры холодных концов.

Использование ИТП и ИТПМ для КОНТРОЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ:

Портативные измерители температуры с автономным питанием типа ИТП-1-ХА и ИТПМ-1-ХА в комплекте с термопреобразователями типа ТХА 9713 позволяют измерять температуру плоских и цилиндрических поверхностей, в том числе труб и батарей отопления, а приборы ИТП-1-50П и ИТПМ-1-ТС в комплекте с термопреобразователями типа ТСП 9307 (с разъемом 2РМ) заменяют ртутные термометры при замерах температуры в тепловых узлах и котельных.





**ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРТАТИВНЫЕ ИТП**



**ТУ 50-97 ДДШ 2.821.060 ТУ**

ИТП зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 17124-08. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.051.A№34270/1.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Измерители температуры портативные ИТП предназначены для измерения температуры в различных областях промышленности и народного хозяйства.

Приборы, в зависимости от исполнения, работают с одним из типов термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-94 или преобразователей термоэлектрических (термопар) по ГОСТ Р 8.585-2001 и обеспечивают измерение температуры по одному или двум каналам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИТП-1	ИТП-2
Тип датчика	ТХА(К), ТХК(Л), ТПР(В), ТСМ (50М; $W_{100}=1,4280$ ), ТСП (50П; $W_{100}=1,3910$ ), в зависимости от исполнения	
Вид индикации	ЖКИ; 3,5 разряда	
Разрешающая способность индикации, °С	0,1; 1, в зависимости от исполнения	
Количество каналов измерения		
- для ТХА(К), ТХК(Л), ТПР(В)	1 ("А")	2 ("А", "Б")
- для ТСП, ТСМ		-
Основная приведенная погрешность, % от диапазона, не более	$\pm(0,25...1,5)$ , в зависимости от исполнения	
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96	IP40, введены элементы пыле- и влагозащиты	
Материал корпуса	металл	
Температура окружающего воздуха, °С	-10...+40	
Питание	9 В (1 элемент «Крона»)	
Ток потребления, мА, не более	10	
Индикация разряда элементов питания	есть	
Габаритные размеры (без элементов подключения датчиков температуры), мм, не более	195x85x35	
Масса, кг, не более	0,4	

ИТП



**Имеется большой опыт успешной эксплуатации прибора в условиях сильных электромагнитных полей на алюминиевом производстве.**

Подключение датчиков осуществляется с помощью соединителя винтового SMKDSNF-1,5/2.

По заявке заказчика возможно изготовление ИТП с разъемом для подключения термопар совместимым со стандартным миниатюрным соединителем фирмы «Омега» (США).

По согласованию возможна поставка других исполнений приборов (с другими значением диапазона температур и типом датчика). Приборы допускают совместную калибровку с конкретными датчиками температуры, что снижает погрешность измерения.


Тип датчика	Диапазон измеряемых температур, °С	Разрешающая способность индикации, °С	Приведенная погрешность, % от диапазона
ТХА(К)*	-60...+100	0,1	0,75
	-60...+200		1,0
	-40...+200		1,0
	0...200		0,5
	-60...+1200	1	1,0
	-40...+800		0,75
	0...400		0,75
	0...800		0,75
	0...1000		0,75
	200...1000		1,0
	300...800		0,75
	500...1200		0,5
	600...1300		1,5
	700...1000		1,5
800...1200	0,5		
ТХК(Л)*	-60...+100	0,1	0,5
	-60...+200		0,75
	0...200		0,5
	-60...+600		1,5
	-40...+600	1	1,5
	0...300		1,0
	0...400		1,0
	0...600		1,0
	200...600		0,75
	1000...1800		1,0
ТСМ 50М; $W_{100}=1,4280$	-60...+200	0,1	0,25
ТСП 50П; $W_{100}=1,3910$	0...600	1	0,5
* погрешность нормируется с учетом погрешности встроенного компенсатора температуры холодных концов			

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- ИТП;
- формуляр;
- методика поверки (1 экз. на 10 приборов).

Датчики температуры в комплект поставки не входят, выбираются в I части каталога.

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

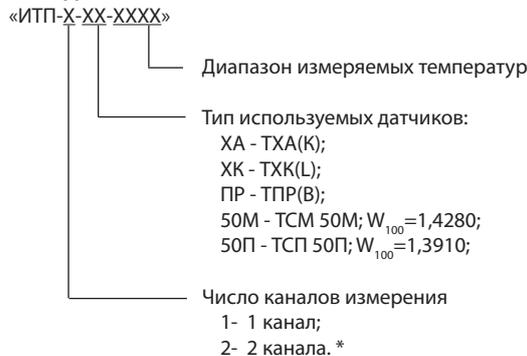

\* Только для ИТП с датчиками типа ТХА(К), ТХК(Л), ТПР(В)

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

- «ИТП-2-ХА +200/+1000»
- «ИТП-1-ХК -60/+600»



## ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРТАТИВНЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ИТПМ

ДДШ 2.821.102 ТУ

### Назначение:

Измерители температуры портативные микропроцессорные ИТПМ предназначены для проведения высокоточных измерений температуры с возможностью сохранения измеренных значений во внутренней памяти и передачи их в ЭВМ.

### Основные достоинства приборов:

Измерители ИТПМ обеспечивают высокие метрологические характеристики и большой набор сервисных функций, связанных с сохранением измеренных значений во внутренней памяти и последующей передачей их в ЭВМ, а также с передачей на ЭВМ текущих измеренных значений в реальном времени. Это предоставляет пользователю широкие возможности по измерению температуры и позволяет, особенно на производствах с внедренной автоматизированной системой управления (АСУ), добиться следующих результатов:

- значительно ускорить процесс передачи результатов измерения в ЭВМ, устранить длительную рутинную процедуру ручного ввода больших объемов данных в ЭВМ;
- производить различную обработку полученных значений;
- быстро реагировать на изменение температуры контролируемых объектов.

### Отличительные особенности приборов:

- высокая точность измерения температуры;
- измерение температуры во всем практически используемом диапазоне измерения датчиков;
- возможность для приборов с каналами типа ТС работать с 6 различными термопреобразователями сопротивления по каждому такому каналу;
- возможность изменения режима индикации для двухканальных приборов;
- наличие специальных холодоустойчивых исполнений для работы при температуре окружающего воздуха до  $-30^{\circ}\text{C}$ ;
- металлический корпус с элементами пыле- и влагозащиты, что позволяет использовать прибор в тяжелых условиях эксплуатации;
- наличие системы автоматического определения неисправностей;
- низкое энергопотребление и широко доступные элементы питания типоразмера АА, могут применяться как обычные батарейки, так и аккумуляторы;
- наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей сохранять данные после выключения питания прибора;
- относительно большой объем внутренней энергонезависимой памяти:
  - 1300 результатов измерений для двухканальных приборов;
  - 2800 результатов измерений для одноканальных приборов;
- возможность фиксации времени, даты, места проведения (номера в серии измерений) каждого измерения;
- возможность просмотра содержимого внутренней энергонезависимой памяти на индикаторе прибора;
- специальное программное обеспечение, которое устанавливается на ЭВМ, позволяет управлять прибором при помощи ЭВМ и обеспечивает большой набор сервисных функций;
- возможность передачи данных от ИТПМ в ЭВМ в реальном времени, непосредственно в процессе измерения, с частотой два раза в секунду. Данная функция позволяет производить при помощи ИТПМ различные исследования изменяющихся во времени процессов, связанных с изменением температуры.

### Возможности программного обеспечения, устанавливаемого на ЭВМ:

- настройка всех параметров прибора при помощи ЭВМ;
- выполнение всех операций по получению хранящейся во внутренней энергонезависимой памяти ИТПМ информации;
- получение в реальном времени передаваемой от ИТПМ с частотой 2 раза в секунду информации об измеренной температуре;
- сохранение полученной от ИТПМ информации в удобном для дальнейшей обработки виде.

### ИТПМ-1П-ТС

с вилкой для подключения датчиков типа ТСП, ТСМ



### ИТПМ-1П-ТХА

с вилкой для подключения датчиков типа ТХА(К)



**Имеется большой опыт успешной эксплуатации прибора в условиях сильных электромагнитных полей на алюминиевом производстве.**

Тип датчика	Диапазон измеряемых температур, $^{\circ}\text{C}$
ТХА(К)	$-50 \dots +1300$
ТХК(Л)	$-50 \dots +800$
ТСМ	$-100 \dots +200$
ТСП ( $W_{100}=1,3910$ )	$-100 \dots +1000$
ТСП ( $W_{100}=1,3850$ )	$-100 \dots +850$

### Комплектность:

- ИТПМ;
- вилки для подключения термопреобразователей (1 шт. на каждый канал);
- вилки-замыкатели (1 шт. на каждый канал);
- кабель для связи с компьютером;
- программное обеспечение;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки.

Отдельно по желанию заказчика:  
- теплоотражающий экран.

Элементы питания в комплект поставки не входят.

Датчики температуры в комплект поставки не входят, выбираются в I части каталога.




ИТПМ выпускаются по ДДШ 2.821.102 ТУ

Характеристики	ИТПМ-1П-ТХА	ИТПМ-1П-ТХК	ИТПМ-1П-ТС	ИТПМ-2П-ТХА	ИТПМ-2П-ТХК	ИТПМ-2П-ТХА/ТХК	ИТПМ-2П-ТС
Количество каналов измерения	1 ("А")			2 ("А", "Б")			
Тип датчика канала "А"	ТХА(К)	ТХК(Л)	ТСП, ТСМ*	ТХА(К)	ТХК(Л)	ТХА(К)	ТСП, ТСМ*
Тип датчика канала "Б"	-			ТХА(К)	ТХК(Л)	ТХК(Л)	ТСП, ТСМ*
Переключение типа датчика	-		есть	-			есть, независимо для каждого канала
Тип разъёма для подключения датчиков	совместим со стандартным миниатюрным соединителем фирмы «Омега» (США)		соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16 (4-х проводное включение)	совместим со стандартным миниатюрным соединителем фирмы «Омега» (США)			соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16 (4-х проводное включение)
Вид индикации	ЖКИ; 4,5 разряда						
Разрешающая способность индикации, °С	0,1						
Режимы индикации двухканальных приборов (значения, выводимые при измерении на индикатор)	-			- значение температуры одного из каналов, - разность температур, - значения температуры каждого из 2-х каналов поочередно, устанавливается с клавиатуры или при помощи ЭВМ			
Основная погрешность, °С, не более:							
- для ТХА(К)**, ТХК(Л)**, ТСП	±1						
- для ТСМ	-		±0,5		-		±0,5
Основная погрешность при измерении разности температур, °С, не более:							
- для ТХА(К), ТХК(Л)**				±1,4			
- для разности двух датчиков ТСМ						±0,7	
- для разности двух датчиков ТСП						±1,4	
- для разности датчиков ТСП и ТСМ						±1,1	
Время измерения, с	0,5						
Объем энергонезависимой памяти, записей	2800			1300			
Внутренние электронные часы	обеспечивают отсчет текущего времени (год, день, месяц, час, минута, секунда), возможность просмотра текущего времени (час, минута) на индикаторе прибора; установка времени с клавиатуры прибора или при помощи ЭВМ						
Связь с ЭВМ	RS-232						
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96	IP40, введены элементы пыли- и влагозащиты						
Материал корпуса	металл						
Температура окружающего воздуха, °С	0...40; -30...+50, в зависимости от исполнения						
Питание	9 В (6 элементов АА)						
Ток потребления, мА, не более (время работы одного комплекта элементов питания, ч)	8 (100...400)						
Индикация разряда элементов питания	есть						
Габаритные размеры, мм, не более	185x90x40		205x90x40		185x90x40		205x90x40
Масса, кг, не более	0,5						
* ТСМ (50М, 100М; W <sub>100</sub> =1,4280), ТСП (50П, 100П; W <sub>100</sub> =1,3850, W <sub>100</sub> =1,3910)							
** погрешность нормируется с учетом погрешности встроенного компенсатора температуры холодных концов термопар							

Порядок записи при заказе:

«ИТПМ-XX-XXX-X»

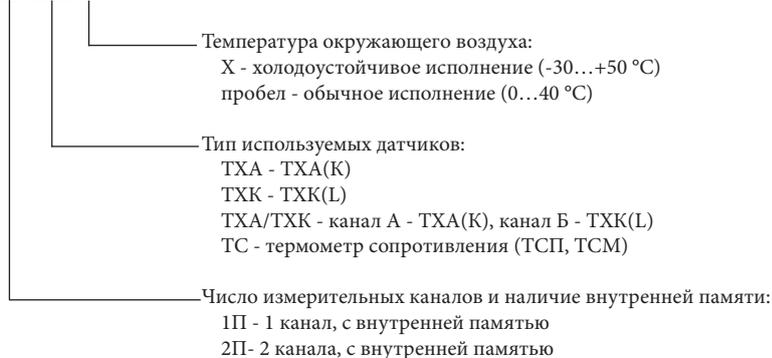

Пример записи при заказе:

«ИТПМ-2П-ТХК-Х»  
«ИТПМ-2П-ТС»



## ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРТАТИВНЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ИТПМ2

МКСН.405544.033 РЭ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Измеритель температуры портативный микропроцессорный ИТПМ2 (далее – ИТПМ2) предназначен для измерения температуры при помощи подключаемых к ИТПМ2:

- термоэлектрических преобразователей (ТП) по ГОСТ 6616-94
- термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-2009

### Возможно использование ИТПМ2 для измерения:

- напряжения постоянного тока в диапазоне от минус 270 до плюс 300 мВ (исполнение ИТПМ2-ТС-ТП)
- сопротивления в диапазоне от 0 до 500 Ом
- для отображения величины разности значений температуры по каналам

### ИЗМЕРИТЕЛЬ ИТПМ2 ВЫПУСКАЕТСЯ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

1. **ИТПМ2-ТС-ТС** - для работы с двумя внешними термопреобразователями сопротивления.
2. **ИТПМ2-ТС-ТП** - для работы с внешним термоэлектрическим преобразователем на канале №1 и внешним термопреобразователем сопротивления на канале №2.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- энергетика,
- машиностроение,
- металлургия и др.

ИТПМ2 является двухканальным переносным прибором с автономным питанием от аккумулятора типа SAM2600 18650, Li-ion, 2600 mAh, с номинальным напряжением 3,7 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИТПМ2
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ3.1
Типы поддерживаемых ТП и ТС	см. таблицу 1
Диапазоны измеряемой температуры и максимальная основная абсолютная погрешность измерения по типам ТП и ТС	см. таблицу 2
Количество каналов измерения	2
Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254-2015	IP40
Время установления рабочего режима в нормальных условиях, с, не более	5
Габаритные размеры, мм	180x88x35
Материал корпуса	АБС-2020-30-901
Схема подключения	двух- или трехпроводная
Масса, кг, не более	0,35
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	25 000
Средний срок службы, лет, не менее	8

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИСПОЛНЕНИЕ	
	ИТПМ2-ТС-ТП	ИТПМ2-ТС-ТС
Обозначение типа поддерживаемых ТС и ТП	Канал А	50П, 100П, Pt50, Pt100, 50М, 100М
	Канал В	ТПП(С), ТПР(В), ТХК(Л), ТЖК(Л), ТХА(К)
		50П, 100П, Pt50, Pt100, 50М, 100М

Таблица 2

Обозначение типа поддерживаемых ТС и ТП	Диапазон измеряемых температур, °С	Максимальная основная абсолютная погрешность измерения, °С
ТПП(С)	-45...+1750	5,0
ТПР(В)	+200...+1810	4,0
ТХА(К)	-100...+1360	1,2
ТЖК(Л)	-100...+1200	1,0
ТХК(Л)	-100...+800	1,0
50П	-195...+845	0,2
100П		0,1
Pt50		0,25
Pt100		0,1
50М	-175...+195	0,2
100М		0,1

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Сохранение результатов измерений во встроенной энергонезависимой памяти ПЗУ.
2. Передача результатов измерений на ПК в режиме реального времени.
3. Наличие программного обеспечения (далее - ПО), которое работает под управлением операционной системы Windows 7 – Windows 10. ПО предназначено для настройки и сбора данных с ИТПМ2.
4. Наличие экранного меню для выбора рабочих параметров.
5. Связь ПО и ИТПМ2 осуществляется посредством USB.
6. Индикация уровня зарядки аккумулятора.

### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:


температура окружающего воздуха, °С	от минус 10 до плюс 50
относительная влажность воздуха при 25 °С, %	95

### Внешний вид ИТПМ2





Рис.1 Основное информационное окно

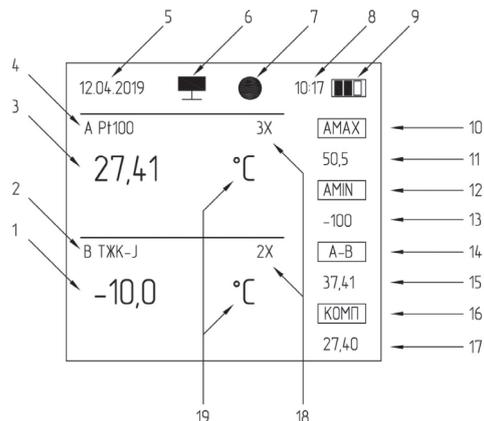

- 1 – измеренная температура на канале В;
- 2 – метка канала В и тип выбранного датчика;
- 3 – измеренная температура на канале А;
- 4 – метка канала А и тип выбранного датчика;
- 5 – текущая дата;
- 6 – индикация соединения с ПК;
- 7 – индикация режима логирования;
- 8 – текущее время;
- 9 – уровень зарядки аккумулятора;
- 10 – «АМАХ» - максимальное измеренное значение на канале А;
- 11 – величина максимального измеренного значения на канале А;
- 12 – «АМИН» - минимальное измеренное значение на канале А;
- 13 – величина минимального измеренного значения на канале А;
- 14 – «А-В» - разность значений температуры каналов А и В;
- 15 – величина разности значений температуры каналов А и В;
- 16 – «КОМП» - компенсация холодных концов (серый цвет – включено, красный – выключено);
- 17 – значение температуры холодных концов;
- 18 – выбранная схема измерения (для ТС – двух- или трехпроводная, для ТП - двухпроводная);
- 19 – выбранные единицы измерения (для ТС - °С или Ом, для ТП - °С или мВ).

Рис.2 Панели индикации



Рис.3 Дружественное многоуровневое меню настройки прибора



Рис.4 Выбор типа датчика на канал



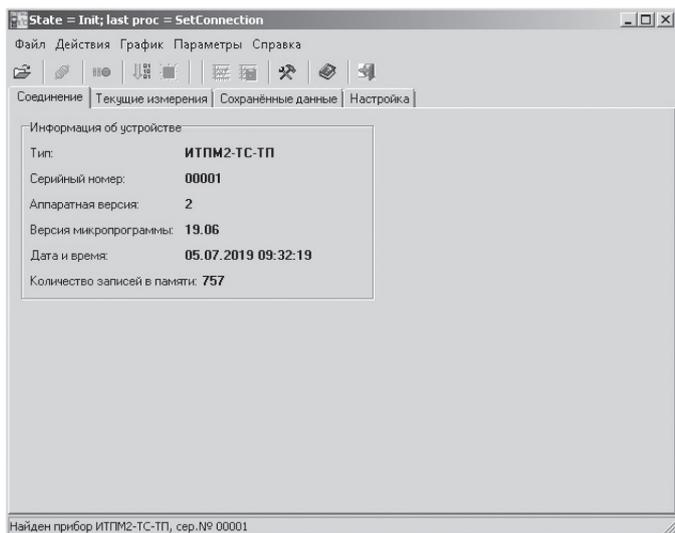


Рис. 5 Вкладка «Соединение»

Информация о подключенном ИТПМ2 отображается на вкладке «Соединение» (см. рис.5).

Нажав вкладку «Текущие измерения», затем «Таблица» отобразятся измеряемые ИТПМ2 текущие значения (см. рис.6).

Нажав вкладку «Текущие измерения», затем «Настройка каналов» отобразятся настройки каналов (см. рис.7).

В данном окне можно корректировать типы ТС или ТП, схему подключения, единицы измеряемых величин (°C, Ом, мВ), а также включение (выключение) функции «компенсация холодных концов».

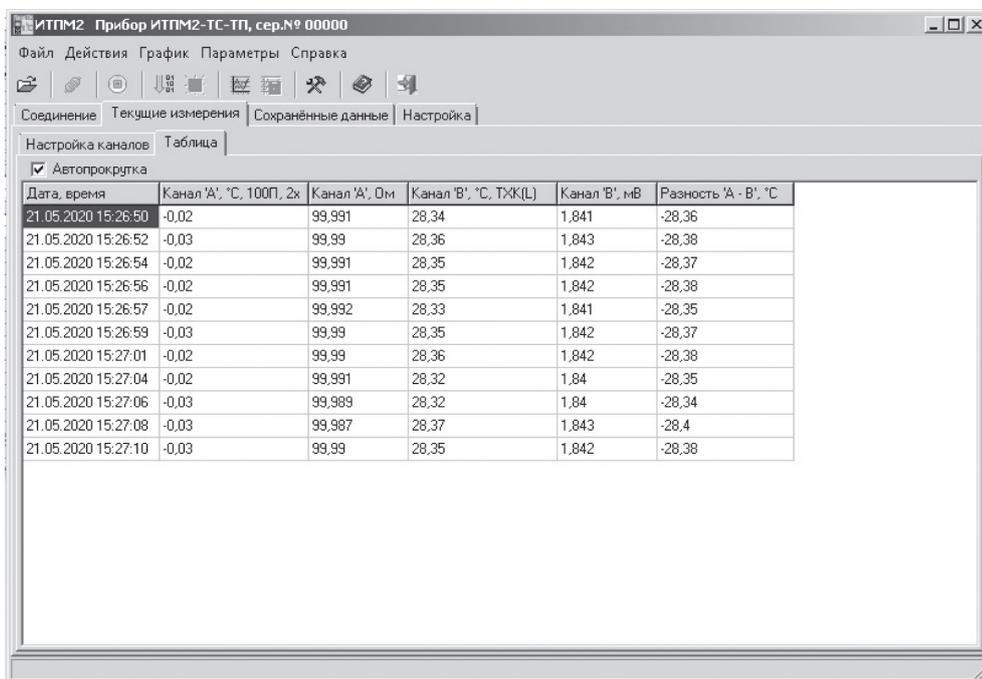


Рис.6 Вкладка «Таблица»

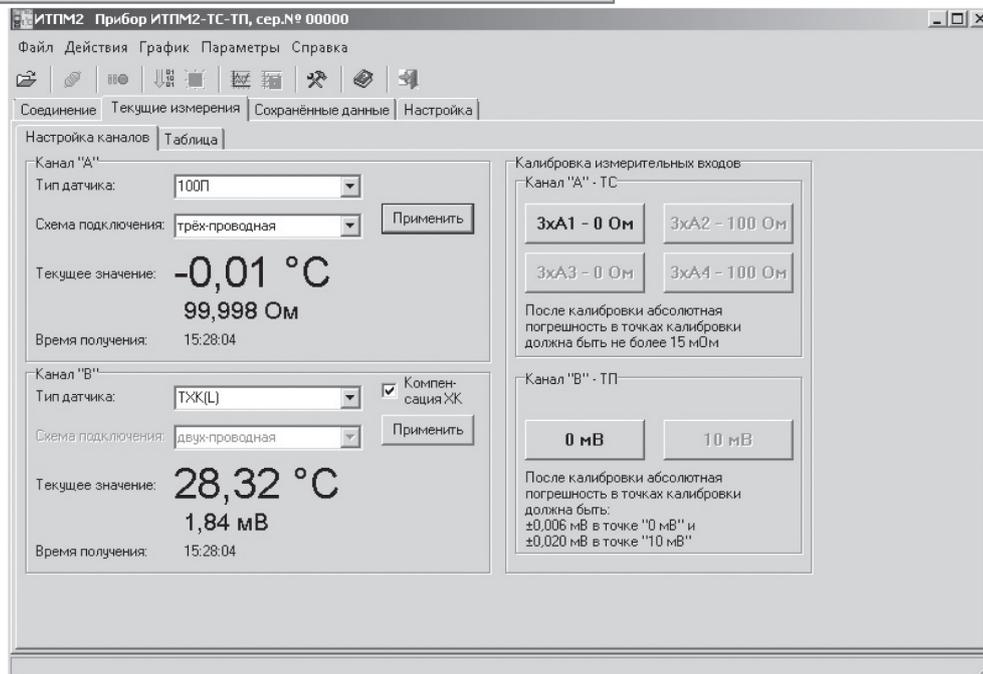


Рис.7 Вкладка «Текущие измерения»

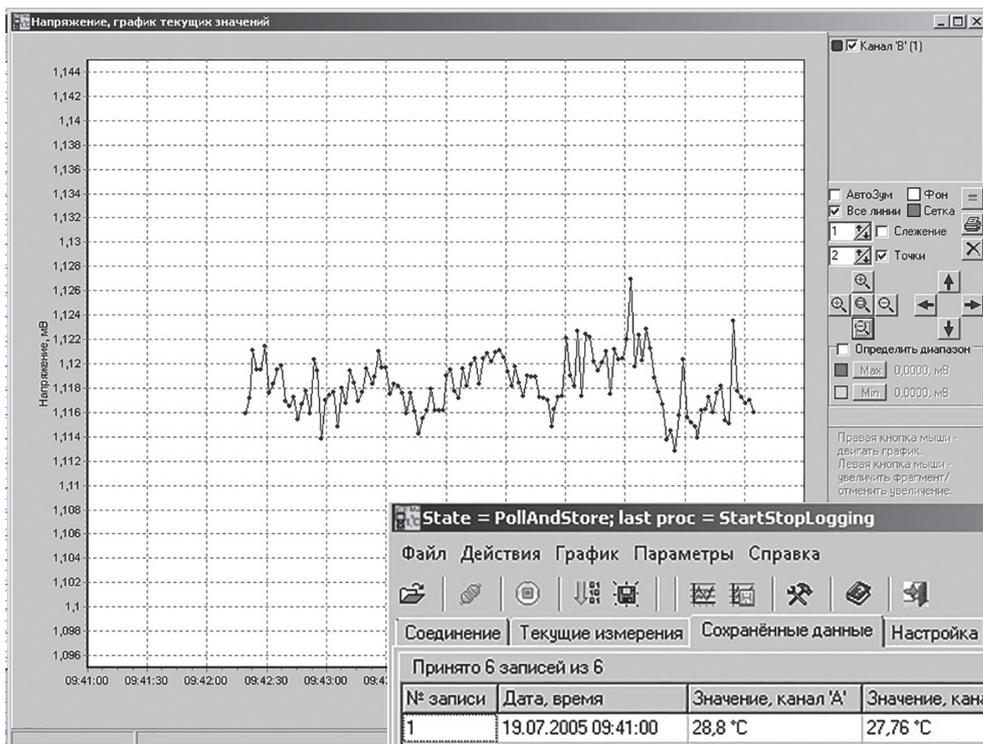


Рис.8 График сохраненных измеренных значений

ПО позволяет вывести на экран графики текущих измеряемых значений – напряжения, сопротивления, температуры; также можно вывести на экран графики сохраненных измеренных значений (см. рис.8).

Нажав ссылку «Сохраненные данные», можно увидеть записанные в режиме логгирования измеренные значения величин в виде таблицы (см. рис.9).

State = PollAndStore; last proc = StartStopLogging

Файл Действия График Параметры Справка

Соединение Текущие измерения Сохранённые данные Настройка

Принято 6 записей из 6

№ записи	Дата, время	Значение, канал 'A'	Значение, канал 'B'	Разность 'A - B'
1	19.07.2005 09:41:00	28,8 °C	27,76 °C	1,04 °C
2	19.07.2005 09:41:02	28,79 °C	27,72 °C	1,07 °C
3	19.07.2005 09:41:04	28,8 °C	27,73 °C	1,07 °C
4	19.07.2005 09:41:06	28,8 °C	27,73 °C	1,07 °C
5	19.07.2005 09:41:08	28,8 °C	27,78 °C	1,02 °C
6	19.07.2005 09:41:10	28,81 °C	27,77 °C	1,04 °C

Найден прибор ИТПМ2-ТС-ТП, сер.№ 00001

Рис.9 Измеренные значения величин в виде таблицы

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

Наименование	Кол-во	Примечание
Измеритель температуры портативный микропроцессорный - ИТПМ2	1 шт.	
Кабель USB 2.0 A(M) - USB B(M)	1 шт.	3 м
Кабель компенсационный тип L	1 шт.	Для ИТПМ2-ТС-ТП
Кабель компенсационный тип K	1 шт.	
Кабель компенсационный тип S	1 шт.	
Кабель компенсационный тип J	1 шт.	
Замыкатель	1 шт.	
Вилка термопарная ДДШ 6.610.005	1 шт.	
Вилка термопарная ДДШ 6.610.005-01	1 шт.	
Вилка термопарная ДДШ 6.610.005-02	2 шт.	
Кабель МКСН. 685631.043	1 шт.	Длина 2 м для ИТПМ2-ТС-ТП
Кабель МКСН.685631.056	1 шт.	-
Провод МГТФ 0,35 ТУ 16-505.185-71	3 шт.	Длина 2 м для ИТПМ2-ТС-ТП
	6 шт.	Длина 2 м для ИТПМ2-ТС-ТП
Клемник винтовой	1 шт.	Для ИТПМ2-ТС-ТП
	2 шт.	Для ИТПМ2-ТС-ТС
Вставка плавкая	1 шт.	-
Программное обеспечение «Программа обслуживания ИТПМ2»	1 компл.	-
Руководство по эксплуатации	1 экз.	-
Паспорт		-

**ПОРЯДОК ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Измеритель температуры портативный микропроцессорный ИТПМ2-ТС-XX-МКСН.405544.033 РЭ»  
XX - Исполнение (ТС-ТС или ТС-ТП)

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**


«Измеритель температуры портативный микропроцессорный ИТПМ2-ТС-ТП МКСН.405544.033 РЭ»

## ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРТАТИВНЫЕ ИТПМ (ИТП) С КОМПЛЕКТОМ ДАТЧИКОВ В ЧЕМОДАНЕ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Измерители температуры портативные ИТПМ (ИТП) с комплектом датчиков в чемодане предназначены для более удобной эксплуатации портативных измерителей температуры ИТПМ (ИТП) при проведении измерений.

Размер - 450x350x95 мм

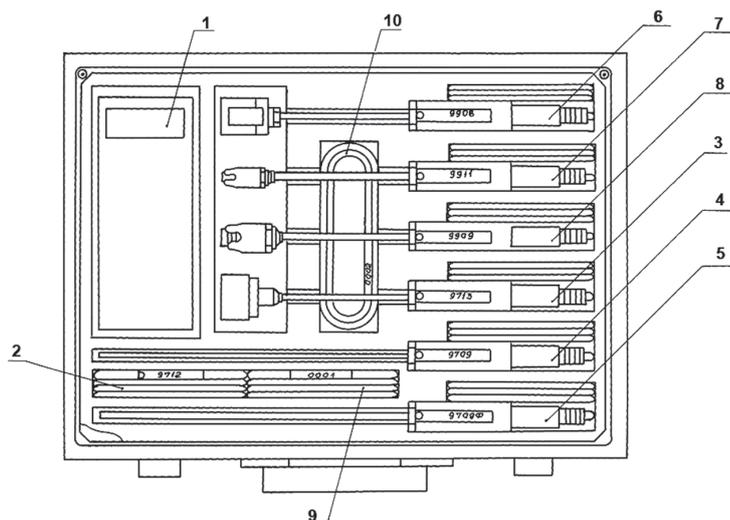

ИТПМ с комплектом датчиков  
в чемодане


ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ*			
	Комплект-00	Комплект-01	Комплект-02	Комплект-03
Номер позиции на рисунке				
- 1	ИТПМ-2П-ТХА-Х	ИТП-2-ХА -40/+800	ИТПМ-2П-ТХК-Х	ИТП-2-ХК -40/+600
- 2	ТХА 9712-00	ТХА 9712-05	ТХК 9712-10	ТХК 9712-15
- 3	ТХА 9713-00	ТХА 9713-01	-	-
- 4	ТХА 9709-01	ТХА 9709-10	ТХК 9709-19	ТХК 9709-28
- 5	ТХА 9709Ф-01	ТХА 9709Ф-10	ТХК 9709Ф-19	ТХК 9709Ф-28
- 6	ТХА 9908-00	ТХА 9908-10	ТХК 9908-20	ТХК 9908-30
- 7	ТХА 9909-00	ТХА 9909-10	ТХК 9909-20	ТХК 9909-30
- 8	ТХА 9911-00	ТХА 9911-10	ТХК 9911-20	ТХК 9911-30
- 9	ТХА 0001-00	ТХА 0001-05	ТХК 0001-15	ТХК 0001-20
- 10	ТХА 0002-00	ТХА 0002-03	ТХК 0002-16	ТХК 0002-19

\* По согласованию возможны другие варианты исполнений, отличающиеся количеством и/или вариантами исполнения измерителей температуры и датчиков.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДАТЧИКОВ:

**ТХА, ТХК 9712** - для измерения температуры поверхности твердых тел в труднодоступных местах;  
**ТХА, ТХК 9713** (ленточный) - для измерения температуры плоских и выпуклых поверхностей, в том числе неметаллических;  
**ТХА, ТХК 9709** (стержень с ручкой) погружной - для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ;  
**ТХА, ТХК 9908** (ленточный-лучковый) - для измерения температуры цилиндрических поверхностей (труб);  
**ТХА, ТХК 9909** (сильфон  $\varnothing$  14,5 мм) - для измерения температуры плоских металлических поверхностей;  
**ТХА, ТХК 9911** (сильфон  $\varnothing$  11 мм) - для измерения температуры плоских металлических поверхностей;  
**ТХА, ТХК 0001** (шайба) - для измерения температуры плоских поверхностей с креплением винтом.



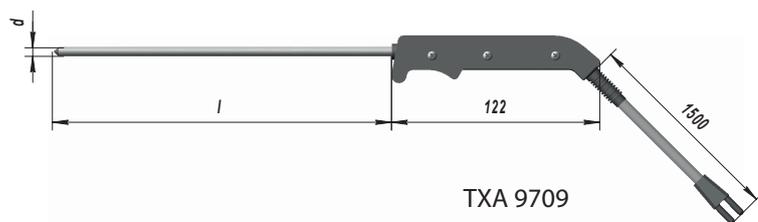

TXA 9709



TXA 9713




TXA 9908




TXA 9909




TXA 9911

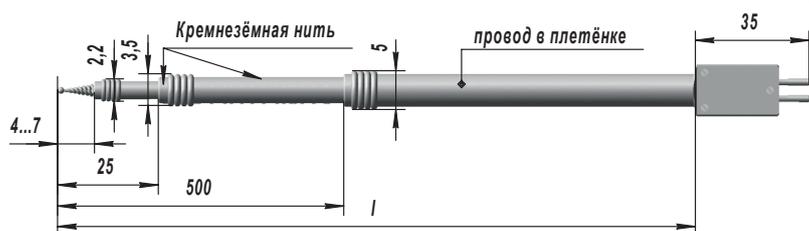

TXA 9712

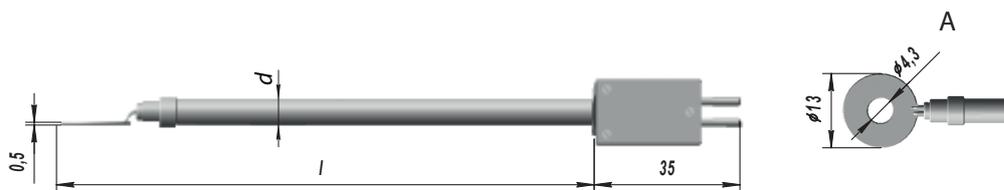

TXA 0001

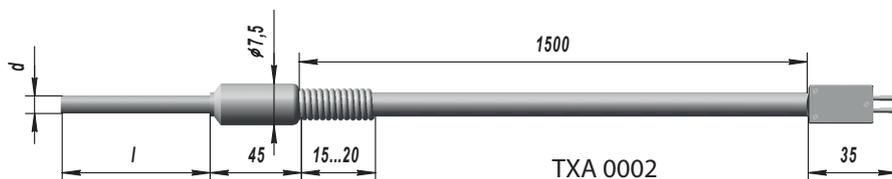

TXA 0002

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«ИТПМ-2-ХА -40/800 с комплектом датчиков-01»

«ИТПМ-2П-ТХА с комплектом датчиков:

- ТХА 9712-00 - 2 шт.;
- ТХА 9908-00 - 2 шт.;
- ТХА 9713-00 - 2 шт.»



## ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРТАТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИТПЦ

ТУ 4211-024-02566540-2006

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Измерители температуры портативные цифровые ИТПЦ предназначены для измерения температуры с возможностью сохранения измеренных значений во внутренней энергонезависимой памяти и передачи их в ЭВМ. Приборы, в зависимости от варианта исполнения, работают с термопреобразователями сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006 или преобразователями термоэлектрическими (термопарами) по ГОСТ Р 8.585-2001 любой конструкции.

### ИТПЦ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИТПЦ-ТП	ИТПЦ-ТС
Тип датчика (переключаются оператором)	ТХА(К), ТХК(Л), ТПР(В), ТПП(С)	ТСМ (50М, 100М; W <sub>100</sub> =1,4280), ТСП (50П, 100П; W <sub>100</sub> =1,3850, W <sub>100</sub> =1,3910)
Подключение датчика:	розетка, совместимая со стандартным соединителем фирмы "Omega" (США)	соединитель РГ1Н-1-1 (4-проводное включение)
Вид индикации	ЖКИ, 10 символов	
Разрешающая способность индикации, °С	0,1	
Основная погрешность, °С, не более		
- для ТХА(К), ТХК(Л)	±1,5*	
- для ТПР(В)	±10,0*	
- для ТПП(С)	±7,0*	
- для ТСМ, ТСП	±0,5	
Количество измерительных каналов	1	
Время измерения, с, не более	1	
Автоматическая регистрация измеренных значений температуры	есть	
Интервал автоматической регистрации, сек	0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 15; 30; 60	
Объем памяти, значений**	4000, 12000	
Запуск процесса автоматической регистрации измеренных значений	ручной	
Остановка процесса автоматической регистрации измеренных значений	ручная или по заполнению памяти	
Подсветка индикатора**	нет, есть	
Связь с ЭВМ	RS-232	
Среда функционирования программного обеспечения	Windows'95, 98, 2000, XP	
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96	IP20	
Температура окружающего воздуха, °С	0...50	
Питание	+9В, элемент питания типа "Крона"	
Ток потребления, мА, не более	3 (10***)	
Индикация разряда батареи	есть	
Габариты, мм, не более	129x75x30	
Масса, кг, не более	0,5	
* - погрешность нормируется с учетом погрешности внутреннего компенсатора температуры холодных концов термопар; ** в зависимости от исполнения; *** при включенной подсветке		

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- ИТПЦ;
- набор вилок для подключения датчика;
- кабель для связи с компьютером;
- программное обеспечение;
- руководство по эксплуатации.

Датчики температуры в комплект поставки не входят.

### ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

"ИТПЦ-XX-X-X"

- Наличие подсветки  
0 - нет  
1 - есть
- Объем памяти, значений  
0 - 4000;  
1 - 12000
- Тип датчика:  
ТП - преобразователь термоэлектрический  
ТС - термопреобразователь сопротивления

Тип датчика	Диапазон измеряемых температур, °С
ТХА(К)	-50...+1370
ТХК(Л)	-50...+800
ТПР(В)	+300...+1800
ТПП(С)	0...+1700
ТСМ	-100...+200
ТСП (W <sub>100</sub> =1,3850)	-100...+850
ТСП (W <sub>100</sub> =1,3910)	-100...+850

### ОСОБЕННОСТИ:

- наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей хранить данные после выключения питания приборов;
- приборы позволяют производить запись в энергонезависимую память одиночных измеренных значений температуры и хранение их с возможностью последующего просмотра этих данных на индикаторе. Количество сохраняемых значений - до 10;
- приборы позволяют вести автоматическую непрерывную регистрацию в энергонезависимую память измеренных значений температуры с интервалами 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 15; 30 или 60 секунд с возможностью последующей передачи этих данных на ЭВМ. Количество сохраняемых значений - 4000 или 12000, в зависимости от варианта исполнения приборов;
- приборы, в зависимости от исполнения, позволяют работать с шестью различными типами термопреобразователей сопротивления или с четырьмя типами термопарных датчиков, переключение типа датчика осуществляется с клавиатуры приборов.

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Приборы имеют порт RS-232 для связи с компьютером. С приборами поставляется специальное сервисное программное обеспечение, выполняющее следующие функции:

- считывание данных из памяти приборов;
- обработка полученных данных: представление их в табличном и графическом видах;
- сохранение полученных данных в виде файла на ЭВМ с возможностью последующей загрузки этого файла в оболочку сервисного программного обеспечения.

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

"ИТПЦ-ТП-1-0"



## ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ИПСС

МКСН.405544.007 ТУ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Измеритель параметров среды стационарный ИПСС предназначен для измерения и отображения на дисплее: температуры и влажности воздуха (измерение осуществляется посредством датчика влажности выносного ДВВ (см. далее), атмосферного давления, реального времени. Измеритель может выполнять функции регулятора (опционально) температуры, влажности, давления, в том числе включения/отключения в заданный временной интервал посредством двух независимых ключей регулирования.



ИПСС

Датчик влажности выносной ДВВ (см. табл.2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИПСС
Габаритные размеры, мм, не более	200x170x65
Масса измерителя, кг, не более	0,5
Напряжение питания постоянного тока, В	9
Диапазон измеряемых температур, °С	-40... +100
Точность измерения температуры, °С:	
- в диапазоне от минус 40 до 0	±2
- в диапазоне от 0 до +50	±1
- в диапазоне от +50 до +100	±2
Диапазон измеряемой относительной влажности, %	0...100
Точность измерения относительной влажности, %:	
- в диапазоне от 0 до 20	5
- в диапазоне св. 20 до 80	3
- в диапазоне св. 80 до 100	5
Диапазон измерения атмосферного давления, мм рт.ст.	0...780
Точность измерения атмосферного давления, мм рт.ст.:	
- в диапазоне от 0 до 735	не нормируется
- в диапазоне св. 735 до 775	±2
- в диапазоне св. 775 до 780	не нормируется
Суточный ход часов в нормальных условиях, с/сут.	±10
Суточный ход часов во всем диапазоне рабочих температур и влажности, с/сут, не более	±25
Разрешающая способность:	
- по температуре, °С	0,1
- по влажности, %	0,1
- по атмосферному давлению, мм рт.ст.	1
- по времени, мин	1
Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96	IP32
Устойчивость к вибрации по ГОСТ Р52931-2008 (группа исполнения)	N2
Средняя наработка до отказа, часов	35 000

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- температура окружающего воздуха для:	
измерителя	от минус 30 до + 50 °С
датчика влажности	от минус 40 до + 100 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха для:	
измерителя	от 10 до 80 %, без конденсации влаги
датчика влажности	от 0 до 100 %.

Таблица 1


КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	Измеряемые параметры	Ключи регулирования
ИПСС-00	Время, температура, влажность	-
ИПСС-01	Время, температура, влажность, давление	-
ИПСС-02	Время, температура, влажность	Два ключа
ИПСС-03	Время, температура, влажность, давление	Два ключа

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Наименование	Кол-во	Примечание
Измеритель параметров среды стационарный ИПСС	1 шт.	
Руководство по эксплуатации МКСН.405544.007 РЭ	1 экз.	
Датчик влажности выносной	1 шт.	Наличие ДВВ обязательно. Выбирается по таблице 2
Блок питания ES25E09-P1J (9V; 2.77A)	1 шт.	
Кронштейн МКСН.301561.001	1 шт.	По отдельной заявке

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- контроль помещений на производствах, в музеях, библиотеках;
- аттестация рабочих мест;
- контроль хранения на складах;
- контроль систем вентиляции и кондиционирования воздуха, в теплицах и оранжереях.

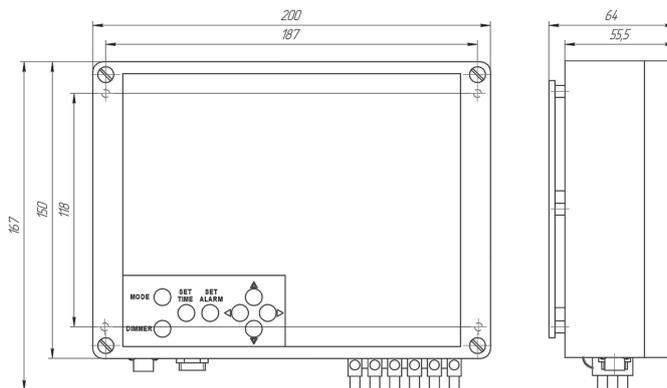

Габаритный чертеж ИПСС

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«ИПСС-02-ДВВ-400/500»

- Исполнение датчика влажности ДВВ  
Выбирается по таблице 2 далее
- Исполнение измерителя ИПСС  
Выбирается по таблице 1



## ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫНОСНЫЕ ДВВ



ДВВ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Датчик влажности выносной ДВВ предназначен для измерения температуры и влажности окружающего воздуха.

Таблица 2

Может использоваться совместно с измерителем параметров среды стационарным ИПСС и с контроллером цифровых датчиков портативным ПКЦД-1/100.

Условия эксплуатации и ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ смотри в разделе ИПСС.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Длина трубки L <sub>1</sub> , мм	Длина кабеля L <sub>2</sub> , мм	Рисунок
ДВВ-80/0	80	-	1
ДВВ-160/0	160	-	1
ДВВ-400/500	400	500	2
ДВВ-400/1000	400	1000	2
ДВВ-400/1500	400	1500	2
ДВВ-400/2000	400	2000	2
ДВВ-800/500	800	500	2
ДВВ-800/1000	800	1000	2
ДВВ-800/1500	800	1500	2
ДВВ-800/2000	800	2000	2

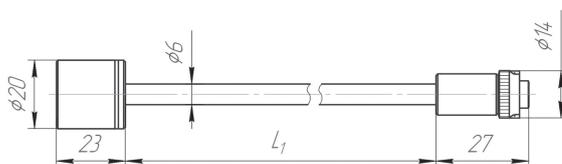


Рис. 1

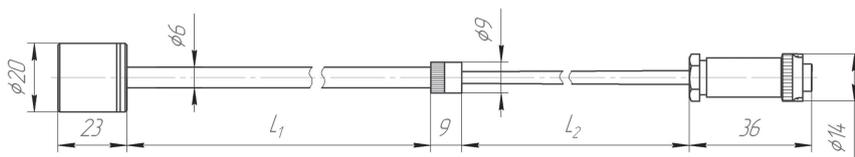


Рис. 2



## ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ-3

ТУ 4211-019-02566540-2004

### НАЗНАЧЕНИЕ:

предназначены для измерения и цифровой индикации температуры в Кельвинах при работе с внешним датчиком.

Приборы были разработаны по заказу омского ООО НТК "Криогентехника" для высокоточного измерения сверхнизких температур. Для связи с компьютером ИТ-3 имеют интерфейс RS-485, при помощи которого пользователь может объединить в сеть до 32-х приборов. Дистанционно можно вводить в ИТ-3 параметры подключенного к ИТ-3 датчика, номер прибора в сети RS-485, значение уставки и осуществлять настройку измерителя. Встроенное реле сигнализации делает возможным использовать ИТ-3 в качестве аварийного (включать защитные устройства). Измерители выполнены в металлическом, с защитой от вибраций, корпусе, настольного исполнения.



### ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА:


1 контактная группа реле - ~ 242 В, 3 А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИТ-3-0	ИТ-3-1
Тип датчика	ТСП 100П; $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100} = 1,3910$ ) с индивидуальной градуировкой	
Подключение датчика	4-проводное включение	
Диапазон измеряемых температур, К	15...373	
Вид индикации	цифровая светодиодная; 4 разряда (высота цифр 14 мм)	
Разрешающая способность индикации, К:		
- для температур менее 100 К	0,01	
- для температур 100 К и более	0,1	
Основная абсолютная погрешность, К, не более:		
- для температур 15...25 К	$\pm 0,2$	
- для температур 25...373 К	$\pm 1$	
Количество каналов измерения	1	
Количество каналов сигнализации	1	
Значение уставки, К	333+5	
Индикация замыкания контактов выходных устройств	1 красный светодиод	
Связь с ЭВМ	RS-485	
Степень защиты, обеспечиваемую оболочкой. ГОСТ 14254-2015	IP40	
Материал корпуса	металл	
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2	
Температура окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$	0...40	
Питание	$\sim (198-242) \text{ В};$ ( $50 \pm 2,5$ ) Гц	$\sim (216-264) \text{ В};$ ( $50 \pm 2,5$ ) Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	5	
Габаритные размеры, мм, не более	48x96x95	
Масса, кг, не более	0,5	


### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ:

- измерение и индикация температуры при работе с внешним датчиком ТСП 100П,  $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3910$ ) с индивидуальной градуировкой по четырехпроводной схеме подключения;
- отображение значений измеряемой температуры на четырехразрядном знаковом индикаторе;
- сигнализация о достижении заданной температуры;
- индикатор красного цвета для отображения состояния канала сигнализации (вкл./выкл.);
- обмен информацией с компьютером по интерфейсу RS 485;
- при подключении к компьютеру необходимо использовать преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 ДДШ 2.206.006;
- обмен информацией:
- между ИТ-3 и преобразователем интерфейса - RS -485;
- между преобразователем интерфейса и компьютером - RS-232.

### Структурная схема измерителя температуры ИТ-3

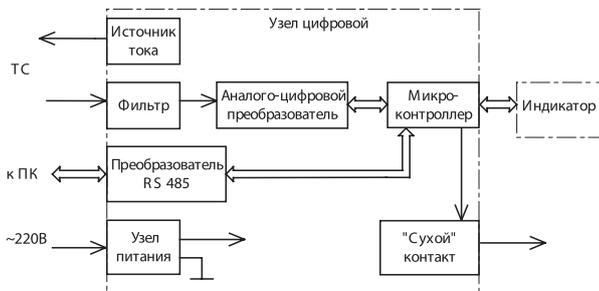

### Схема подключения ИТ-3

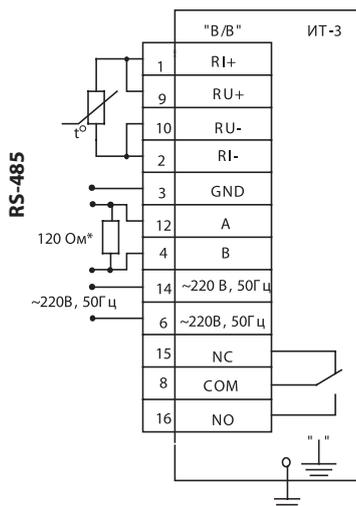

\*Резистор подключается к измерителям, установленным в начале и в конце линии связи. Мощность резистора не менее 0,25 Вт.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- ИТ-3;
- вилка РШ2Н-1-29;
- комплект монтажных частей;
- программное обеспечение;
- руководство по эксплуатации.

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Измеритель температуры ИТ-3-1

для работы от сети переменного тока  $\sim (216-264) \text{ В}, (50 \pm 2,5) \text{ Гц}$ .



## ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ-4

ТУ 4211-077-02566540-2006

### НАЗНАЧЕНИЕ:

предназначены для измерения и индикации температуры различных объектов.

Тип датчика, подключаемого к ИТ-4, в зависимости от исполнения	
Тип датчика, в зависимости от исполнения	ТХА(К), ТХК(Л), ТПП(С), ТПР(В), ТЖК(У), ТНН(Н), ТМК(Т), ТВР(А-1), ТВР(А-2), ТВР(А-3), ТСМ (50М, 100М; $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100} = 1,4280$ )), ТСП (50П, 100П; $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100} = 1,3850$ ), $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100} = 1,3910$ )), ТСМ (50М; $\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100} = 1,4260$ )), ТСМ (гр.23 53М; $W_{100} = 1,4260$ ), ТСП (гр.21 46П; $W_{100} = 1,3910$ ), унифицированный сигнал (0-5) мА, (4-20) мА, напряжение (0...10) В, (0...1) В, (0...100) мВ, (-50...50) мВ, (0...50) мВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИТ-4
Тип датчика, в зависимости от исполнения	см. таблицу 1
Подключение датчика	
- при работе с термоэлектрическими преобразователями (термопарами)	с компенсацией холодных концов термопары
- при работе с термометрами сопротивления	3-х проводное
Диапазон измеряемых температур	в соответствии с типом датчика
Вид индикации	цифровая светодиодная; 4 разряда (высота цифр 14 мм)
Разрешающая способность индикации, $^\circ\text{C}$	
- для температур -80,0...999,9 $^\circ\text{C}$	0,1
- для температур 1000 $^\circ\text{C}$ и выше	1
Основная погрешность, не более:	
- для ТХА(К), ТХК(Л), ТНН(Н), ТМК(Т)	5 $^\circ\text{C}$
- для ТПП(С), ТПР(В), ТВР(А-1), ТВР(А-2), ТВР(А-3)	7 $^\circ\text{C}$
- для ТСМ	1,5 $^\circ\text{C}$
- для ТСП	2 $^\circ\text{C}$
- унифицированный сигнал	0,25 %
Количество каналов измерения	1
Связь с ЭВМ	RS-485
Степень защиты, обеспечиваемую оболочкой. ГОСТ 14254-2015:	
- для щитового исполнения	IP20
- для настенного исполнения	IP54
Материал корпуса	пластмасса
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2
Температура окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$	0...40
Питание	~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	5
Габаритные размеры, мм, не более	
- для щитового исполнения	48x96x90
- для настенного исполнения	105x145x45
Масса, кг, не более	0,5



Щитовое исполнение



Настенное исполнение

Тип датчика	Диапазон измеряемых температур, $^\circ\text{C}$
ТХА(К)	-200...+1300
ТХК(Л)	-200...+800
ТПП(С)	0...+1750
ТПР(В)	+200...+1800
ТЖК(У)	-200...+1200
ТНН(Н)	-200...+1300
ТМК(Т)	-200...+400
ТВР(А-1)	0...+2500
ТВР(А-2)	0...+1800
ТВР(А-3)	0...+1800
ТСМ	-190...+200
ТСП	-200...+750

Схема подключения ИТ-4 с ТС


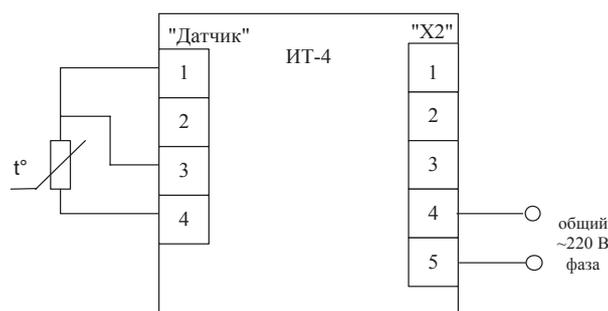


Схема подключения ИТ-4 с ТП

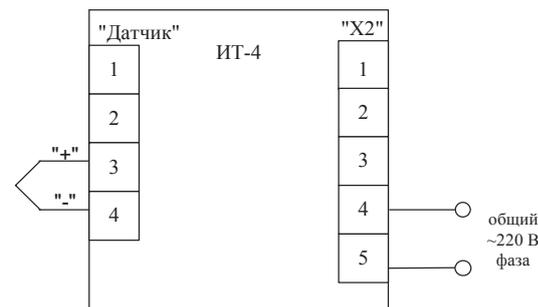

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ:

- малая погрешность;
- линеаризация сигналов от термопар и термосопротивлений в соответствии с НСХ преобразования;
- компенсация температуры холодных концов термопар;
- сигнализация о выходе измеряемой температуры за границы диапазона измерений;
- связь с компьютером по интерфейсу RS-485, сохранение данных измерений и последующая распечатка на принтере;
- возможность построения сети приборов (до 32 шт.);
- сторожевой таймер;
- щитовое и настенное исполнение.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- ИТ-4;
- комплект монтажных частей;
- программное обеспечение (по отдельной заявке);
- руководство по эксплуатации.




**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**


«ИТ-4-Х-Х»

- Тип корпуса:  
0 - щитовой;  
1 - настенный.
- Тип датчика:  
1 - ТХА(К);  
2 - ТХК(L);  
3 - ТПП(S);  
4 - ТПР(V);  
5 - ТСМ 50М;  $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,4280$ );  
6 - ТСМ 100М;  $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,4280$ );  
7 - ТСП 50П;  $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3910$ );  
8 - ТСП 50П;  $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3850$ );  
9 - ТСП 100П;  $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3910$ );  
10 - ТСП 100П;  $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3850$ ; Pt 10C  
11 - ТЖК(J);  
12 - унифицированный ток (0-5) мА;  
13 - унифицированный ток (4-20) мА;  
14 - унифицир. напряжение (0-10) В;  
15 - унифицир. напряжение (0-1) В;  
16 - унифицир. напряжение (0-100) мВ;  
17 - унифицир. напряжение (-50...+50) мВ;  
18 - унифицир. напряжение (0-50) мВ;  
19 - ТСМ гр. 23 ( $R=53 \text{ Ом}$ ,  $W_{100} = 1,4260$ );  
20 - ТСМ 100М;  $W_{100} = 1,426$ ;  
21 - ТСМ 50М;  $W_{100} = 1,426$ ;  
22 - унифицированный ток (0-20) мА;  
23 - ТНН(N);  
24 - ТМК(T);  
25 - ТВР(A-1);  
26 - ТВР(A-2);  
27 - ТВР(A-3);  
28 - ТСП гр. 21 ( $R=46 \text{ Ом}$ ,  $W_{100} = 1,3910$ );  
29 - ТСП гр. 22 ( $R=100 \text{ Ом}$ ,  $W_{100} = 1,3910$ ).

**Схема подключения ИТ-4 с ПИ с выходным током**

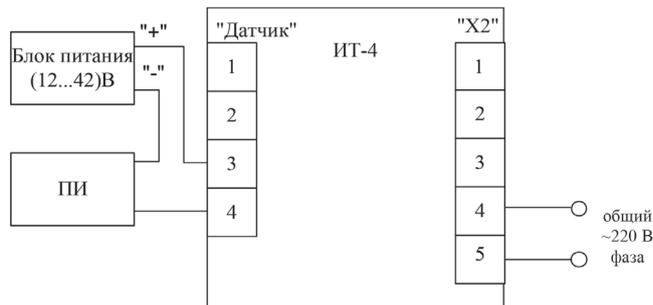

**Схема подключения ИТ-4 с ПИ с выходным напряжением**

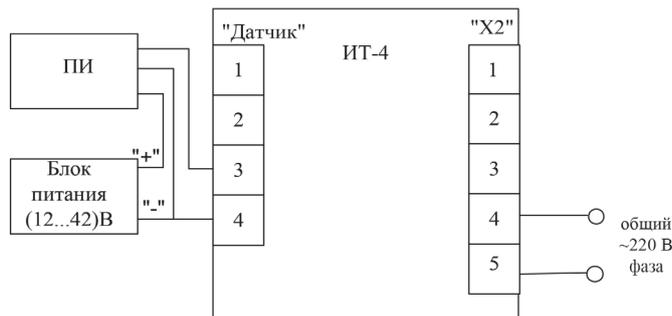

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

Измеритель температуры ИТ-4 для работы с датчиками ТХА(К) в корпусе щитового исполнения:

**«ИТ-4-1-0»**

Измеритель температуры ИТ-4 для работы с унифицированным токовым сигналом (0-20) мА в корпусе настенного исполнения:

**«ИТ-4-22-1»**

**ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ МИТ-12**



**ТУ 4211-087-0256540-2008**

Многоканальные измерители температуры МИТ-12 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под N 41479-09. Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.32.005.А N 36488/1

Декларация ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.74922/22 от 22.08.22 о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

МИТ-12 - это щитовые приборы, предназначенные для проведения высокоточных измерений температуры при помощи термометров сопротивления (ТС) по ГОСТ Р 8.625-2006 или преобразователей термоэлектрических (термопар, ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001 по 12-ти каналам, представления информации по каждому каналу на цифровом дисплее прибора и передачи измеренных значений на ЭВМ.

Приборы, в зависимости от исполнения, имеют следующие обозначения: **МИТ-12ТС** - для работы с ТС; **МИТ-12ТП** - для работы с ТП.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:**

Переключение каналов осуществляется автоматически или вручную с клавиатуры приборов или с компьютера. Время работы с каждым каналом до переключения на следующий канал (при работе в режиме автоматического переключения каналов) - от 1 до 8 секунд, выбирается потребителем. Приборы имеют две независимые "уставки", значения которых определяются для всех каналов сразу.

Выбор режима работы, типа датчика, скорости переключения каналов, а также значений "установок" осуществляется при помощи 4-х кнопочной клавиатуры прибора или с компьютера (для МИТ-12ТП имеется возможность выбора включения/отключения внешнего компенсатора ЭДС холодных концов термопар).



**Выходные устройства сигнализации:**

2 контактных группы реле - ~ 242 В, 5 А

**ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ПРИБОРОВ:**

- высокая точность измерения температуры;
- возможность сохранения параметров настройки после выключения питания приборов;
- возможность обмена данными с ЭВМ по интерфейсу RS-485;
- передача на ЭВМ данных из приборов;
- в приборах полностью исключено влияние каналов друг на друга за счет применения в качестве коммутирующих элементов контактов миниатюрных электромагнитных реле;
- **межканальное напряжение может составлять до 400 вольт без повреждений и нарушения работы прибора;**
- протокол обмена MODBUS RTU позволяет использование прибора в SCADA системах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ*	МИТ-12ТП	МИТ-12ТС
Типы датчиков**	ТХА(К), ТХК(Л), ТПП(С), ТПР(В)	ТСП 50П, 100П; $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100} = 1,3850$ ), $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100} = 1,3910$ ); ТСМ 50М, 100М; $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100} = 1,4280$ )
Подключение датчика:	- через внешний компенсатор ЭДС холодных концов термопар	- 4-проводное включение, подключение через внешнюю плату клеммных соединителей
Диапазон измеряемых температур	по типу датчика	
Вид индикации	цифровая светодиодная; 4 разряда – измеряемая температура; 2 разряда – номер канала	
Разрешающая способность индикации, $^\circ\text{C}$ :	0,1	
- при температурах менее $1000^\circ\text{C}$	-	
- при температурах не менее $1000^\circ\text{C}$ и выше	1	-
Основная погрешность, $^\circ\text{C}$ , не более:		
- для ТХА(К)***, ТХК(Л)***	$\pm 1,0$ в диапазоне от $-99,9$ до $999,9 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\pm 2,0$ в диапазоне от $1000$ до $1372^\circ\text{C}$	-
- для ТПП(С)***	$\pm 2,0$	-
- для ТПР(В)***	$\pm 3,0$	-
- для ТСП, ТСМ	-	$\pm 0,5$
Связь с ЭВМ	RS-232; RS-485, в зависимости от исполнения	
Возможности программного обеспечения, поставляемого в комплекте с прибором	настройка всех параметров при помощи ЭВМ; получение информации об измеренной температуре, сохранение ее в удобном для дальнейшей обработки виде, в т.ч. стандартными средствами (MS-Excel, MS-Word); ряд других функций	
Среда функционирования программного обеспечения	Windows 95, 98, 2000, XP 7, 8, 9, 10	
Система автоматического определения неисправностей	есть	
Степень защиты, обеспечиваемую оболочкой. ГОСТ 14254-2015.	IP40	
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2	
Температура окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$	0...40	
Питание	$\sim 220 \text{ В}$ ; 50 Гц	
Ток потребления, мА, не более	46	
Габаритные размеры, мм, не более	96x96x240	
Масса, кг, не более	1,5	
* характеристики адаптера интерфейса RS-485 см. "Система измерения температуры СИТ"		
** конкретный тип датчика переключается с клавиатуры для всех каналов одновременно		
*** погрешность нормируется с учетом погрешности внешнего компенсатора температуры холодных концов.		
**** не требует компенсации холодных концов		

Тип датчика	Диапазон измеряемых температур, $^\circ\text{C}$
ТХА(К)	$-99,9 \dots +1372$
ТХК(Л)	$-99,9 \dots +800$
ТПП(С)	$0 \dots 1768$
ТПР(В)	$300 \dots 1820$
ТСМ	$-99,9 \dots +200$
ТСП	$-99,9 \dots +850$

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИТ-12ТС


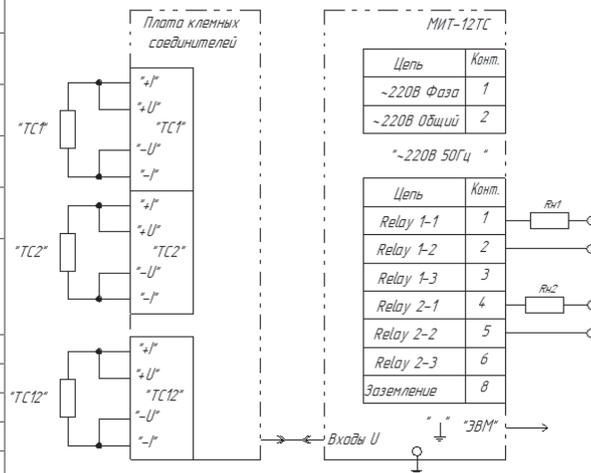


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИТ-12ТП

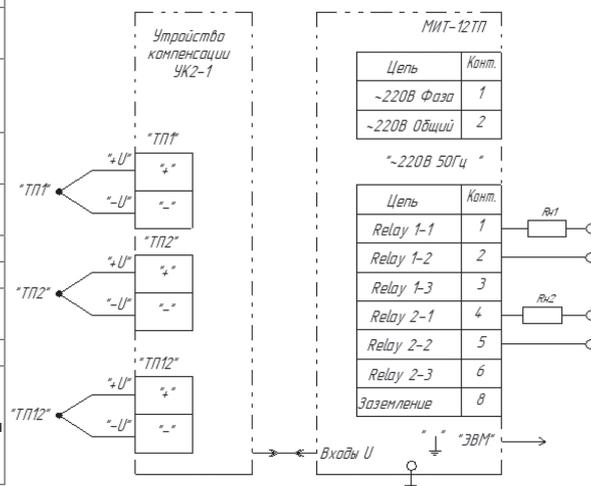


**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- многоканальный измеритель температуры МИТ-12 - 1 шт;
- устройство компенсации УК-2-1 ДДШ 2.821.156-01 (для МИТ-12 ТП) - 1 шт;
- плата клеммных соединителей ДДШ 5.182.202 (для МИТ-12 ТС) - 1 шт;
- кабель ДДШ 6.644.060: для МИТ-12ТП-1 шт.; для МИТ-12ТС-1 шт;
- кабель интерфейсный ДДШ 6.644.079 для связи прибора с компьютером (для МИТ-12 с интерфейсом RS-232) L=2 м.\* 1 шт;
- программное обеспечение для интерфейса RS-232 с ЭВМ - 1 комплект;
- адаптер интерфейса RS-485 ДДШ 2.206.009-01 (для МИТ-12 с интерфейсом RS-485) - 1 шт;
- руководство по эксплуатации ДДШ 2.821.155 РЭ 1 экз.;

\* По отдельной заявке кабель может быть выполнен длиной до 15 метров.

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

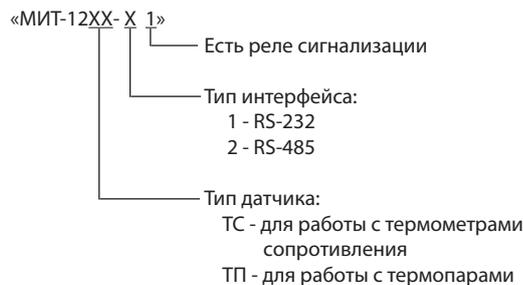

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

МИТ-12 для работы с ТС, с интерфейсом RS232 и наличием исполнительных реле:  
«МИТ-12ТС-11»





## СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СИТ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Система измерения температуры СИТ предназначена для измерения температуры при помощи нескольких (от 1 до 32) многоканальных измерителей температуры МИТ-12 и сбора измеренных значений на ЭВМ. **ВНИМАНИЕ** - Подключение к компьютеру МИТ-12, имеющих интерфейс RS-485, возможно только в составе СИТ.

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ:

- прием и формирование файла измеренных значений температуры от МИТ-12 (до 32 шт.);
- прием и изменение на ЭВМ параметров процесса измерения выбранного оператором МИТ-12 или группы МИТ-12.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Система СИТ состоит из преобразователя интерфейса USB/RS-485 и нескольких МИТ-12, каждый из которых имеет собственный адаптер интерфейса RS-485. Все МИТ-12 через адаптеры интерфейса подключаются по интерфейсу RS-485 к преобразователю интерфейса USB/RS-485. Преобразователь интерфейса подключается к компьютеру по интерфейсу RS-232.

В ходе эксплуатации допускается наращивать количество МИТ-12 в составе СИТ.

При этом:

- в случае поставки МИТ-12 в составе СИТ МИТ-12 не комплектуются адаптером интерфейса, необходимое количество адаптеров интерфейса поставляется в составе СИТ;
- в случае поставки МИТ-12 с интерфейсом RS-485 как отдельного изделия адаптер интерфейса поставляется в комплекте с МИТ-12.

### Схема включения приборов с размещением преобразователя интерфейса USB/RS-485 в конце линии связи (двухпроводная линия связи)

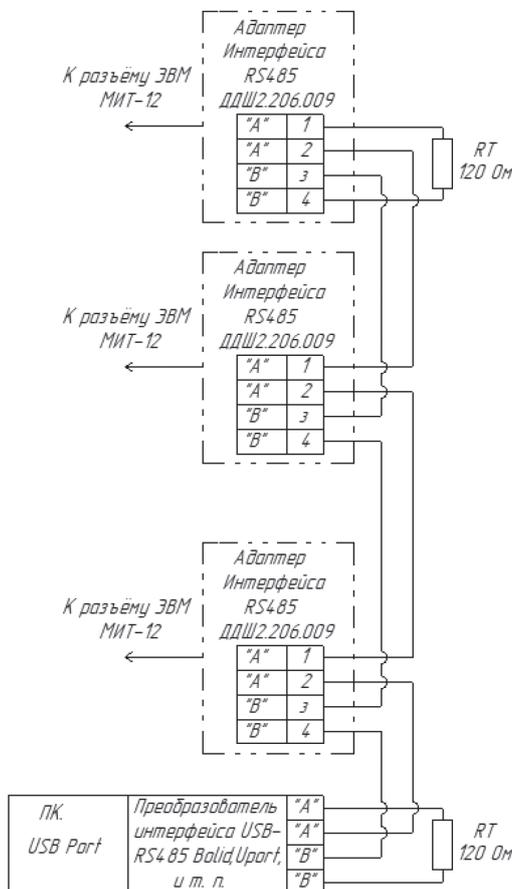


Рис.2 см. на сайте [www.omsketalon.ru](http://www.omsketalon.ru)

Рис.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*	СИТ
Количество МИТ-12 в СИТ, шт.	1...32
Связь с ЭВМ	RS-485
Время приема измеренных значений от одного МИТ-12, с	2
Период приема значений температуры от МИТ-12 в случае последовательного приема данных от 32-х приборов, с, не более	64
Суммарное сопротивление линии «+UCC» при конфигурации СИТ в соответствии с рис. 1 и 2 (см. схему электрическую соединений СИТ), Ом, не более	30
Суммарное сопротивление линии «0V» при конфигурации СИТ в соответствии с рис. 1 и 2 (см. схему электрическую соединений СИТ), Ом, не более	4
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96	
- адаптера интерфейса RS-485	IP20
Температура окружающего воздуха, °C	0...40
Питание	
- адаптера интерфейса RS-485	не требует отдельного питания
Габаритные размеры, мм, не более	
- адаптера интерфейса RS-485	64x33x16
*Характеристики, определяемые характеристиками МИТ-12, входящих в состав СИТ, см. "Многоканальные измерители температуры МИТ-12"	

### Замечания к схеме электрической соединений СИТ (рисунки 1, 2):

1. Количество приборов МИТ-12 ДДШ2.821.155 n=1...32.
2. При проектировании сети используйте рекомендации RS-485 (EIA/TIA-485)

Также, возможно реализовать схему включения приборов с размещением преобразователя интерфейса USB/RS-485 не в конце линии связи. (См. Рис.2 или РЭ на сайте [www.omsketalon.ru](http://www.omsketalon.ru))

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:


- МИТ-12<sup>1</sup> (количество N=1...32 шт.);
- адаптер интерфейса RS-485 ДДШ2.206.009<sup>2</sup> (N шт.);
- программное обеспечение<sup>2</sup>;
- руководство по эксплуатации ДДШ1.270.009 РЭ<sup>2</sup>.

### Примечание - Верхний цифровой индекс означает:

- 1 – количество конкретных исполнений приборов МИТ-12 определяется согласно обозначению конкретного исполнения СИТ;
- 2 – входит в минимальный комплект поставки.

### ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Система измерения температуры СИТ-XX-XX-XX-XX-XX»

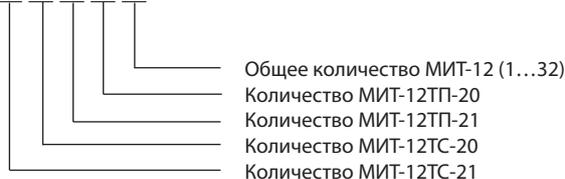

# ИЗМЕРИТЕЛИ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛООВОГО ПОТОКА И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

## ДАТЧИКИ ТЕПЛООВОГО ПОТОКА ДТП 0924

МКСН.405229.001 ТУ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Датчики теплового потока ДТП 0924 предназначены для измерения теплового потока и (или) поверхностной плотности теплового потока, сопровождающего различные физические и биологические процессы. Также могут быть использованы в качестве рабочего средства измерения поверхностной плотности теплового потока при испытании различных строительных изделий, как в лабораторных с применением климатической камеры, так и в натуральных условиях.

### Габаритные размеры и форма определяются при заказе.

Датчики теплового потока ДТП 0924 работают с приборами: ИТ-6, МИТ, МИФВ, ИТВ, ИТП-11, а также с прецизионными измерителями напряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДТП 0924
Диапазон измеряемых плотностей теплового потока, Вт/м <sup>2</sup>	10 ÷ 1000
Коэффициент преобразования, мВ/(Вт/м <sup>2</sup> )	10 ÷ 50
Погрешность, %, не более	8
Рабочий диапазон температур, °С	10...100
Термическое сопротивление, м <sup>2</sup> К/Вт	0,02...0,09

### ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

ДТП 0924 - Р -  $\frac{X}{1}$  -  $\frac{X-X}{2}$  -  $\frac{X}{3}$

1	Форма	
	Д	<b>Диск:</b> изготавливаются диаметром до 275 мм включительно
2	П	<b>Пластина:</b> изготавливаются с размерами до 210 мм включительно
	Габаритные размеры:	
3	0	нет
	1	термопара ТХА (К)



ДТП 0924-Р-П-100-0



ДТП 0924-Р-Д-275-0

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Датчик плотности теплового потока ДТП 0924-Р-П-100-0»



## ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ИТ-6

МКСН.405544.026ТУ

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Измеритель температуры многоканальный ИТ-6 предназначен для измерения температуры при помощи подключаемых преобразователей термоэлектрических (термопар, ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585 и измерения теплопроводности (термического сопротивления) по ГОСТ Р 54853 и ГОСТ 26602.1 при помощи датчиков теплового потока, подключаемых по 96, 80, 64, 48, 32 или 16 каналам в зависимости от исполнения ИТ-6 с последующей передачей данных на ЭВМ. Результаты измерения в мВ, Вт/м<sup>2</sup> или °С выводятся на экран компьютера в виде таблицы и графиков. Измерители температуры и теплопроводности многоканальные ИТ-6 могут использоваться в качестве устройства автоматизированного сбора и обработки информации различных телеметрических систем. Измерители температуры и теплопроводности многоканальные ИТ-6 в комплекте с преобразователями плотности теплового потока и преобразователями термоэлектрическими может использоваться в составе системы измерения термического сопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИТ-6
Количество измерительных каналов (в зависимости от исполнения прибора)	16, 32, 48, 64, 80, 96
Диапазон измерения напряжения с выходов датчиков, мВ	- 499,999... + 499,999
Вид индикации	на экране компьютера
Разрешающая способность индикации:	
- напряжения U, мВ	0,001
- плотности теплового потока q, Вт/м <sup>2</sup>	0,01
- температуры t, °С	0,01
Основная абсолютная погрешность, мкВ, не более, где U <sub>изм</sub> – значение модуля измеренного напряжения, мкВ	$\pm (6 + 1,5 \cdot 10^{-4} \cdot U_{изм})$
Связь с ЭВМ	USB
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96	IP20
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4.1
Температура окружающего воздуха, °С	от плюс 5 до плюс 40
Питание	порт USB 5 В
Ток потребления, не более, mA, не более	50
Габаритные размеры прибора, мм, не более:	
- блок КИ-16	135x80x35
- преобразователь USB/RS-485	70x25x10
Масса, кг, не более:	
- блок КИ-16	0,14
- преобразователь USB/RS-485	0,04

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Измерители температуры многоканальные ИТ-6 состоят из преобразователя USB/RS-485 и коммутаторов измерительных КИ-16 (по 1 шт. на каждые 16 каналов). ИТ-6 соединяются с компьютером по интерфейсу USB.

Каждый КИ-16 содержит микроконтроллер, коммутатор, АЦП, датчик температуры холодных концов и преобразователь интерфейса RS-485.


Коммутаторы измерительные КИ-16 измеряют значение напряжения по каждому из каналов, снимают показания датчиков температуры холодных концов термопары и передают через преобразователь USB/RS-485 все эти значения на компьютер. Компьютер на основе полученных данных определяет значения плотности теплового потока или температуры. Результаты измерения выводятся на экран компьютера в виде значений напряжения, плотности теплового потока, температуры, и графиков напряжения, плотности теплового потока, температуры.

Измерение производится циклами. В ходе одного цикла измерений блок КИ-16 производит измерение по всем каналам и передает данные на компьютер.

Приборы могут работать в режиме непрерывного измерения, когда после очередного цикла измерения следует следующий цикл, или производить заданное количество циклов измерения.

Также у приборов имеется возможность производить измерения с программируемой задержкой между циклами измерений от 20 с до 60 мин.

ИТ-6

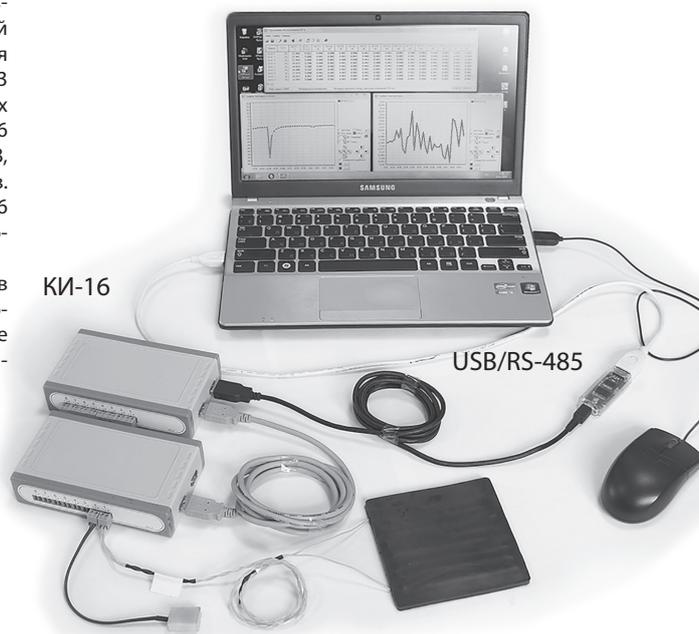

КИ-16

USB/RS-485

## ФУНКЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИБОРОМ:

- измерение напряжения, плотности теплового потока и температуры по 16,32,48,64,80,96 каналам в зависимости от исполнения прибора;
- измерение температуры холодных концов термопар;
- отображение результатов измерения на экране монитора персонального компьютера.

## ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

- выбор интервала времени между циклами измерений (20с...60 с) с дискретностью 1 с для значений времени до 1 мин и 1 мин для значений времени от 1 до 60 мин;
- выбор режима измерений: непрерывное измерение или заданное количество циклов измерений (от 1 до 1000);
- выбор опрашиваемых каналов, возможность включения/выключения опроса индивидуально для каждого канала;
- вывод в таблицу температуры холодных концов термопар;
- возможность вывода в таблицу времени или номера текущего измерения;
- вывод измеренных значений в таблицу тремя способами:

## 1. Напряжение, мВ

## 2. Плотность теплового потока

$q = A_0 + A_1 U_{изм} + A_2 (U_{изм})^2 + A_3 (U_{изм})^3 + A_4 (U_{изм})^4$ , Вт/м<sup>2</sup>, где A<sub>0</sub>...A<sub>4</sub> - коэффициенты полинома (задаются потребителем), U<sub>изм</sub> - измеренное значение напряжения.

Способ вывода в таблицу и значения коэффициентов A<sub>0</sub>...A<sub>4</sub> определяются индивидуально для каждого канала;

## 3. Температура


Тип термопары выбранного канала:

ТПП 13(R), ТПП 10(S), ТПП(B), ТЖК(J), ТМК(T), ТХК<sub>н</sub>(E), ТХА(K), ТНН(N), ТВР(A-1), ТВР(A-2), ТВР(A-2), ТХК(L), ТМК(M), °С;

- сохранение данных в файле, который может быть обработан как посредством программы обслуживания, так и любыми стандартными средствами, позволяющими работать с текстовыми файлами. Также предусмотрена обработка средствами Microsoft Excel;
- печать данных;
- проведение подстройки прибора.



**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА ИТ-6**

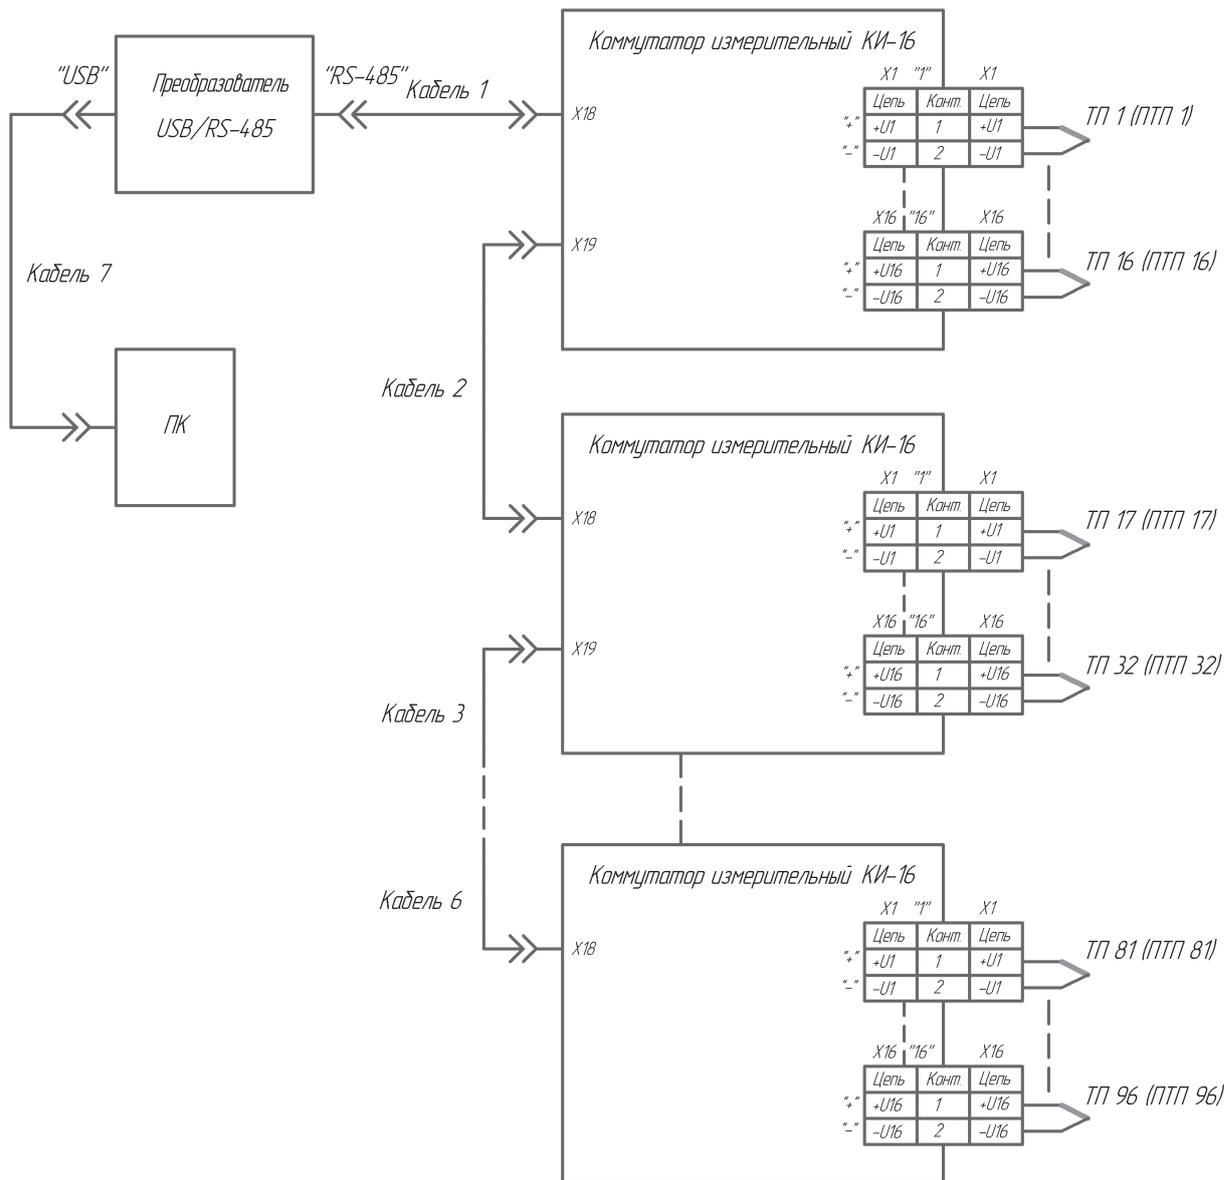

Кабель 1 - кабель USB 2.0 AM/miniB 5P;  
 Кабель 2 ... кабель 6 - кабель USB (п-п) тип А-А;  
 Кабель 7 – кабель удлинительный USB 2.0 AM/AF.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

На схеме указан случай подключения к ИТ-6 термопарных датчиков. При необходимости, вместо каждого из термопарных датчиков может быть подключен датчик плотности теплового потока или датчик другой физической величины, имеющий выходной сигнал в виде напряжения, не выходящего за границы диапазона измерения ИТ-6.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- коммутатор измерительный КИ-16 (1 шт. на каждые 16 каналов);
- преобразователь USB/RS-485 (1 шт);
- кабель USB (п-п) тип А-А, 1,5 м (1 шт);
- кабель удлинительный USB 2.0 AM/AF, 0,75м (1 шт);
- кабель USB 2.0 AM/miniB 5P, 1,0 м (1 шт);
- программное обеспечение (CD-диск);
- руководство по эксплуатации.

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

"ИТ - 6 - ХХ",  
 где ХХ - число каналов, кратное 16.



## ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ МИТ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Измеритель температуры многоканальный МИТ предназначен для измерения температуры при помощи подключаемых преобразователей термоэлектрических типа ТХА или ТХК с НСХ преобразования по ГОСТ Р 8.585, и для измерения плотности тепловых потоков по ГОСТ 25380, регистрации измеренных значений температуры и плотности теплового потока в энергонезависимую память прибора, а также вывод результатов измерения на монитор ПК в виде таблицы.

МИТ в комплекте с преобразователями теплового потока и преобразователями термоэлектрическими может использоваться в составе системы для измерения термического сопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений.

### ОСОБЕННОСТИ:

- выбор типа датчика по каналам и сохранение его в памяти прибора (только для МИТ-8);
- наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей хранить конфигурацию после выключения питания;
- регистрация в энергонезависимую память измеренных значений плотности теплового потока или температуры с возможностью передачи данных на ЭВМ;
- регистрация измеренных значений плотности теплового потока или температуры с интервалами от 5 сек до 60 мин и передача данных на ЭВМ (только для МИТ-8);
- работа с преобразователями плотности теплового потока с коэффициентом преобразования от 10,0 до 99,9 Вт/м<sup>2</sup>мВ и двумя типами термопар. Переключение типа датчика осуществляется с клавиатуры прибора (только для МИТ-16).

МИТ-8 с УК-7



### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Прибор имеет порт USB для связи с компьютером. С прибором поставляется специальное сервисное программное обеспечение, выполняющее следующие функции:

- считывание данных из памяти прибора;
- обработка полученных данных: представление их в табличном и графическом видах;
- сохранение полученных данных в файл на ЭВМ с возможностью последующей загрузки этого файла в оболочку сервисного программного обеспечения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МИТ-8	МИТ-16
Тип датчика	Датчик теплового потока; Термопары ТХА(К), ТХК(L);	
Диапазон измерения плотности теплового потока, Вт/м <sup>2</sup>	0 ... 1000	
Диапазон измерения температуры, °С	-50...+1300 ТХА(К) -50...+800 ТХК(L)	
Абсолютная основная погрешность измерения плотности теплового потока, Вт/м <sup>2</sup>	0,4...4,0*	
Абсолютная основная погрешность измерения температуры, °С	± 1,5**	
Вид индикации	ЖКИ, 10 символов	
Разрешающая способность индикации	0,1	
Количество измерительных каналов	8	16
Время измерения одного канала, с, не более	1	
Ручная регистрация измеренных значений	есть	
Связь с ЭВМ	USB	
Среда функционирования программного обеспечения	Windows 95, 98, XP, 7	
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды	IP20	
Температура окружающего воздуха, °С	-10...50	
Питание	+9В, элемент питания типа "Крона"	
Ток потребления, мА, не более	3	
Габариты, мм, не более	310x80x40	
Масса, кг, не более	0,5	
* - в зависимости от значения коэффициента преобразования датчика теплового потока ( $\Delta = 0,04 \cdot C$ , где $\Delta$ - абсолютная основная погрешность, Вт/м <sup>2</sup> ; C – значение коэффициента преобразования ДТП, Вт/м <sup>2</sup> мВ);		
** - погрешность нормируется с учетом погрешности внутреннего компенсатора температуры свободных концов термопары.		


### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- МИТ-8 (16);
- устройство компенсации УК-7 (УК-6);
- кабель для связи с компьютером;
- программное обеспечение;
- руководство по эксплуатации.

Батарея в комплект поставки не входит.

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

« Измеритель температуры многоканальный  
МИТ - XX ТУ 4221-089-02566540-2010 »





## ИЗМЕРИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН МНОГОКАНАЛЬНЫЕ МИФВ

МКСН.405544.030 РЭ

МИФВ-1

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Измеритель физических величин многоканальный МИФВ предназначен для измерения, хранения и обработки данных, полученных от подключаемых преобразователей физических величин (температуры, плотности теплового потока, напряжения, массы).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Значение
Количество каналов измерения КИ-4 ТЕНЗО	4
Количество каналов измерения КИ-8 ТЕРМО	8
Диапазоны измеряемых параметров: - плотности теплового потока, Вт/м <sup>2</sup> - температуры, °С - напряжения, мВ - коэффициент преобразования, мВ/В	10...100 -100...1800 5...500 ± 5,0
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении плотности теплового потока, Вт/м <sup>2</sup> , не более, где С - значение коэффициента преобразования ПТП, Вт/(м <sup>2</sup> ·мВ)	±(0,006·С)
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении напряжения, мкВ, не более, где Uизм - значение модуля измеренного напряжения, мкВ	± (6 + 1,5·10 <sup>-4</sup> ·Uизм)
Время измерения одного модуля, с, не более	25
Возможность выбора периода регистрации, мин	1-60
Установка типа датчика по каналам	есть
Отображение значений измеренных величин во времени на экране прибора в виде таблицы	есть
Регистрация измеренных значений в отдельный файл на SD card	есть
Питание: - блок питания напряжением, В	5
Потребляемая мощность ВА, не более	5
Габаритные размеры, мм:	
- модуля	135x80x35
- УСИ-1	250x220x115



### ПРИБОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВВОД С КЛАВИАТУРЫ:

- количества измерений (1...9999);
- индикации выключения прибора после измерений;
- даты и времени встроенных часов;
- интервала времени между циклами измерений (25...60) с; (1...60) мин.;
- единицы измерения для каждого модуля и каждого канала модуля для МИФВ-1 (мВ; °С; Вт/м<sup>2</sup>);
- коэффициента преобразования ПТП (0,1...99,9 Вт/(м<sup>2</sup>·мВ));
- вывод на экран результатов измерений каждого канала модуля;
- вывод на экран значений температуры холодных концов термопар;
- отображение на экране названия последнего сохраненного файла;
- запись результатов измерений на SD карту;
- подстройку по внешним опорным сигналам;
- отключение после проведения измерений.

Модули преобразуют аналоговые сигналы преобразователей в цифровую форму и передают её устройству сбора информации УСИ-1 по интерфейсу RS-485. УСИ-1 обрабатывает результаты измерений в соответствии с установленной конфигурацией и сохраняет их на SD карте.

### ПРИБОР ВЫПУСКАЕТСЯ ДВУХ ВИДОВ: МИФВ-1 и МИФВ-2.


Прибор состоит из устройства сбора информации УСИ-1, коммутаторов измерительных КИ-8 ТЕРМО (далее – модулей) для МИФВ-1 или коммутаторов измерительных КИ-4 ТЕНЗО (далее – модулей) для МИФВ-2.

### ВИД И КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИБОРА:

ИСПОЛНЕНИЕ	Кол-во КИ-8 ТЕРМО, шт.	Кол-во КИ-4 ТЕНЗО, шт.
МИФВ-1-1	1	-
МИФВ-1-2	2	-
МИФВ-1-3	3	-
МИФВ-1-4	4	-
МИФВ-1-5	5	-
МИФВ-1-6	6	-
МИФВ-2-1	-	1
МИФВ-2-2	-	2
МИФВ-2-3	-	3
МИФВ-2-4	-	4
МИФВ-2-5	-	5
МИФВ-2-6	-	6

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Измеритель физических величин многоканальный МИФВ- X - X МКСН.405544.030 ТУ»



### Типы используемых преобразователей, диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности МИФВ-1:

Тип используемых преобразователей	Условное обозначение НСХ	Диапазон измеряемых температур, °С	Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %
ТПР	В	от 300 до 1800	± 0,5
ТПП	С	от 0 до 1750	±0,3
ТХА	К	от - 50 до 1370	± 0,5
ТХК	Л	от - 50 до 800	± 0,25
ТСМ	50М	от -100 до 200	± 0,2
ТСМ	100М	от -100 до 200	±0,2
ТСП	50П	от -100 до 850	± 0,2
ТСП	100П	от -100 до 850	± 0,2
ТС	Pt50	от -100 до 850	± 0,2
ТС	Pt100	от -100 до 850	± 0,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ:	Кол-во	Примечание
Устройство сбора информации УСИ-1	1 шт.	
Коммутатор измерительный		
КИ-4 ТЕНЗО	от 1 до 6 шт. *	для МИФВ-2
Коммутатор измерительный		
КИ-8 ТЕРМО	от 1 до 6 шт. *	для МИФВ-1
Кабель	от 1 до 6 шт. *	
Соединитель 15EDGK-3,5-04P-1-4	от 8 до 48 шт. *	для МИФВ-1
Соединитель 15EDGK-3,5-06P-1-4	от 4 до 24 шт. *	для МИФВ-2
Руководство по эксплуатации	1 экз.	
Формуляр	1 экз.	

\* Количество в зависимости от исполнения.



## ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ИТВ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Измеритель теплофизических величин ИТВ предназначен для измерения, хранения и обработки данных, полученных от подключаемых первичных преобразователей физических величин (температуры, плотности теплового потока, напряжения).

Прибор позволяет по полученным результатам измерения определить сопротивление теплопередаче и термическое (тепловое) сопротивление ограждающих конструкций по ГОСТ Р 54853, а также блоков оконных и дверных по ГОСТ 26602.1.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Предприятия стройиндустрии для учета количества энергетических ресурсов, предприятия теплоэнергетики, машиностроение, металлургия.

**ПРИБОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВВОД С КЛАВИАТУРЫ:**

- количества подключаемых модулей (1...6);
- количества измерений (1...9999);
- индикации выключения прибора после измерений;
- даты и времени встроенных часов;
- интервала времени между циклами измерений (25...60) с; (1...60) мин.;
- единицы измерения для каждого модуля и каждого канала модуля (мВ; °С; Вт/м<sup>2</sup>);
- коэффициента преобразования ПТП (0,1...99,9 Вт/(м<sup>2</sup>·мВ));
- вывод на экран результатов измерений каждого канала модуля;
- вывод на экран значений температуры холодных концов термопар;
- отображение на экране названия последнего сохраненного файла;
- запись результатов измерений на SD карту;
- подстройку по внешним опорным сигналам;
- отключение после проведения измерений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Значение
Количество каналов измерения и регистрации (в зависимости от заказа)	16, 32, 48, 64, 80, 96
Диапазоны измеряемых параметров: - плотности теплового потока, Вт/м <sup>2</sup> - температуры, °С - напряжения, мВ	10...100; - 50...1300; 5.....500
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении плотности теплового потока, Вт/м <sup>2</sup> , не более, где С – значение коэффициента преобразования ПТП, Вт/(м <sup>2</sup> ·мВ).	±(0,006·С)
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности отображаемых значений при измерении температуры, °С	1
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения, мкВ, не более, где U <sub>изм</sub> – значение модуля измеренного напряжения, мкВ	± (6 + 1,5·10 <sup>-4</sup> ·U <sub>изм</sub> )
Предел допускаемой дополнительной погрешности при измерении температуры, не более	половины предела допускаемой основной погрешности на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха
Разрешающая способность при измерении: - плотности теплового потока, Вт/м <sup>2</sup> - температуры, °С	0,1 0,1
Время измерения одного модуля, с, не более	25
Возможность выбора периода регистрации, мин	1-60
Установка типа датчика по каналам	есть
Отображение значений измеренных величин во времени на экране прибора в виде таблицы	есть
Регистрация измеренных значений в отдельный файл на SD card	есть
<b>Обработка результатов измерений сервисной программой обслуживания</b>	<b>есть</b>
Питание: - аккумуляторная батарея напряжением, В	5
Потребляемая мощность В, не более	10
Время автономной непрерывной работы, ч, не менее	100
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Диапазон рабочих температур эксплуатации, °С	-10...50
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры, мм	250x220x115
Масса, кг	3,2



**ДОСТОИНСТВА:**

1. Позволяет мобильно проводить испытания строительных ограждающих конструкций энергетических объектов в лабораторных и натуральных условиях;
2. Возможность проведения непрерывных, в течение нескольких суток, синхронных наблюдений теплового состояния ограждающих конструкций в исследуемых характерных точках;
3. Позволяет обрабатывать результаты испытаний оконных и дверных блоков, стен сервисной программой обслуживания с выдачей протокола испытаний.
4. Высокий метрологический уровень контроля ограждающих конструкций в натуральных условиях.
5. Датчики соединяются с прибором посредством разъема. При выходе из строя датчика, его можно заменить на другой самостоятельно.
6. Удобен для оперативного транспортирования. Прибор выполнен в виде удобного кейса.
7. Удобен и прост в эксплуатации.

Архив измеренных значений сохраняется на внешнем носителе информации (SD card). ИТВ имеет возможность выбора периода сохранения информации в архив значений от 25 сек до 60 мин на канал.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«ИТВ в комплекте:

- УСИ-1 - 1 шт.;
- КИ-16 - 3 шт.;
- Кабель МКСН.434641.060 - 2 шт.;
- Кабель USB - 1 шт.;
- Программное обеспечение - 1 экз.»

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**


Наименование	Обозначение	Количество
Устройство сбора информации <sup>1)</sup>	УСИ-1 МКСН.465614.001	1 шт.
Коммутатор измерительный <sup>1), 2)</sup>	КИ-16 МКСН.411611.001	1 шт.
Кабель 20 м <sup>1), 3)</sup>	МКСН.434641.060	1 шт.
Кабель USB (n-n) тип А-А; 1,5 м <sup>3)</sup>		
Датчик плотности теплового потока <sup>1)</sup>	ДТП0924-Э-Д-27-0	2 шт.
Преобразователь термоэлектрический <sup>1)</sup>	ТХА 1105-01	6 шт.
Преобразователь термоэлектрический <sup>1)</sup>	ТХА 9417	6 шт.
Программное обеспечение <sup>1)</sup>	643.02566540.00021-01	1 шт.
Руководство по эксплуатации <sup>1)</sup>	МКСН.405544.023 РЭ	1 экз
Формуляр	МКСН.405544.023 ФО	1 экз

- 1) - входит в минимальный комплект поставки;
- 2) - количество КИ-16 определяется заказчиком (не более 6 шт.);
- 3) - количество кабелей определяется заказчиком (не более 3 шт.)

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Количество датчиков теплового потока и преобразователей термоэлектрических может быть изменено по заявке потребителя в соответствии с количеством каналов измерения.


Один КИ-16 обеспечивает подключение 16 датчиков температуры или теплового потока.

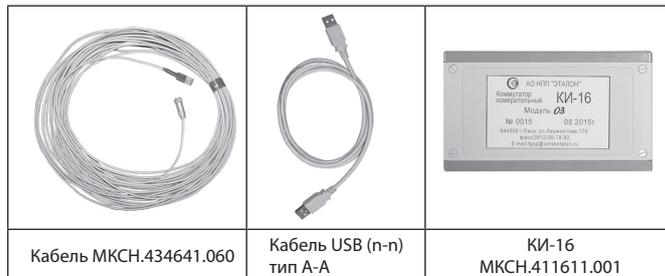

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ИТВ**



Основная форма программы

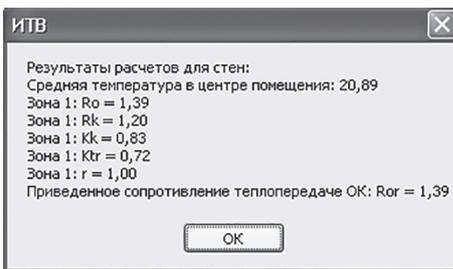

Результаты расчетов теплофизических параметров для стены

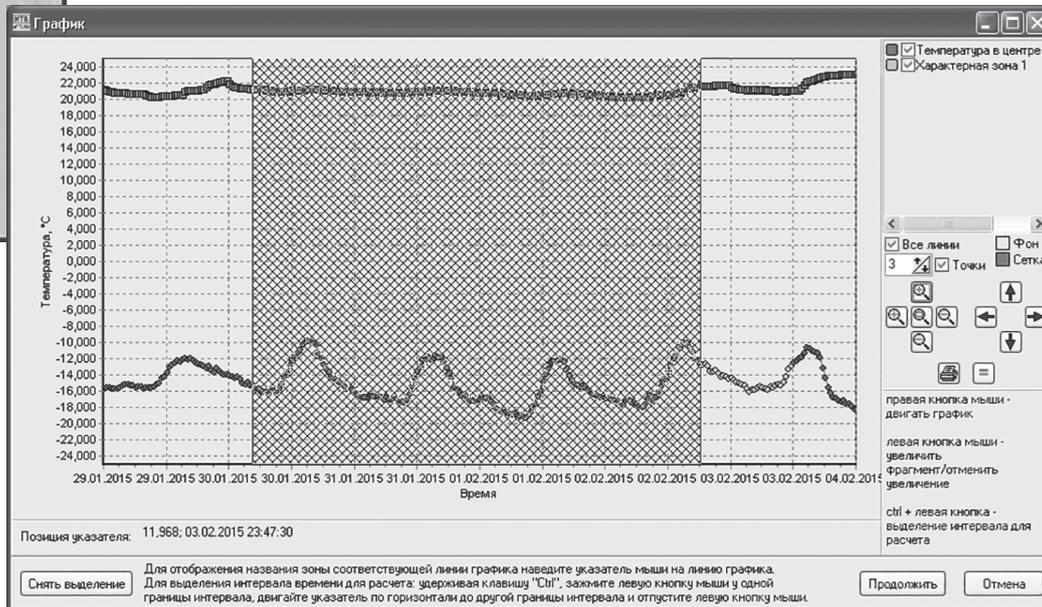


График изменения температуры наружного и внутреннего воздуха





Протокол № 002  
измерения сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции

Административное здание

(краткая характеристика объекта: место его расположения, адрес, обследуемое помещение)

Дата испытания: 28.01.2015

Характеристика испытываемой ОК:

Средняя температура внутреннего воздуха, °С: 20,89

Номер однородной зоны	Площадь i-й зоны $A_i$ , м <sup>2</sup>	Номер датчиков температуры	Номер датчиков теплового потока	Дата, время измерения	Средняя по площади температура				Плотность теплового потока, Вт/м <sup>2</sup>	Сопротивление теплопередаче i-й характерной зоны $R_{0i}$ , м <sup>2</sup> ·°С/Вт	Термическое сопротивление i-й характерной зоны $R_{ki}$ , м <sup>2</sup> ·°С/Вт	Коэффициент теплопроводности i-й характерной зоны $K_{ki}$ , Вт/м <sup>2</sup> ·°С	Коэффициент теплопередачи i-й характерной зоны $K_{tr,i}$ , Вт/м <sup>2</sup> ·°С	Коэффициент теплотехнической однородности зоны $\gamma$	Приведенное сопротивление теплопередаче ОК $R_{0r}$ , м <sup>2</sup> ·°С/Вт
					поверхности ОК		воздуха вблизи ОК								
					внутренняя, °С	наружная, °С	внутренняя, °С	наружная, °С							
1	2,53	109,110,111,204,205,206,112,113,114,201,202,203	115	29.01.2015 03:11:01	18,931	-13,664	21,549	-15,494	26,29						
				29.01.2015 03:41:01	18,918	-13,655	21,536	-15,345	25,97						
				29.01.2015 04:11:01	18,906	-13,655	21,504	-15,136	25,44						
				29.01.2015 04:41:01	18,863	-13,634	21,481	-15,180	25,05						
				29.01.2015 05:11:01	18,875	-13,593	21,455	-15,305	24,87						
				29.01.2015 05:41:01	18,840	-13,632	21,463	-15,347	25,67						

Протокол измерения сопротивления теплопередаче наружной стены. Первый лист.

Номер однородной зоны	Площадь i-й зоны $A_i$ , м <sup>2</sup>	Номер датчиков температуры	Номер датчиков теплового потока	Дата, время измерения	Средняя по площади температура				Плотность теплового потока, Вт/м <sup>2</sup>	Сопротивление теплопередаче i-й характерной зоны $R_{0i}$ , м <sup>2</sup> ·°С/Вт	Термическое сопротивление i-й характерной зоны $R_{ki}$ , м <sup>2</sup> ·°С/Вт	Коэффициент теплопроводности i-й характерной зоны $K_{ki}$ , Вт/м <sup>2</sup> ·°С	Коэффициент теплопередачи i-й характерной зоны $K_{tr,i}$ , Вт/м <sup>2</sup> ·°С	Коэффициент теплотехнической однородности зоны $\gamma$	Приведенное сопротивление теплопередаче ОК $R_{0r}$ , м <sup>2</sup> ·°С/Вт
					поверхности ОК		воздуха вблизи ОК								
					внутренняя, °С	наружная, °С	внутренняя, °С	наружная, °С							
				01.02.2015 09:11:31	18,751	-15,366	21,279	-19,098	24,39						
				01.02.2015 09:41:31	18,756	-15,173	21,230	-18,587	24,52						
				01.02.2015 10:11:31	18,723	-14,843	21,210	-18,213	24,83						
				01.02.2015 10:41:31	18,712	-14,708	21,218	-17,581	26,13						
				01.02.2015 11:11:31	18,701	-14,366	21,232	-16,604	25,09						
				01.02.2015 11:41:31	18,708	-13,990	21,290	-15,791	25,8						
				01.02.2015 12:11:31	18,722	-13,462	21,315	-14,791	26,12	1,3883	1,2019	0,8320	0,7203	1,0000	1,3883

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции  $R_{0пр} = 1,3883$  м<sup>2</sup>·°С/Вт

Измерение проводил

(подпись)

Павлов С.П.

(ф.и.о.)

27.05.2015 г.

Протокол измерения сопротивления теплопередаче наружной стены. Последний лист.



## ИЗМЕРИТЕЛИ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОвого ПОТОКА И ТЕМПЕРАТУРЫ ИТП-11

ТУ 4211-074-02566540-2006

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Измеритель плотности теплового потока и температуры ИТП-11 предназначен для измерения плотности теплового потока и температуры с возможностью сохранения измеренных значений во внутренней энергонезависимой памяти прибора и передачи их в ЭВМ. Для измерения плотности теплового потока к прибору подключаются преобразователи плотности теплового потока с коэффициентом преобразования от 10,0 до 99,9 Вт/м<sup>2</sup>мВ. Для измерения температуры к прибору подключаются преобразователи термоэлектрические (термопары) по ГОСТ Р 8.585-2001 любой конструкции.

ИТП-11



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИТП-11		
	Преобразователь плотности теплового потока	Термопара	
Тип датчика			ТХА(К)
Диапазон измерения плотности теплового потока, Вт/м <sup>2</sup>	0 ... 1000	-	
Диапазон измерения температуры, °С	-	-50 ... +1300	-50 ... +800
Абсолютная основная погрешность измерения плотности теплового потока, Вт/м <sup>2</sup> , не более	0,4 ... 4,0 *	-	
Абсолютная основная погрешность измерения температуры, °С, не более	-	± 1,5 **	
Подключение датчика:	розетка, совместимая со стандартным соединителем фирмы "Omega" (США)		
Вид индикации	ЖКИ, 10 символов		
Разрешающая способность индикации, °С	0,1		
Количество измерительных каналов	1		
Время измерения, с, не более	1		
Автоматическая регистрация измеренных значений температуры	есть		
Интервал автоматической регистрации, с	1,0; 2,0; 5,0; 15; 30; 60; 120		
Объем памяти, значений	12000		
Запуск процесса автоматической регистрации измеренных значений	ручной		
Остановка процесса автоматической регистрации измеренных значений	ручная или по заполнению памяти		
Подсветка индикатора	есть		
Связь с ЭВМ	RS-232		
Среда функционирования программного обеспечения	Windows'95, 98, 2000, XP		
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96	IP20		
Температура окружающего воздуха, °С	0 ... 50		
Питание	+9В, элемент питания типа "Крона"		
Ток потребления, мА, не более	3 (10***)		
Индикация разряда батареи	есть		
Габариты, мм, не более	129x75x30		
Масса, кг, не более	0,5		
* - в зависимости от значения коэффициента преобразования преобразователя плотности теплового потока ( $\Delta = 0,04 * C$ , где: $\Delta$ - абсолютная основная погрешность, Вт/м <sup>2</sup> ; C - коэффициент преобразования, Вт/м <sup>2</sup> мВ.);			
** - погрешность нормируется с учетом погрешности внутреннего компенсатора температуры холодных концов термопары;			
*** - при включенной подсветке.			

### ОСОБЕННОСТИ:

- наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей хранить данные после выключения питания прибора;
- запись в энергонезависимую память до 20 измеренных значений теплового потока или температуры и просмотр этих значений на индикаторе прибора;
- автоматическая непрерывная регистрация в энергонезависимую память до 12 000 измеренных значений плотности теплового потока или температуры с интервалами 1,0, 2,0, 5,0, 15, 30, 60, 120 секунд с возможностью передачи этих данных в ЭВМ;
- работа с преобразователями плотности теплового потока с коэффициентом преобразования от 10,0 до 99,9 Вт/м<sup>2</sup>мВ и двумя типами термопар. Переключение типа датчика осуществляется с клавиатуры прибора.

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Прибор имеет порт RS-232 для связи с компьютером. С прибором поставляется специальное сервисное программное обеспечение, выполняющее следующие функции:

- считывание данных из памяти прибора;
- обработка полученных данных: представление их в табличном и графическом видах;
- сохранение полученных данных в файл на ЭВМ с возможностью последующей загрузки этого файла в оболочку сервисного программного обеспечения.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- ИТП-11;
- набор вилки для подключения датчика;
- кабель для связи с компьютером;
- программное обеспечение;
- руководство по эксплуатации.

Батарея питания в комплект поставки не входит.

Датчики плотности теплового потока и температуры в комплект поставки не входят, выбираются в разделах ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (каталог продукции часть I) и ИЗМЕРИТЕЛИ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОвого ПОТОКА (каталог продукции часть II).

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

"Измеритель плотности теплового потока ИТП-11"



## РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	РТМ-3	РТ2М	РТ-10	РТ-5*	РТМ-4К
Тип датчика:					
- ТХА(К), ТХК(Л), ТПП(С), ТПР(В)	+	+	+	ТХА(К), ТХК(Л), ТНН(Н)	+
- ТЖК(У)	+	+	+		+
- ТСМ (50М, 100М; $W_{100} = 1,4280$ )	+	+	+		+
- ТСП (50П, 100П; $W_{100} = 1,3850$ , $W_{100} = 1,3910$ )	+	+	+		+
- ТСП (500П; $W_{100} = 1,3850$ , $W_{100} = 1,3910$ )	-	-	+		-
унифицир. сигнал (0-5) мА, (4-20) мА, (0-10) В	+	+	+		+
Число типов датчиков в одном исполнении прибора	1	1	1	набор датчиков	1
Диапазон измер. и регулир. температур, °С	Определяется типом датчика				
Вид индикации текущего значения температуры	3 разряда	4 разряда	2 индикатора по 3 разряда	3 разряда	3 разряда*
Разрешающая способность индикации температуры, °С	0,1; 1	0,1; 1	0,1; 1	0,1; 1	0,1; 1
Основная погрешность (в зависимости от типа датчика), не более:					
- при работе с ТП	$\pm 5, \pm 6^\circ\text{C}$	$\pm(4...8)^\circ\text{C}$	$\pm(4...8)^\circ\text{C}$		$\pm 5, \pm 6^\circ\text{C}$
- при работе с ТС	$\pm 2, \pm 3^\circ\text{C}$	$\pm 0,7, \pm 2,3^\circ\text{C}$	$\pm(1...2)^\circ\text{C}$		$\pm 2, \pm 3^\circ\text{C}$
- при работе с унифицированным сигналом, % от диапазона	$\pm 0,25$	$\pm 0,25$	$\pm 0,25$	$\pm 0,5\%$ от диапазона	$\pm 0,25$
Количество каналов измерения	1	1	1	1	4 (по 1 на каждый канал измерения)
Количество каналов регулирования	2	3	3	1	4 реле ~242 В, 3 А
Тип выходных коммутируемых элементов	2 реле ~242 В, 3 А	2 реле ~242 В, 5 А; 1 транзисторный ключ = 12 В, 15 мА	3 реле ~242 В, 6 А	1 реле ~242 В, 8 А	
Возможность подключения внешнего твердотельного реле	-	+	-	-	-
Законы регулирования:	2-х, 3-х позиционный	2-х, 3-х позиционный	2-х, 3-х позиционный	2-х позиционный	2-х позиционный
Дискретность задания уставок, °С	1	0,1; 1	1	1	1
Логика срабатывания выходных устройств	прямой гистерезис ("нагрев")	прямой гистерезис ("нагрев")	- прямой гистерезис ("нагрев"); - обратный гистерезис ("охлаждение");	- прямой гистерезис ("нагрев"); - обратный гистерезис ("охлаждение"); - П-образная; - U-образная выбирается с кнопок	прямой гистерезис ("нагрев")
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP54, IP20	IP20	IP20	IP54, IP20	IP54, IP20
Температура окружающего воздуха, °С	0...40				
Питание	~220 В; 50 Гц				
Индикация обрыва датчика	+	+	+	+	+
Наличие интерфейса RS-232	-	+	-	-	-
Наличие энергонезависимой памяти	+	+	+	+	+
Потребляемая мощность, Вт	5	7	7	7	7
Габаритные размеры, мм	96x96x102	48x96x145	96x96x225	105x145x45	96x96x185,5
Масса, кг	0,5	0,65	0,65	0,5	0,7

\* Обеспечивает регулирование температуры во времени по предварительному заданию. Имеет таймер с возможностью программирования времени до 166 часов. Также имеет перестраиваемый цифровой фильтр.



## РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ РТМ-3



ТУ 4211-002-02566540-2003

Тип средства измерения зарегистрирован  
в Федеральном информационном фонде  
по обеспечению единства измерений под № 51099-12

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Регуляторы температуры РТМ-3 предназначены для измерения, индикации и регулирования температуры различных объектов и могут применяться в промышленности, сельском хозяйстве, лабораторных исследованиях и т.п.

РТМ-3



Щитовое  
исполнение

Настенное  
исполнение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	РТМ-3
Тип датчика, в зависимости от исполнения	ТХА(К), ТХК(Л), ТПП(С), ТПР(В), ТЖК(Л), ТСМ (50М, 100М; $W_{100}=1,4280$ ), ТСП (50П, 100П; $W_{100}=1,3850$ , $W_{100}=1,3910$ ) унифицированный сигнал (0-5) мА, (4-20) мА, (0-10) В
Вид индикации	цифровая светодиодная, 3 разряда (высота цифр 10 мм)
Разрешающая способность индикации, °С:	
- для температур -80...0 °С	1
- для температур 0...99,9 °С	0,1
- для температур от 100°С и выше	1
Основная абсолютная погрешность, °С, не более:	
- для ТХК(Л)	±5
- для ТХА(К), ТПП(С), ТПР(В), ТЖК(Л)	±6
- для ТСМ	±2
- для ТСП	±3
Основная приведенная погрешность для унифицированных сигналов (0-5) мА, (4-20) мА, (0-10) В, % от диапазона, не более	0,25
Число каналов измерения	1
Число каналов регулирования	2
Закон регулирования	2-х, 3-х позиционный
Уставки	2 независимых набора
Дискретность задания уставок, °С	1
Логика работы выходных устройств	прямой гистерезис ("нагрев")
Погрешность срабатывания выходных устройств, °С, не более	1
Индикация замыкания контактов выходных устройств	2 красных светодиода
Сохранение в энергонезависимой памяти	уставки и поправки
Степень защиты, обеспечиваемую оболочкой. ГОСТ 14254-2015	IP54, IP20, в зависимости от исполнения
Материал корпуса	металл
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2
Температура окружающего воздуха, °С	0...40
Питание	~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	5
Габаритные размеры, мм, не более	
- для щитового исполнения	96x96x102
- для настенного исполнения	105x145x45
Размер окна для установки в щите, мм	91,5x91,5
Масса, кг, не более	0,5

### ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА:


2 независимые контактные группы реле ~ 242 В, 3 А

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ:

- тип регулирования - позиционный;
- режимы работы и значения уставок набираются с помощью трех кнопок, расположенных на лицевой панели;
- сигнализация обрыва датчика с отключением нагрузки;
- сигнализация выхода за границы диапазона измерения с отключением нагрузки;
- значения измеряемой температуры и установок (не одновременно) отображаются на 3-х разрядном знаковым индикаторе;
- повышенная помехоустойчивость.


Тип датчика	Диапазон измеряемых температур, °С
ТХА(К)	-80...+999
ТХК(Л)	-80...+800
ТПП(С)	0...999
ТПР(В)	300...999
ТЖК(Л)	-80...+999
ТСМ	-80...+200
ТСП	-80...+850
унифицированный сигнал	диапазон вводится пользователем

### СТРУКТУРА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТМ-3

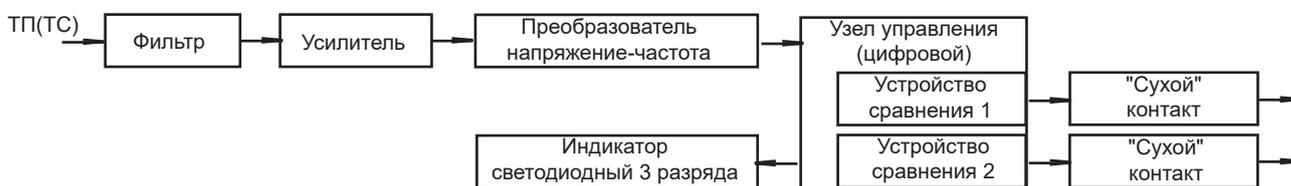





**Схема подключения РТМ-3, предназначенных для работы с термометрами сопротивления**

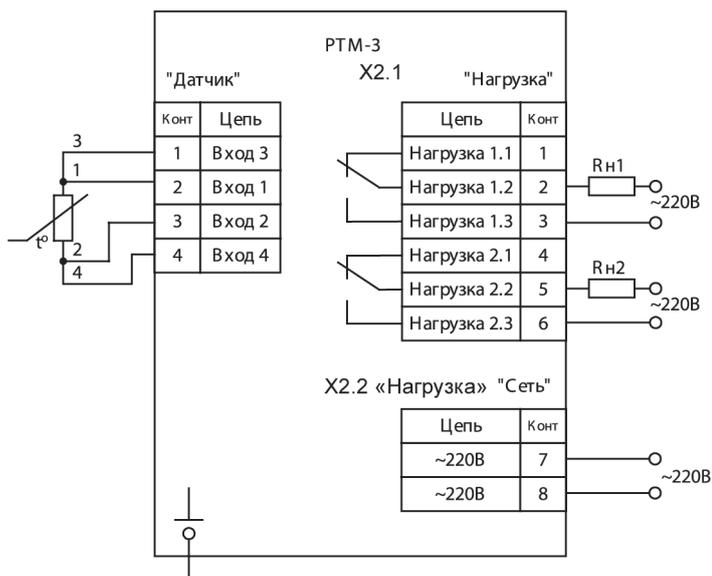


**Схема подключения РТМ-3, предназначенных для работы с термопарными датчиками**

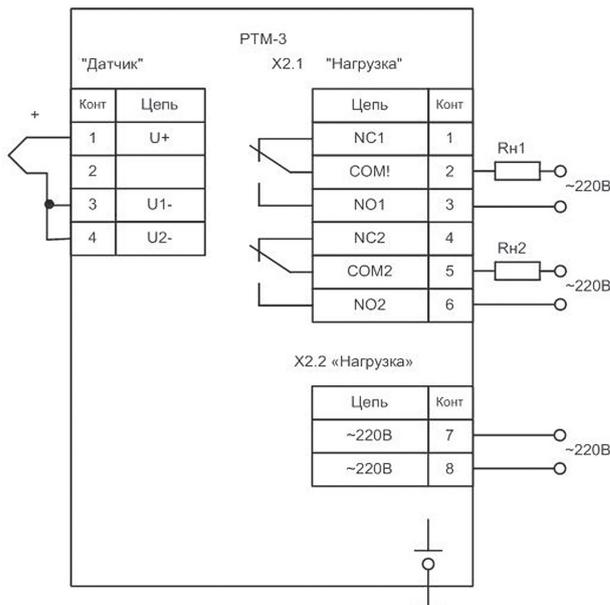

**Схема подключения РТМ-3 при использовании ПИ с выходным током**

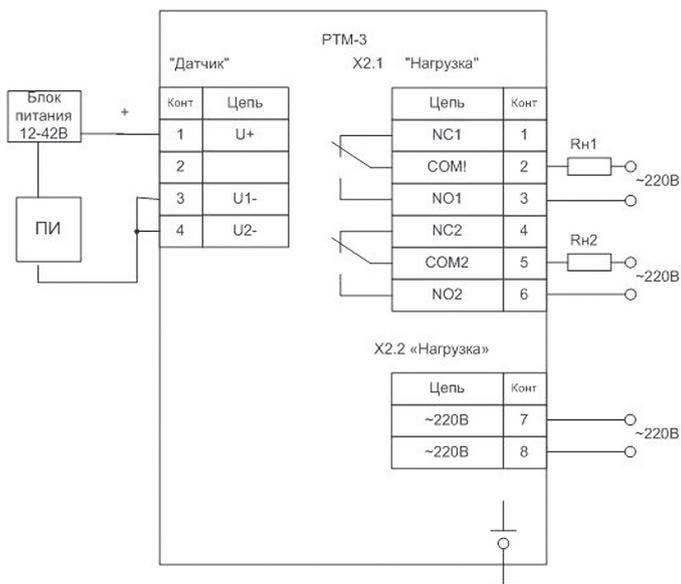

**Схема подключения РТМ-3 при использовании ПИ с выходным напряжением**

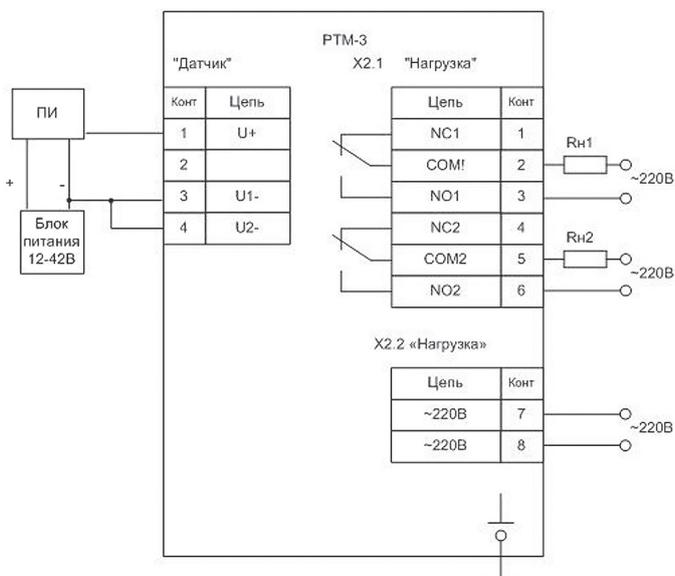

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«РТМ-3-Х-Х»

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды:

- 0 - IP20, щитовое исполнение;
- 1 - IP54, щитовое исполнение;
- 2 - IP54, настенное исполнение

Тип датчика:

- 1 - ТХА(К);
- 2 - ТХК(L);
- 3 - ТПП(S);
- 4 - ТПР(V);
- 5 - ТСМ 50М,  $W_{100}=1,4280$ ;
- 6 - ТСМ 100М,  $W_{100}=1,4280$ ;
- 7 - ТСП 50П,  $W_{100}=1,3910$ ;
- 8 - ТСП 50П,  $W_{100}=1,3850$ ;
- 9 - ТСП 100П,  $W_{100}=1,3910$ ;
- 10 - ТСП 100П,  $W_{100}=1,3850$ ;
- 11 - ТЖК(J);
- 12 - унифицированный (0-5) мА;
- 13 - унифицированный (4-20) мА;
- 14 - унифицированный (0-10) В.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- РТМ-3;
- комплект монтажных частей;
- руководство по эксплуатации.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

РТМ-3, предназначенный для работы с датчиком ТХА(К), степень защиты от проникновения твердых предметов и воды IP54

**«Регулятор температуры РТМ-3-1-1»**



## РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ PT2M



ДДШ 2.821.145 ТУ

Тип средства измерения зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 51099-12

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Микропроцессорные регуляторы температуры PT2M предназначены для измерения, индикации и регулирования температуры различных объектов и процессов.



PT2M



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PT2M
Тип датчика, в зависимости от исполнения	ТХА(К), ТХК(Л), ТПП(С), ТПР(В), ТЖК(У), ТСМ 50М, 100М $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100}=1,4280$ ); ТСП 50П, 100П $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100}=1,3850$ ); $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100}=1,3910$ ); унифицированный сигнал (0-5) мА, (4-20) мА, (0-10) В
Диапазон измеряемых температур, °С	по типу датчика
Вид индикации	цифровая светодиодная, 4 разряда (высота цифр 14 мм)
Разрешающая способность индикации, °С	
- для температур -80,0...+999,9°С	0,1
- для температур 1000 °С и выше	1
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С	см. таблицу 1
Основная приведенная погрешность для унифицированного сигнала, %	0,25
Количество каналов измерения	1
Количество каналов регулирования	3
Закон регулирования	2-х, 3-х позиционный
Уставки	3 независимых набора
Дискретность задания уставок равна разрешающей способности индикации	
Логика работы выходных устройств	прямой гистерезис ("нагрев")
Погрешность срабатывания выходных устройств	не более разрешающей способности индикации
Индикация замыкания контактов выходных устройств	3 красных светодиода
Сохранение в энергонезависимой памяти	текущие уставки и поправки
Связь с ЭВМ	RS-232
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96	IP20
Материал корпуса	пластмасса
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2
Диапазон рабочих температур, °С	0...40
Питание	~220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	7
Габаритные размеры, мм, не более	48x96x145
Размер окна для установки в щите, мм	45,5x93
Масса, кг, не более	0,65

### Выходные устройства:

- 2 независимые контактные группы реле - ~242 В, 5 А
- 1 транзисторный ключ - =12 В, 15 мА

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРА:

- позиционное регулирование от двух независимых реле и транзисторного ключа;
- малая погрешность при измерении и регулировании;
- сигнализация состояния выходных коммутирующих элементов;
- наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей сохранять данные регулирования после выключения питания прибора;
- линеаризация сигналов от термопар в соответствии с НСХ преобразования;
- сигнализация о выходе измеряемой температуры за границы диапазона;
- связь с компьютером по интерфейсу RS-232 и последующее отображение данных измерений в табличном или графическом виде на экране компьютера, распечатка на принтере;
- наличие системы автоматического определения неисправностей;
- возможность измерения постоянного тока или напряжения;
- управление нагревом объекта коммутацией силовой сети в случае применения внешних мощных твердотельных реле;
- компенсация температуры холодных концов термопар;
- сторожевой таймер;
- сигнализация обрыва цепей датчика.

### Структура регулятора температуры PT2M





Схема подключения РТ2М, предназначенных для работы с термопарными датчиками (кроме ТПР(В))

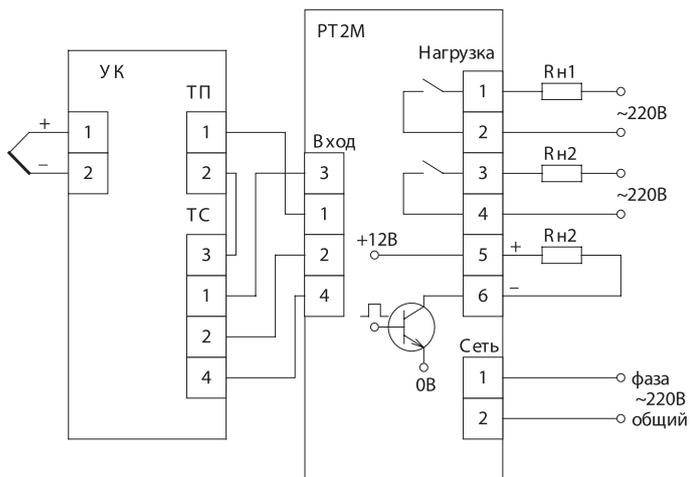


Схема подключения РТ2М, предназначенных для работы с датчиками ТПР(В)

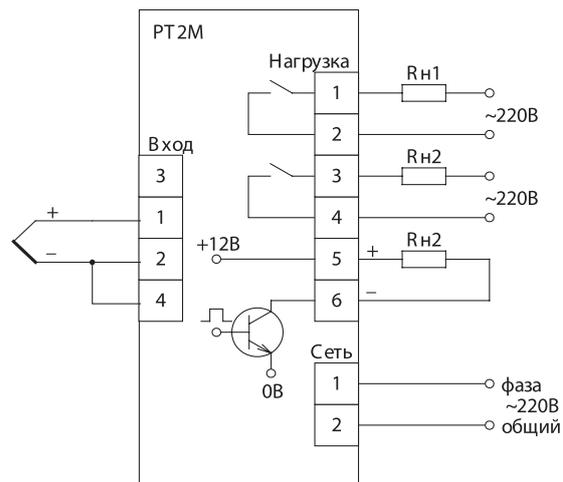


Схема подключения РТ2М, предназначенных для работы с термометрами сопротивления

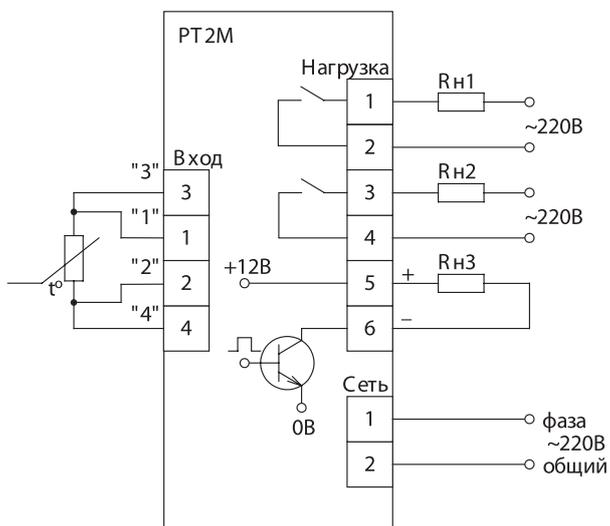


Схема подключения РТ2М, предназначенных для работы с датчиками, имеющими унифицированный токовый выходной сигнал

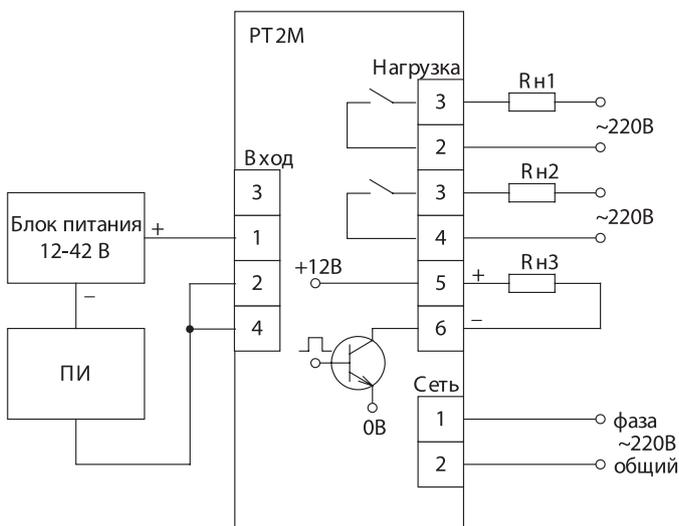


Схема подключения РТ2М, предназначенных для работы с датчиками, имеющими унифицированный выходной сигнал в виде напряжения

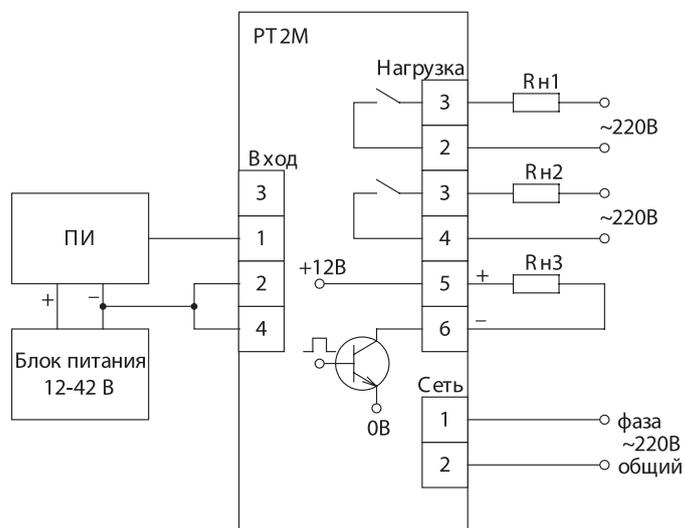




Таблица 1

Тип первичного преобразователя	Характеристика первичного преобразователя, НСХ	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С	Диапазон измеряемых температур, °С
ТХА	ХА(К)	5	от - 80 до +1300
ТХК	ХК (L)	4	от - 80 до +800
ТПП	ПП(S)	6	от 0 до 1600
ТПР	ПР(B)		от 300 до 1800
ТСМ	50М ( $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	2	от - 80 до +200
ТСМ	100М ( $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )		
ТСП	50П ( $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	3	от - 80 до +850
ТСП	Pt50 ( $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )		
ТСП	100П ( $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )		
ТСП	Pt100 ( $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )		
ТЖК	ЖК(J)	4	от -80 до +700
Унифицированный сигнал	ток (0-5) мА	основная приведенная погрешность 0,25 %	-80 ... +2000 ед.
Унифицированный сигнал	ток (4-20) мА		
Унифицированный сигнал	напряжение (0-10) В		

КОМПЛЕКТНОСТЬ:	Кол-во
регулятор температуры PT2M	- 1 шт.;
паспорт	- 1 экз.;
руководство по эксплуатации	- 1 экз.;
методика поверки	- 1 экз.;
устройство компенсации УК (для PT2M, работающего с термомпарами ТХА, ТХК, ТПП, ТЖК)	- 1 шт.;
комплект монтажных частей	- 1 комплект;
соединитель 2EDGK- 5,08-02P-1-4	- 1 шт.;
соединитель 2EDGK- 5,08-04P-1-4	- 1 шт.;
соединитель 2EDGK- 5,08-06P-1-4	- 1 шт.;
программное обеспечение (для PT2M с интерфейсом RS232)	- 1 комплект;
кабель интерфейсный ДДШ6.644.079 (для PT2M с интерфейсом RS232)	- 1 шт.

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«PT2M-X-X»

Наличие интерфейса RS232:

- 1 - есть
- 0 - нет

Тип датчика:

- 1 - ТХА(К)
- 2 - ТХК(L)
- 3 - ТПП(S)
- 4 - ТПР(B)
- 5 - ТСМ 50М,  $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,4280$ )
- 6 - ТСМ 100М,  $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,4280$ )
- 7 - ТСП 50П,  $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3910$ )
- 8 - ТСП 50П,  $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3850$ )
- 9 - ТСП 100П,  $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3910$ )
- 10 - ТСП 100П,  $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3850$ )
- 11 - ТЖК(J)
- 12 - унифицированный (0-5) мА
- 13 - унифицированный (4-20) мА
- 14 - унифицированный (0-10) В

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- твердотельные реле D2425 (~ 242 В, 17,5 А), D2450 (~ 242 В, 35 А), 5П19ТМ1-10-6 (~ 242 В, 10 А), 5П19ТМ1-60-6 (~ 242 В, 30 А) для коммутации с высокой скоростью мощных нагрузок при малых помехах (могут подключаться к выходному транзисторному ключу).

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Регулятор температуры PT2M-1-1»  
Регулятор температуры PT2M, предназначенный для работы с датчиками ТХА(К) и с интерфейсом RS-232.

**РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ PT-10**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PT-10
Тип датчика, в зависимости от исполнения	ТХА(К), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J), ТСМ 50М, 100М - $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100} = 1,4280$ ); ТСП 50П, 100П - $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100} = 1,3850$ ), $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100} = 1,3910$ )
Диапазон измеряемых температур, °С	по типу датчика
Вид индикации	цифровая светодиодная, 2 индикатора по 3 разряда (высота цифр 14 мм)
Разрешающая способность индикации, °С	1
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С	см. таблицу 1
Количество каналов измерения	1
Количество каналов регулирования	3
Закон регулирования	2-х, 3-х позиционный
Уставки	3 независимых набора
Дискретность задания уставок равна разрешающей способности индикации	
Логика работы выходных устройств	прямой гистерезис ("нагрев")
Погрешность срабатывания выходных устройств	не более разрешающей способности индикации
Индикация замыкания контактов выходных устройств	3 красных светодиода
Сохранение в энергонезависимой памяти	текущие уставки и поправки
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой. ГОСТ 14254-2015.	IP20

PT-10



**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Микропроцессорные регуляторы температуры PT-10 предназначены для измерения, индикации и регулирования температуры различных объектов.

**Выходные устройства:**

3 независимые контактные группы реле - ~242 В, 5 А





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	РТ-10
Материал корпуса	пластмасса
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2
Диапазон рабочих температур, °С	0...40
Питание	~220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	7
Габаритные размеры, мм, не более	48x96x145
Размер окна для установки в щите, мм	45,5x93
Масса, кг, не более	0,65

**ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРА:**

- позиционное регулирование от трех независимых реле;
- сигнализация состояния выходных коммутирующих элементов;
- наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей сохранять данные регулирования после выключения питания прибора;
- линеаризация сигналов от термопар в соответствии с НСХ преобразования;
- сигнализация о выходе измеряемой температуры за границы диапазона;
- компенсация температуры холодных концов термопар;
- сторожевой таймер;
- сигнализация обрыва цепей датчика.


Таблица 1

Тип первичного преобразователя	Характеристика первичного преобразователя, НСХ	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С	Диапазон измеряемых температур, °С
ТХА	ХА(К)	5	от - 80 до +999
ТХК	ХК (L)	4	от - 80 до +800
ТПП	ПП(S)	6	от 0 до 999
ТПР	ПР(В)		от 300 до 999
ТСМ	50М ( $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	2	от - 80 до +200
ТСМ	100М ( $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )		
ТСП	50П ( $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	3	от - 80 до +850
ТСП	Pt50 ( $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )		
ТСП	100П ( $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )		
ТСП	Pt100 ( $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )		
ТЖК	ЖК(J)	4	от -80 до +700


**Структура регулятора температуры РТ-10**



**Схема подключения РТ-10, предназначенных для работы с термопарными датчиками (кроме ТПР(В))**

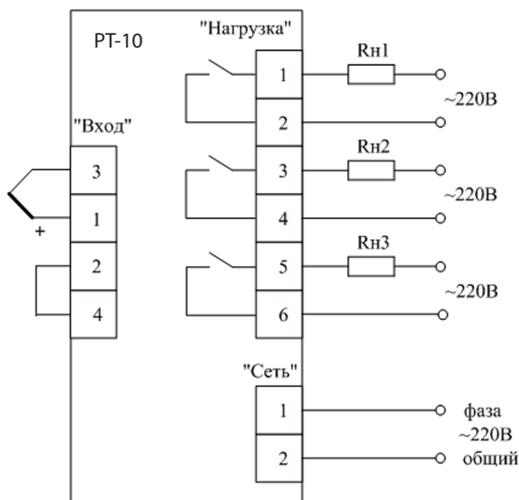

**Схема подключения РТ-10, предназначенных для работы с термометрами сопротивления**

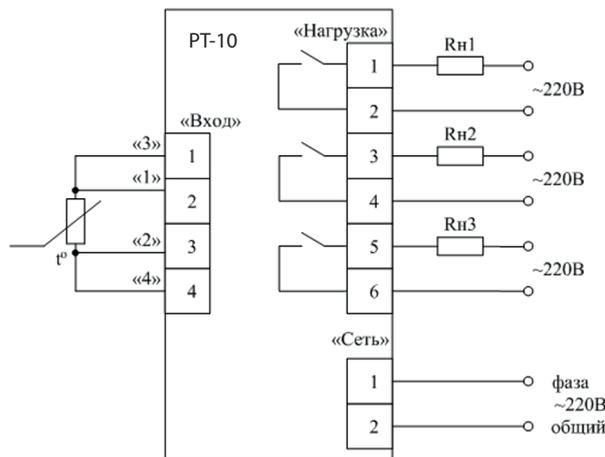

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«РТ-10-Х»

Тип датчика:

- 1 - ТХА(К)
- 2 - ТХК(L)
- 3 - ТПП(S)
- 4 - ТПР(В)
- 5 - ТСМ 50М,  $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100}=1,4280$ )
- 6 - ТСМ 100М,  $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100}=1,4280$ )
- 7 - ТСП 50П,  $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100}=1,3910$ )
- 8 - ТСП 50П,  $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100}=1,3850$ )
- 9 - ТСП 100П,  $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100}=1,3910$ )
- 10 - ТСП 100П,  $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100}=1,3850$ )
- 11 - ТЖК(J)

КОМПЛЕКТНОСТЬ:	Кол-во
регулятор температуры РТ-10	1 шт.;
руководство по эксплуатации	1 экз.;
комплект монтажных частей	1 комплект;
соединитель 2EDGK- 5,08-02P-1-4	1 шт.;
соединитель 2EDGK- 5,08-04P-1-4	1 шт.;
соединитель 2EDGK- 5,08-06P-1-4	1 шт.;

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Регулятор температуры РТ-10-1»

Регулятор температуры РТ-10-1, предназначенный для работы с датчиками ТХА(К).



**РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-5**

ТУ 4211-060-02566540-2006

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Микропроцессорный регулятор температуры РТ-5 щитового или настенного исполнения предназначен для измерения и регулирования температуры с функцией таймера, а также физических величин, первичные преобразователи которых имеют унифицированный выходной сигнал.

Применение: Наиболее целесообразным является применение регулятора РТ-5 для управления температурой технологического процесса где возникает необходимость выдержки во времени как в ручном так и автоматическом режиме. Возможность использования при производстве мясных и колбасных изделий, в хлебопекарной промышленности, в инкубаторах, термокамерах, варочных и сушильных шкафах, при сушке древесины, изготовлении железобетонных конструкций и пр.



РТ-5-0  
Щитовое  
исполнение

РТ-5-1  
Настенное  
исполнение



Таблица 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	РТ-5
Тип датчика, устанавливается оператором.	см. таблицу 1
Диапазон измеряемых температур	по типу датчика
Вид индикации	цифровая светодиодная, 3 разряда (высота цифр 10 мм),
Разрешающая способность индикации, °С	см. таблицу 1
Предел допускаемой основной приведенной погрешности от диапазона измерения, %	0,5
Число каналов измерения	1
Число каналов сигнализации, регулирования	2
Закон регулирования	2-х позиционный
Уставки	2 независимых набора
Дискретность задания уставок, °С	0,1
Логика работы выходных устройств	выбирается оператором
Погрешность срабатывания выходных устройств, °С, не более	0,1
Индикация замыкания контактов выходных устройств	2 красных светодиода
Параметры цифрового таймера	
- управляемое выходное устройство	реле 2
- приведенная погрешность, %, не более	0,1
- длительность по времени, мин	1...999
- режимы работы	ручной, автоматический
Сохранение в энергонезависимой памяти	текущие настройки
Степень защиты, обеспечиваемую оболочкой. ГОСТ 14254-2015	
- для щитового исполнения	IP20
- для настенного исполнения	IP54
Температура окружающего воздуха, °С	1...50
Питание	~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	7
Габаритные размеры, мм, не более	
- для щитового исполнения	48x96x90
- для настенного исполнения	105x145x45
Масса, кг, не более:	0,5

Условный номер и код датчика	Тип датчика	Диапазон работы датчика, °С	Разрешающая способность, °С
1 (E_H)	ТХА(К)	-50...+999	1
2 (E_L)	ТХК(L)	-50...+750	1
5 (r8)	ТСМ 50М α= 0,00428 °С <sup>-1</sup> (W <sub>100</sub> =1,428)	-50...+200	1
6 (r_8)	ТСМ 100М α= 0,00428 °С <sup>-1</sup> (W <sub>100</sub> =1,428)	-50...+200	1
7 (r1)	ТСП 50П α= 0,00391 °С <sup>-1</sup> (W <sub>100</sub> =1,391)	-99...+650	1
8 (r5)	ТСП 50П α= 0,00385 °С <sup>-1</sup> (W <sub>100</sub> =1,385)	-99...+650	1
9 (r_1)	ТСП 100П α= 0,00391 °С <sup>-1</sup> (W <sub>100</sub> =1,391)	-99...+650	1
10 (r_5)	ТСП 100П α= 0,00385 °С <sup>-1</sup> (W <sub>100</sub> =1,385; Pt 100)	-99...+650	1
11 (E_J)	ТЖК(J)	-50...+900	1
12 (i05)	Ток 0...5 мА	0...100%	0,1%
13 (i42)	Ток 4...20 мА	0...100%	0,1%
16 (U01)	Напряжение 0...100 мВ	0...100%	0,1%
18 (U05)	Напряжение 0...50 мВ	0...100%	0,1%
19 (r23)	ТСМ гр.23 (R=53 Ом, W100 =1,426)	-99...+200	1
20 (r_6)	ТСМ 100М W100 =1,426	-50...+200	1
21 (r6)	ТСМ 50М W100 =1,426	-50...+200	1
22 (i20)	Ток 0...20 мА	0...100%	0,1%
23 (E_n)	ТНН(N)	-50...+999	1


**ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРА**

- позиционное регулирование от электромагнитного реле с индикацией;
- компенсация температуры холодных концов ТП;
- автоматический или ручной отсчет времени регулирования;
- отображение результата измерения температуры или времени на трехразрядном знаковом индикаторе;
- установка параметров с контролем по знаковому индикатору;
- сохранение параметров регулятора в энергонезависимой памяти при отключении питания.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

регулятор температуры РТ-5; руководство по эксплуатации; комплект монтажных частей.

**Функциональная схема регулятора**

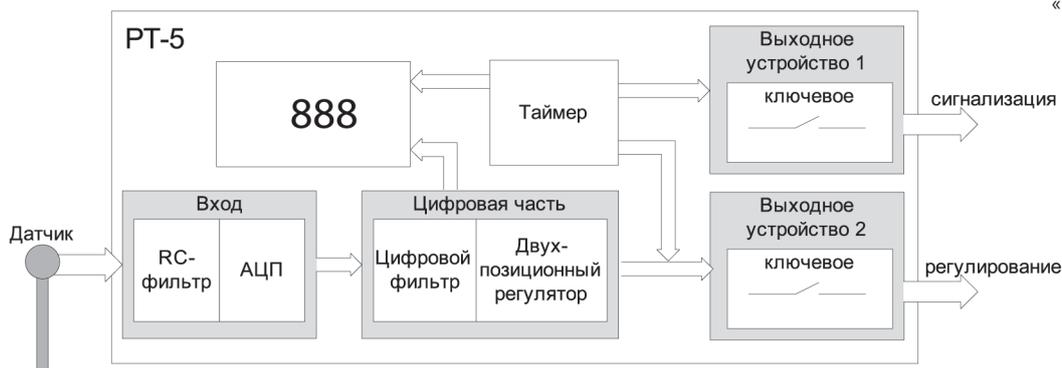

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«РТ-5-Х»  
Тип корпуса:  
0 - щитовой;  
1 - настенный.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Регулятор температуры РТ-5-1»



**РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ 4-Х КАНАЛЬНЫЕ РТМ-4К**



ТУ 4211-085-02566540-2007

Тип средства измерения зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 51099-12

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

4-х канальные регуляторы температуры РТМ-4К предназначены для измерения, индикации и регулирования температуры различных объектов и могут применяться в промышленности, сельском хозяйстве, лабораторных исследованиях и т.п.

РТМ-4К



**Структура регулятора температуры РТМ-4К**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	РТМ-4К
Тип датчика, в зависимости от исполнения	ТХА(К), ТХК(Л), ТПП(С), ТПР(В), ТЖК(У), ТСП 50П, 100П $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100}=1,4280$ ), $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100}=1,3850$ ), $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ( $W_{100}=1,3910$ ), унифицированный сигнал (0-5) мА, (4-20) мА, (0-10) В
Вид индикации	цифровая светодиодная, 3 разряда (высота цифр 10 мм)
Разрешающая способность индикации, $^\circ\text{C}$ :	
- для температур $-80 \dots 0 \text{ } ^\circ\text{C}$ и $100 \text{ } ^\circ\text{C}$ и выше	1
- для температур $0 \dots 99,9 \text{ } ^\circ\text{C}$	0,1
Основная абсолютная погрешность, $^\circ\text{C}$ , не более:	
- для ТХК(Л)	$\pm 5$
- для ТХА(К), ТПП(С), ТПР(В), ТЖК(У)	$\pm 6$
- для ТСП	$\pm 2$
- для ТСП	$\pm 3$
Основная приведенная погрешность для датчиков (0-5) мА, (4-20) мА, (0-10) В, % от диапазона, не более	0,25
Число каналов измерения	4
Число каналов регулирования	4
Закон регулирования	2-х позиционный
Уставки	4 независимых набора
Дискретность задания уставок, $^\circ\text{C}$	1
Логика работы выходных устройств	прямой гистерезис ("нагрев")
Погрешность срабатывания выходных устройств, $^\circ\text{C}$ , не более:	1
Индикация замыкания контактов выходных устройств	4 светодиода
Сохранение в энергонезависимой памяти	уставки и поправки
Степень защиты, обеспечиваемую оболочкой. ГОСТ 14254-2015	IP54, IP20, в зависимости от исполнения
Материал корпуса	металл
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2
Температура окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$	$0 \dots 40$
Питание	$\sim 220 \text{ В}; 50 \text{ Гц}$
Потребляемая мощность, Вт, не более	7
Габаритные размеры, мм, не более	$96 \times 96 \times 185,5$
Размер окна для установки в щите, мм	$91,5 \times 91,5$
Масса, кг, не более	0,7

**ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА:**

4 независимые контактные группы реле  $\sim 242 \text{ В}, 3 \text{ А}$


**ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ:**

- тип регулирования позиционный;
- режимы работы и значения уставок набираются с помощью трех кнопок, расположенных на лицевой панели;
- сигнализация обрыва датчика;
- значения измеряемой температуры и уставок (не одновременно) отображаются на 3-х разрядном знаковом индикаторе;
- повышенная помехоустойчивость;
- дополнительный индикатор для индикации номера канала.

Тип датчика	Диапазон измеряемых температур, $^\circ\text{C}$
ТХА(К)	$-80 \dots +999$
ТХК(Л)	$-80 \dots +800$
ТПП(С)	$0 \dots 999$
ТПР(В)	$300 \dots 999$
ТЖК(У)	$-80 \dots +999$
ТСП	$-80 \dots +200$
ТСП	$-80 \dots +850$
унифицированный сигнал	диапазон вводится пользователем




**Схема подключения РТМ-4К, предназначенных для работы с терморезистивными датчиками**


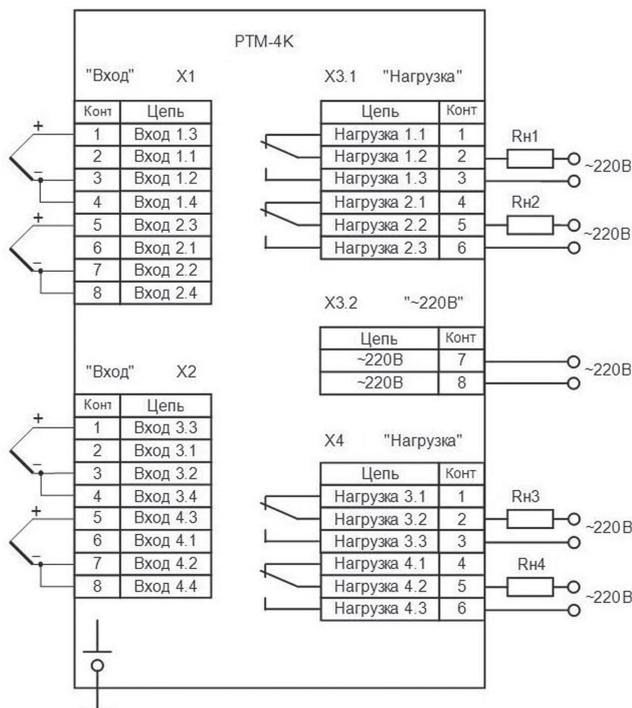


**Схема соединений регулятора при использовании ПИ с выходным током**

**Схема подключения РТМ-4К, предназначенных для работы с термометрами сопротивления**

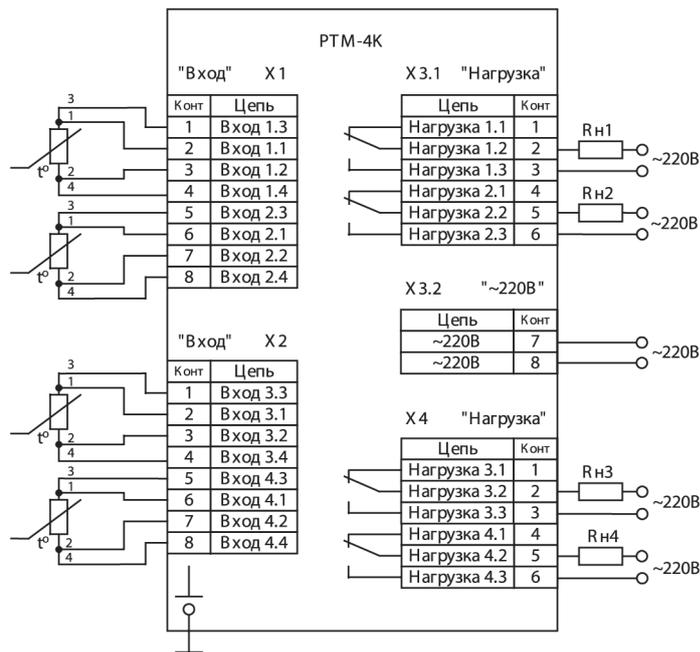

**Схема соединений регулятора при использовании ПИ с выходным напряжением**

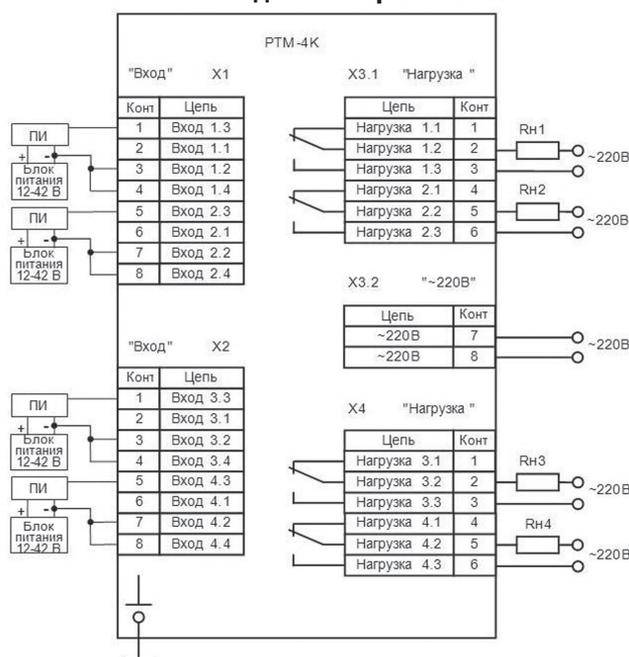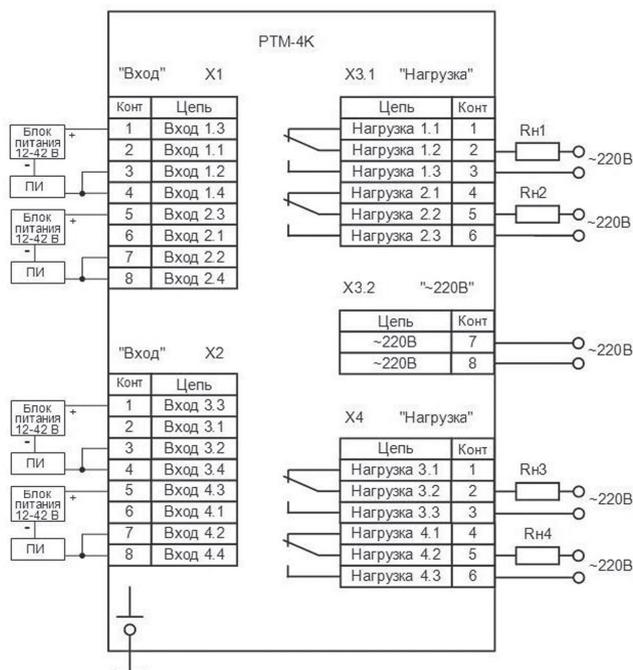

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«РТМ-4К-Х-Х»

- Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды:  
0 - IP20; 1 - IP54.
- Тип датчика:  
1 - ТХА(К); 2 - ТХК(L);  
3 - ТПП(S); 4 - ТПР(B);  
5 - ТСМ 50М,  $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,4280$ );  
6 - ТСМ 100М,  $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,4280$ );  
7 - ТСП 50П,  $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3910$ );  
8 - ТСП 50П,  $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3850$ );  
9 - ТСП 100П,  $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3910$ );  
10 - ТСП 100П,  $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  ( $W_{100} = 1,3850$ );  
11 - ТЖК(J);  
12 - унифицированный (0-5) мА;  
13 - унифицированный (4-20) мА;  
14 - унифицированный (0-10) В.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- регулятор температуры РТМ-4К;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки;
- комплект монтажных частей.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

**«Регулятор температуры РТМ-4К-3-0»**

РТМ-4К, предназначенный для работы с датчиками ТПП(S), степень защиты от проникновения твердых предметов и воды IP20



## БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ БУ-7

МКСН.405544.005 РЭ

БУ-7

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Блок управления БУ-7 предназначен для измерения и поддержания температуры в рабочем пространстве (объеме) средств поверки преобразователей температуры (печей, термостатов и др.), управляя подводимой электрической мощностью.

БУ-7 предназначен для использования в составе изделий, производства АО "НПП "Эталон".

Блоки управления выпускается в различных исполнениях отличающихся друг от друга количеством каналов регулирования и типом преобразователя температуры (входной сигнал).

### ФУНКЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ БУ-7:

- трех или одно зонное измерение и регулирование по ПИД закону (управление нагревателем) температуры в рабочем пространстве;
- измерение и регулирование по ПИД закону (управление нагревателем) температуры в рабочем объеме термостатов и печей;
- управление двигателем для перемешивания жидкости в термостате;
- отображение результатов измерения на шестиразрядном знаковом индикаторе в °С;
- установка требуемой температуры с контролем по знаковому индикатору;
- контроль и отображение неисправностей (обрыв преобразователей температуры, обрыв датчика компенсатора, неисправность узла контроля питания);
- звуковая сигнализация аварийных ситуаций;
- связь с персональным компьютером по интерфейсу RS-232;
- значения уставок сохраняются при выключении БУ-7.



Внешний вид БУ-7  
в 3-х канальном и 1 канальном исполнениях

Таблица 1

Диапазоны задания уставок регулирования приведены в таблице 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Блок управления БУ-7											
	-0	-2	-4	-3	-6	-1	-5	-8	-9	-10	-7	-11
Диапазон регулируемых температур, °С	100...1200			300...1600			40...800			25...200		600...1780
Характеристика преобразователя НСХ, W100	ПП (S)			ПР (B)			100П, W100=1,391			ТХА (К)*, 100П		ПР (B)
Диапазон задания уставок регулирования, °С	20...1250			20...1650			0...850			0...250		20...1800
Минимальная дискретность задания значений уставок, °С	0,01											
Напряжение управления нагрузкой	220	5	220	5	220			80	220	5		
Максимальный ток нагрузки на один канал, А, не более	15	0,01	40	0,01	12	10	20	22	1,5	11	0,01	
Максимальный ток нагрузки на изделие, А, не более	40	-	-	-	-	20	-	-	-	22	-	
* дифференциальная термопара												

Таблица 2. Эксплуатационные характеристики БУ-7

Наименование	Значение
Средняя наработка до отказа, ч	25 000
Питание	(220±22) В, частотой (50±1) Гц
Мощность, потребляемая блоком, Вт	22
Габариты, мм, не более	270x100x360
Масса, кг, не более	5

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- температура окружающей среды (20 ± 5)°С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80%;
- атмосферное давление (84 - 106,7) кПа;
- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, токопроводящей пыли.

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Блок управления БУ-7-0»

«Блок управления БУ-7-4 для МТП-2МР-50-500»

Применяемость в изделиях производства АО «НПП «Эталон» приведена в таблице 3.

Таблица 3. Применяемость в изделиях



Тип	Применяемость	Примечание
БУ-7-0	Базовая модель	3 канала
БУ-7-1	-	3 канала
БУ-7-2	МТП 1200-4, МТП 1200-5, ПРТ 600-1100	3 канала
БУ-7-3	-	3 канала
БУ-7-4	МТП-2МР-50-500, ПШ 1200, МТП-2МР-70-1000, ОП 700-1, АЧТ 45/100/1100	1 канал
БУ-7-5	ТР-1М-300(500), ТР-1М-В, ТР-1М-У1 (У2), ТР-20, АЧТ 165/40/100	1 канал
БУ-7-6	ВТП 1600-1	1 канал
БУ-7-7	УТМ-1	2 канала
БУ-7-8	ПЧТ 540/40/100	1 канал
БУ-7-9	КР-190	1 канал
БУ-7-10	ТС 600-2	2 канала
БУ-7-11	ВТП 1800-1	1 канал

По отдельной заявке возможно изменение технических характеристик, после дополнительного согласования с разработчиками.

Тел. (3812) 36-99-67




**БУ-7-0**

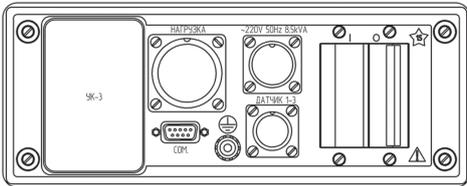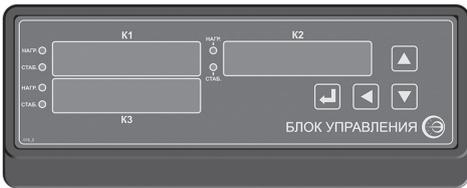


**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- блок управления БУ-7-0 1 шт.
  - руководство по эксплуатации 1 шт.
  - диск с программным обеспечением 1 шт.
  - кабель питания ХТ1\* ДДШ6.644.004 1 шт.
  - кабель силовой ХТ2\* ДДШ6.644.080 1 шт.
  - кабель измерительный ХТ3\* ДДШ6.644.081 1 шт.
  - кабель интерфейсный ХТ4\* ДДШ 6.644.033 1 шт.
- \* поставляется по отдельной заявке потребителя

**Схема подключения БУ-7-0**

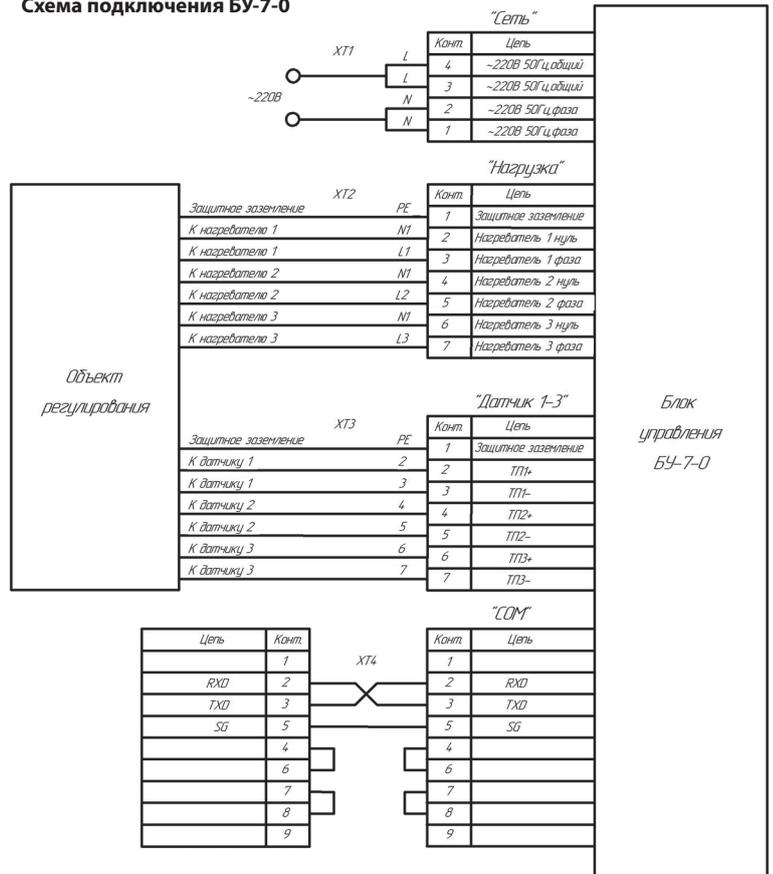


**БУ-7-1**

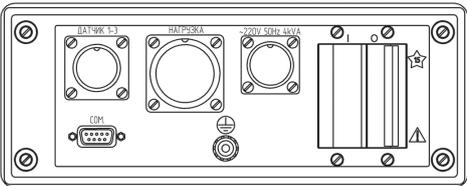

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- блок управления БУ-7-1 1 шт.
  - руководство по эксплуатации 1 шт.
  - диск с программным обеспечением 1 шт.
  - кабель питания ХТ1\* ДДШ6.644.004 1 шт.
  - кабель силовой ХТ2\* ДДШ6.644.080 1 шт.
  - кабель измерительный ХТ3\* ДДШ6.644.081 1 шт.
  - кабель интерфейсный ХТ4\* ДДШ 6.644.033 1 шт.
- \* поставляется по отдельной заявке потребителя



**Схема подключения БУ-7-1**

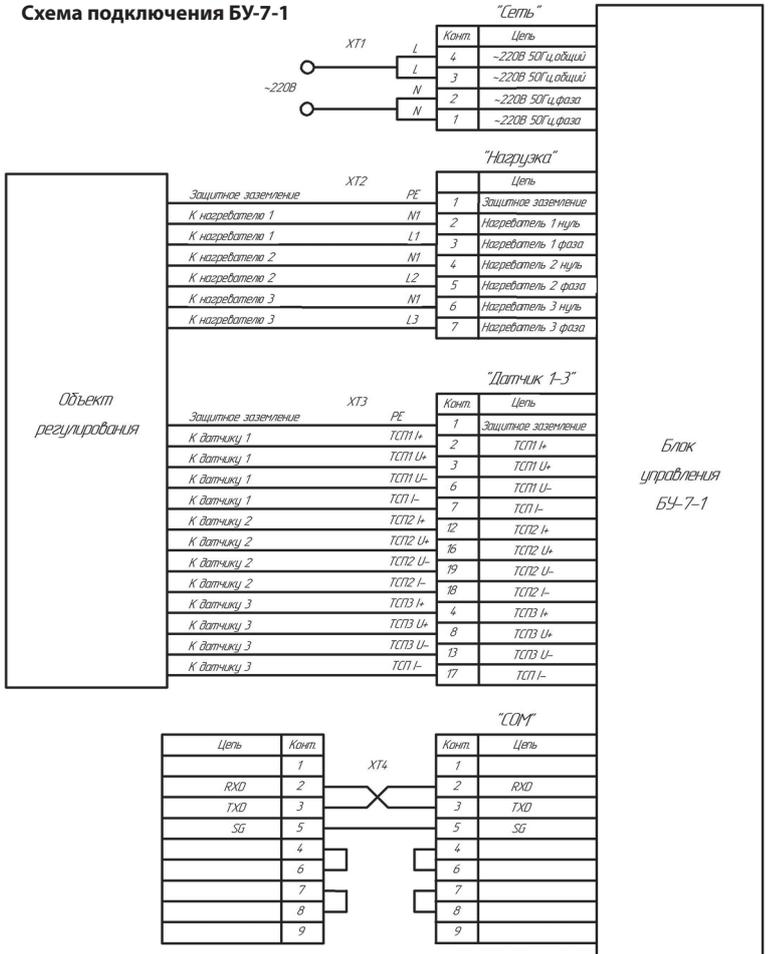



### БУ-7-2

Схема подключения БУ-7-2

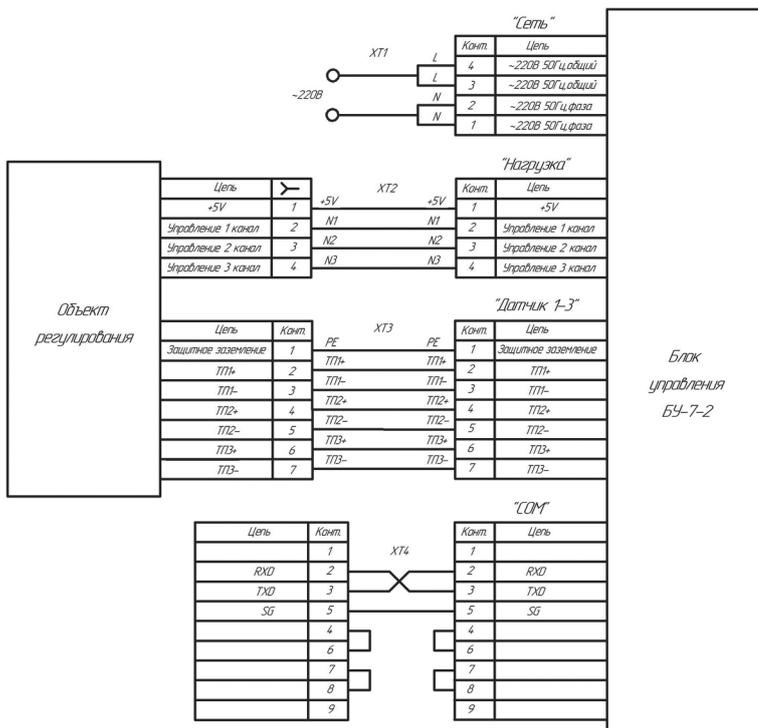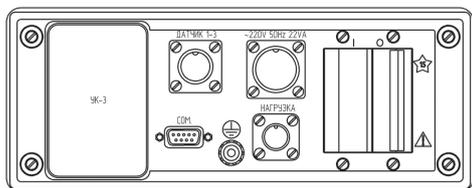



**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- блок управления БУ-7-2 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- диск с программным обеспечением 1 шт.
- кабель питания ХТ1\* ДДШ6.644.004 1 шт.
- кабель управления ХТ2\* ДДШ 6.644.022 1 шт.
- кабель измерительный ХТ3\* МКСН.685631.011 1 шт.
- кабель интерфейсный ХТ4\* ДДШ 6.644.033 1 шт.

\* поставляется по отдельной заявке потребителя

### БУ-7-3

Схема подключения БУ-7-3

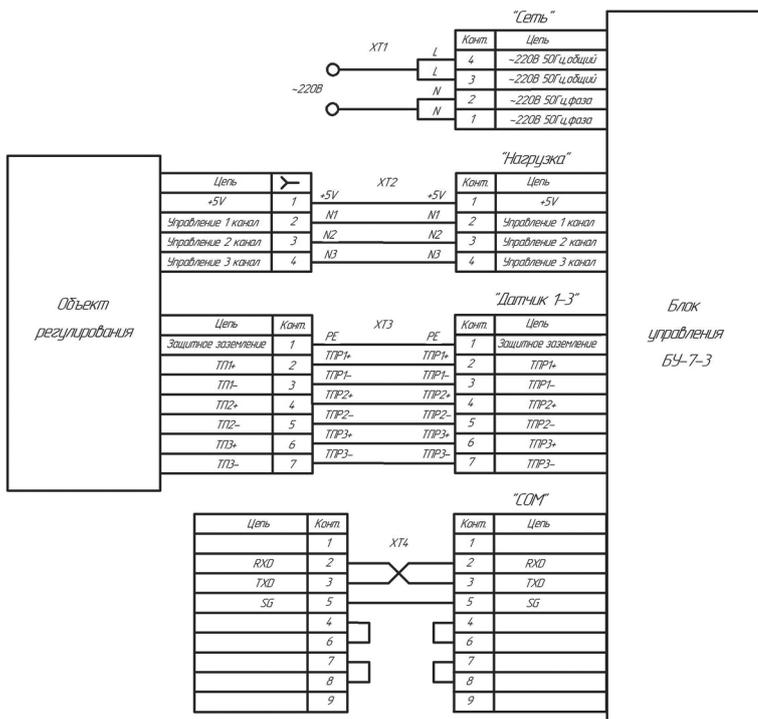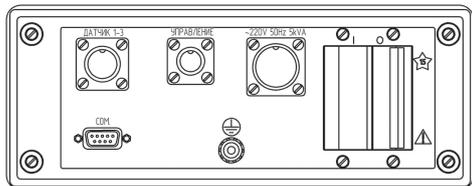

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- блок управления БУ-7-3 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- диск с программным обеспечением 1 шт.
- кабель питания ХТ1\* ДДШ6.644.004 1 шт.
- кабель управления ХТ2\* ДДШ 6.644.022 1 шт.
- кабель измерительный ХТ3\* МКСН.685631.031 1 шт.
- кабель интерфейсный ХТ4\* ДДШ 6.644.033 1 шт.

\* поставляется по отдельной заявке потребителя



**БУ-7-4**


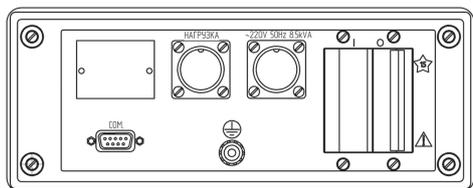


Схема подключения БУ-7-4

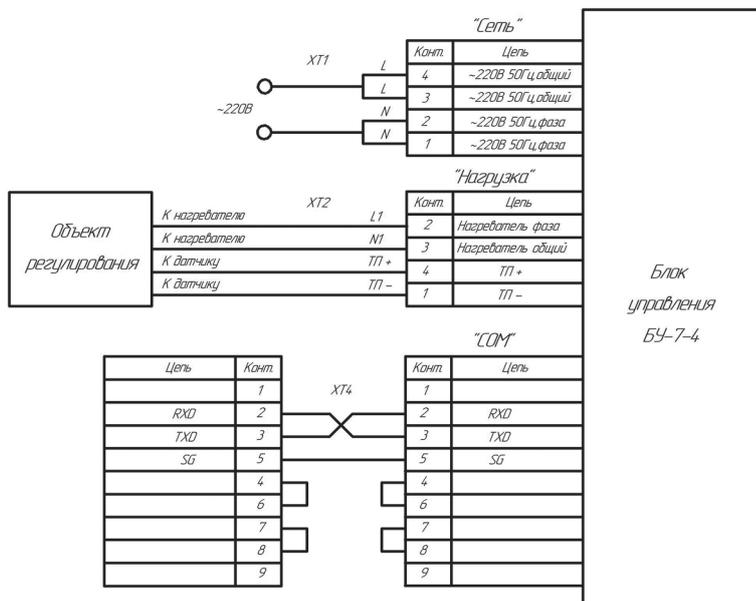

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- блок управления БУ-7-4 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- диск с программным обеспечением 1 шт.
- кабель питания ХТ1\* ДДШ 6.644.004 1 шт.
- кабель силовой ХТ2\* ДДШ 6.644.020 1 шт.
- кабель интерфейсный ХТ4\* ДДШ 6.644.033 1 шт.

\* поставляется по отдельной заявке потребителя

**БУ-7-5**


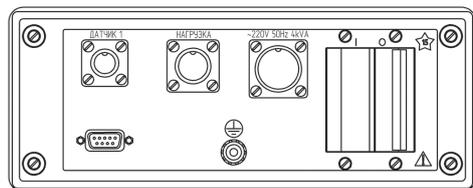


Схема подключения БУ-7-5

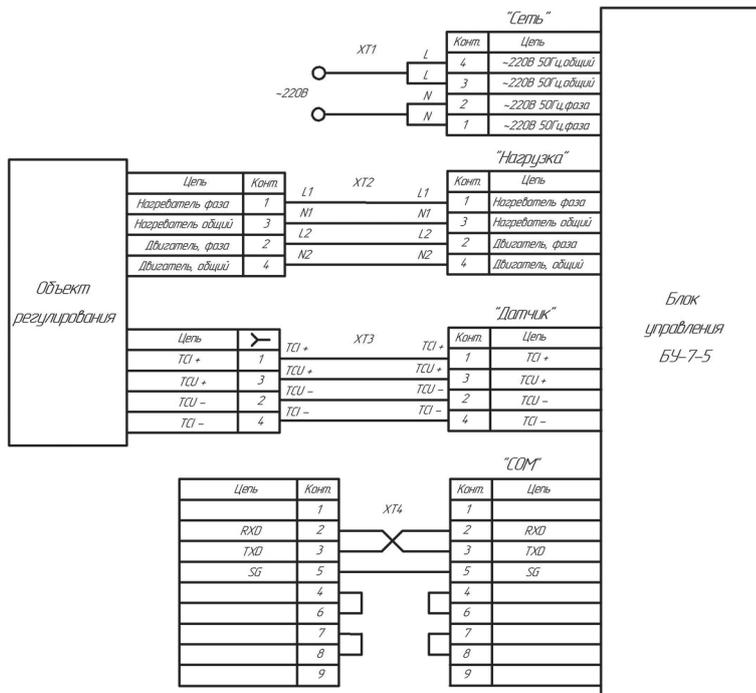

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- блок управления БУ-7-5 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- диск с программным обеспечением 1 шт.
- кабель питания ХТ1\* ДДШ 6.644.004 1 шт.
- кабель силовой ХТ2\* ДДШ 6.644.023 1 шт.
- кабель измерительный ХТ3\* ДДШ 6.644.022 1 шт.
- кабель интерфейсный ХТ4\* ДДШ 6.644.033 1 шт.

\* поставляется по отдельной заявке потребителя





### БУ-7-6


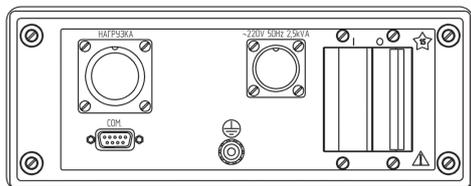


Схема подключения БУ-7-6

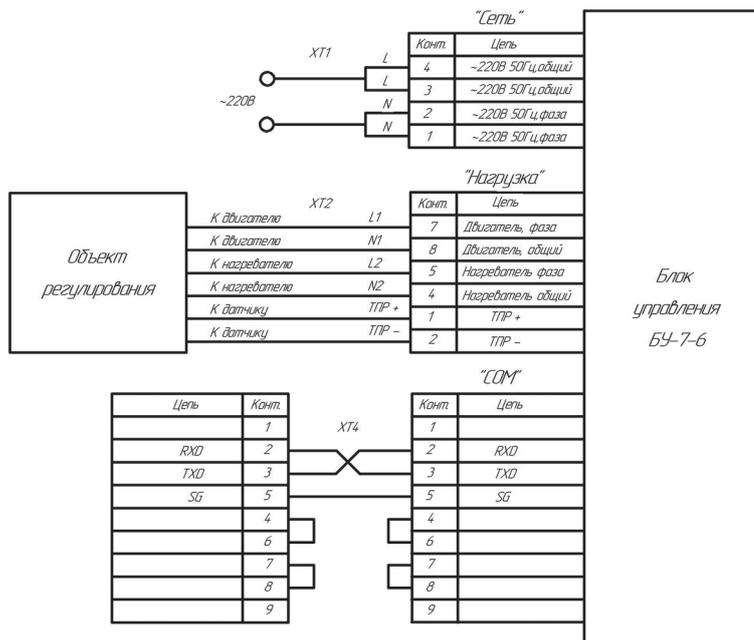

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- блок управления БУ-7-6 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- диск с программным обеспечением 1 шт.
- кабель питания ХТ1\* ДДШ6.644.004 1 шт.
- кабель силовой ХТ2\* ДДШ6.644.064 1 шт.
- кабель интерфейсный ХТ4\* ДДШ 6.644.033 1 шт.

\* поставляется по отдельной заявке потребителя

### БУ-7-7


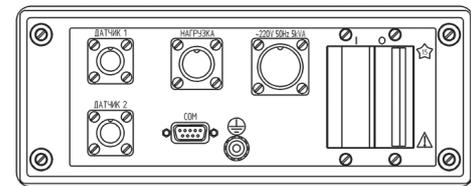


Схема подключения БУ-7-7

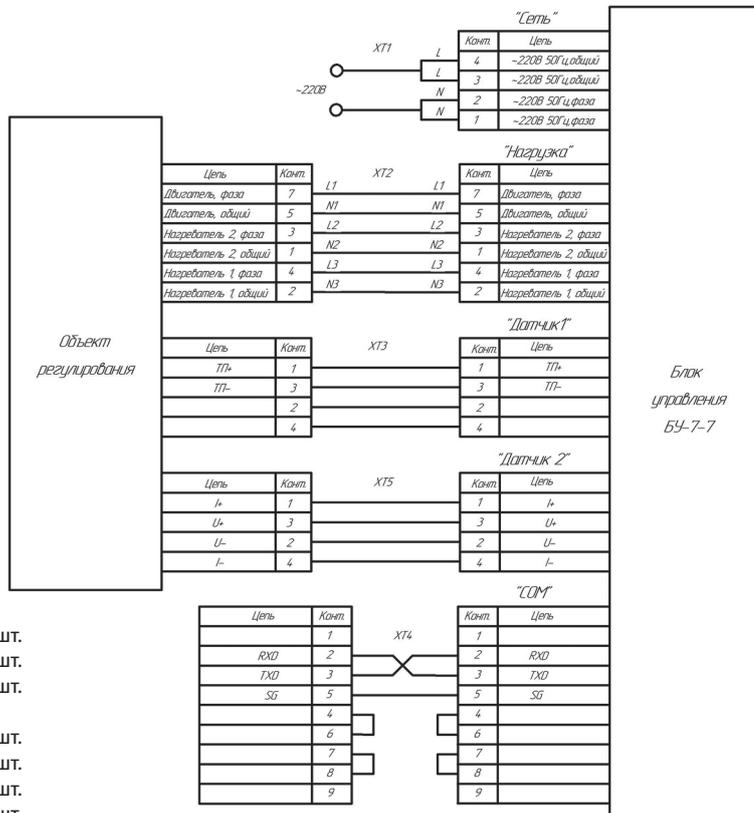

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- блок управления БУ-7-7 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- диск с программным обеспечением 1 шт.
- кабель питания ХТ1\* ДДШ6.644.004 1 шт.
- кабель силовой ХТ2\* ДДШ6.644.076 1 шт.
- кабель измерительный ХТ3, ХТ5\* ДДШ 6.644.022 1 шт.
- кабель интерфейсный ХТ4\* ДДШ 6.644.033 1 шт.

\* поставляется по отдельной заявке потребителя



**БУ-7-8**


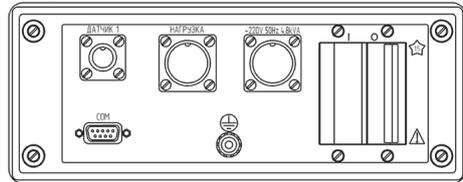


Схема подключения БУ-7-8

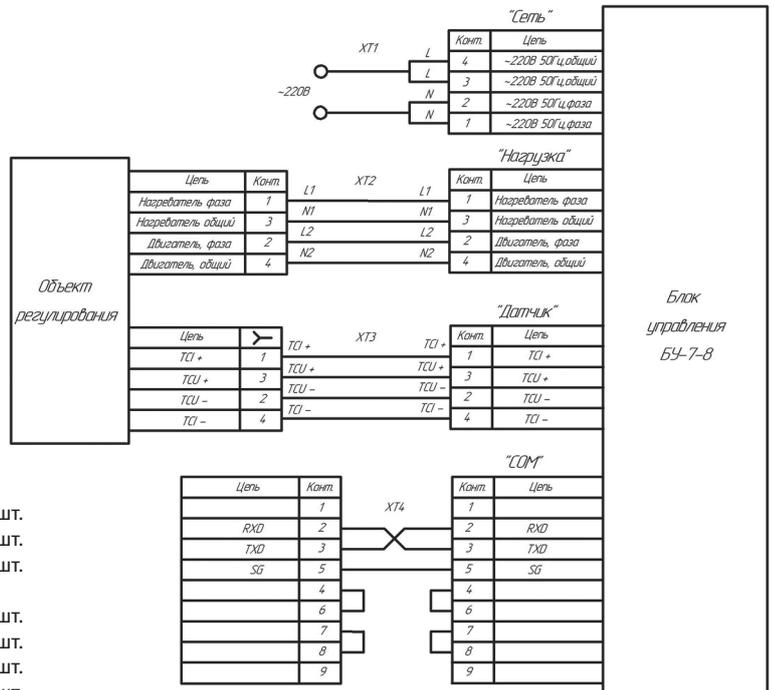

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- блок управления БУ-7-8 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- диск с программным обеспечением 1 шт.
- кабель питания ХТ\* ДДШ 6.644.004 1 шт.
- кабель силовой ХТ2\* ДДШ 6.644.023 1 шт.
- кабель измерительный ХТ3\* ДДШ 6.644.022 1 шт.
- кабель интерфейсный ХТ4\* ДДШ 6.644.033 1 шт.

\* поставляется по отдельной заявке потребителя

**БУ-7-9**


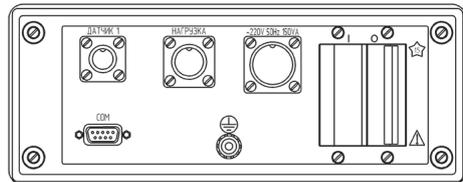


Схема подключения БУ-7-9

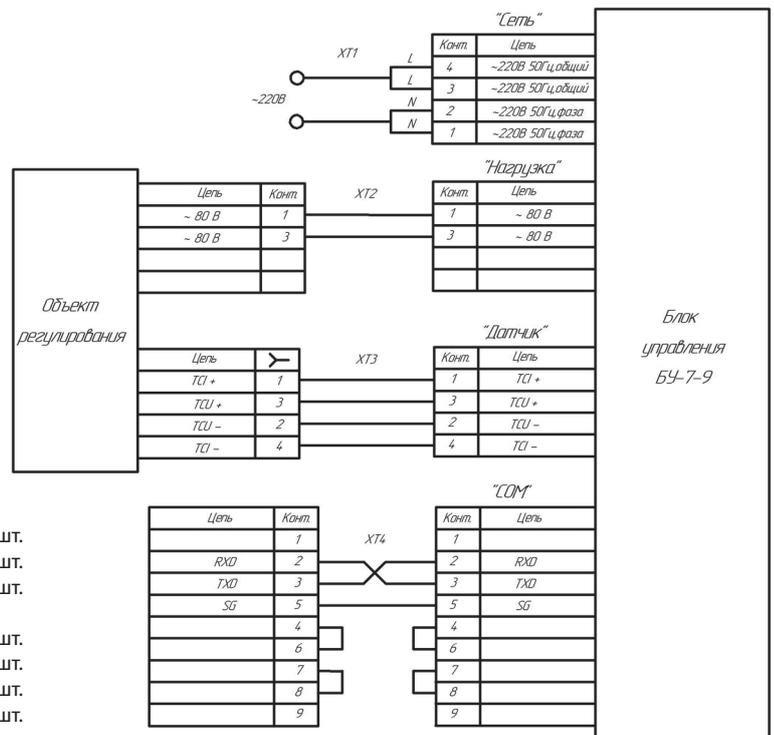

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- блок управления БУ-7-9 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- диск с программным обеспечением 1 шт.
- кабель питания ХТ1\* ДДШ 6.644.004 1 шт.
- кабель силовой ХТ2\* ДДШ 6.644.087 1 шт.
- кабель измерительный ХТ3\* ДДШ 6.644.022 1 шт.
- кабель интерфейсный ХТ4\* ДДШ 6.644.033 1 шт.

\* поставляется по отдельной заявке потребителя



# ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ И РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

## УСТРОЙСТВА КОМПЕНСАЦИИ УК, УК-3

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Устройства компенсации предназначены для измерения температуры холодных концов термопар с целью автоматической компенсации их термо-ЭДС.

Устройства компенсации используются совместно с измерителями и регуляторами температуры и в других случаях, когда возникает необходимость получения данных о температуре холодных концов термопар.

К устройствам компенсации УК, УК-3 можно подключить одну или три термопары соответственно.

Устройства компенсации имеют прямоугольные корпуса, в которых размещены выравнивающие блоки из меди с зажимами для концов термопар, а также платы из стеклотекстолита с зажимами для проводов, соединяющих устройства компенсации с вторичными приборами. Устройства компенсации содержат датчики температуры холодных концов термопар, размещенные внутри выравнивающих блоков.

УК

УК-3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	УК	УК-3
Тип датчика температуры холодных концов термопар	ТСМ (50М; $W_{100}=1,4280$ ), класс В, 4-х проводное включение	ТСМ (50М; $W_{100}=1,4280$ ), класс В, 4-х проводное включение
Количество подключаемых термопар	1	3
Погрешность измерения температуры холодных концов термопар в диапазоне температур 0...40°C, °С, не более	±0,4	±0,4
Входит в состав изделий	БУ-7-4, БУ-7-7	БУ-7-0, БУ-7-2, ПРТ 50-700

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Устройство компенсации УК-3»



# БЕСПРОВОДНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ С РАДИОМОДЕМОМ ПИ РМ



Преобразователи интеллектуальные с радиомодемом ПИ РМ зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 70187-18. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.670.A № 68844.

Преобразователь интеллектуальный с радиомодемом ПИ РМ признан лауреатом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», 2017 г.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

преобразователь интеллектуальный с радиомодемом (далее ПИ РМ) предназначен для:

- измерения температуры с помощью подключенных термопар и термометров сопротивления (модификация ТС/ТП);
- измерения других физических величин с помощью подключенных измерительных преобразователей с унифицированным выходным сигналом (модификация Т/Н);
- передачи измеренных значений по радио-каналу на ПК с последующим графическим отображением и архивированием данных.

### ОСОБЕННОСТИ:

- настройка и обновление ПО производится по радио-каналу;
- дальность устойчивой радиосвязи до четырёх раз выше, чем у «Wi-Fi»;
- сигнализация о выходе измеряемых величин за пределы заданных пороговых значений;
- включение/отключение компенсации холодного спада термопар;

ПИ РМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Модификации изделия	ТС/ТП	Т/Н
Количество и типы каналов	Два идентичных канала для подключения: термопар или термометров сопротивления (по 4-х проводной схеме подключения)	Два идентичных канала для подключения: внешних измерительных преобразователей с универсальным токовым выходом или универсальным выходом напряжения
Измеряемые физические величины	<b>Температура</b>	<b>В зависимости от подключенных измерительных преобразователей (температура, давление, расход и т.д.)</b>
Типы поддерживаемых датчиков/измерительных преобразователей	Термопары:	
	ТПП(С)	0 ... +1750 °С
	ТПР(В)	+ 600 ... +1800 °С
	ТХК(Л)	-100 ... +800 °С
	ТЖК(Л)	-100 ... +1200 °С
	ТХА(К)	-100 ... +1300 °С
	Термометры сопротивления:	
	50П, 100П, Pt50, Pt100	-100 ... +750 °С
	50М, 100М	-100 ... +200 °С
Основная приведённая погрешность измерения, не более	Для термопар типа ТПП(С), ТПР(В) – 0,5% Для термопар остальных типов 0,2% Для всех типов термометров сопротивления 0,2%	Для всех типов подключаемых измерительных преобразователей 0,2%
Рабочая температура окружающей среды, °С	от - 40 до + 70	
Напряжение питания, В	постоянное от 12 до 36	
Ток потребления, мА (не более)	100	
Дальность устойчивой радиосвязи	На открытой местности — до 1000 метров. Внутри зданий и сооружений дальность зависит от условий распространения радиосигнала (количества, размеров и материалов стен, перекрытий и т.д.)	
Количество изделий в одной радиосети	до 50	
Количество радиосетей, работающих на разных частотных каналах, на одном или нескольких ПК	до 8	



Посредством настройки программного обеспечения ПИ РМ могут быть сгруппированы количеством до 50 приборов в одну сеть типа «звезда». Данное техническое решение позволяет одновременно контролировать состояние параметров объектов участвующих в различных технологических процессах и предупреждать оператора об изменении измеряемой физической величины, выходящей за пределы установленные пользователем.



ПИ РМ

**Беспроводная сеть типа «звезда»**



**Количество ПИ РМ в одной измерительной сети – до 50 шт.,  
с различными типами датчиков для измерения различных физических величин.**

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

Наименование	Кол-во	Примечание
Преобразователь интеллектуальный с радиомодемом ПИ РМ	1 шт.	
Руководство по эксплуатации МКСН.405544.028 РЭ	1 экз.	
Паспорт МКСН.405544.028 ПС	1 экз.	
Антенна ВУ-433-01 МКСН.464659.001	1 шт.	
Программное обеспечение МКСН.64302566540.00027	1 комплект	
Кронштейн ALMF-001BK с винтом (Gainta)	2 шт.	
Переходник USB/PM МКСН.467141.003	1 шт.	По заявке потребителя

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

**«Преобразователь интеллектуальный ПИ РМ - XX»**

где: XX – модификация изделия:

00 - ТС/ТП — с подключением термодпар и термометров сопротивления,

01 - Т/Н — с подключением измерительных преобразователей

с унифицированным выходным сигналом.



## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПИ 1601-ТС-4-20 С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4-20 МА

#### НАЗНАЧЕНИЕ:


Преобразователь измерительный ПИ 1601-ТС-4-20 предназначен для измерения и преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления (ТС) с номинальной статической характеристикой (НСХ) по ГОСТ 6651-2009 в унифицированный токовый выходной сигнал 4-20 мА. Преобразователь устанавливается в головку датчика температуры, обеспечивает измерение сигналов ТС и выдает унифицированный токовый выходной сигнал 4-20 мА. Преобразователь является одноканальным однофункциональным микропроцессорным устройством с линейной зависимостью выходного сигнала от измеренной температуры.

ПИ 1601-ТС-4-20



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Значение
Номинальное напряжение электропитания, В	24±1,2
Диапазон допустимых питающих напряжений, В	от 11 до 30
Уровень выходного унифицированного сигнала постоянного тока, мА	4-20
Максимальный диапазон выходного тока, мА	от 3,8 до 20,5
Уровень аварийного токового сигнала в зависимости от конфигурации, мА	3,2; 3,6; 21; 22
Время установления рабочего режима, мин, не более	15
Время установление выходного сигнала, с, не более	1
Время демпфирования входного сигнал (время усреднения измерений), с	от 1 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,67
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP40
Масса, кг, не более	0,05
Средняя наработка на отказ при номинальном напряжении питания, ч, не менее	50000
Средний срок службы, лет, не менее	12
Межповерочный интервал, лет	4
Интерфейс подключения к ПК	USB
Гальваническая развязка входных цепей от выходных	отсутствует
Схема подключения ТС к преобразователю	2-х, 3-х или 4-х проводная
Сопротивление каждого провода подключения ТС к преобразователю, Ом, не более	2,5
Сопротивления нагрузки, Ом, не более	500 при напряжении питания 24 В

Внешний вид и габаритные размеры преобразователя ПИ 1601-ТС-4-20

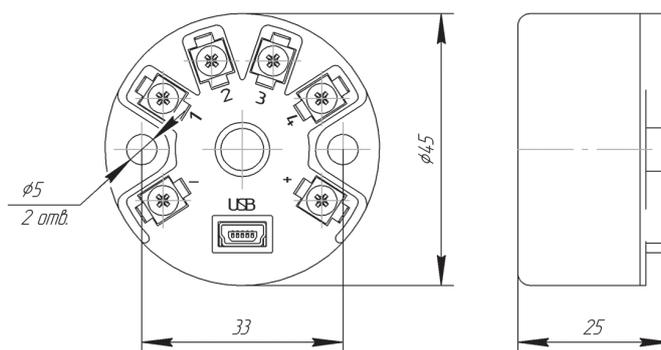

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователя ПИ 1601 ТС 4 20

Пределы измерений, °C	Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %	Класс точности
600...796	±0,15	0,15
400...599	±0,2	0,2
300...399	±0,25	0,25
200...299	±0,4	0,4
100...199	±0,5	0,5
50..99	±1,0	1,0
25...49	±1,5	1,5

#### ТИПЫ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ТС:

Тип ТС	Сопротивление, Ом	Температурный коэффициент $\alpha$ по ГОСТ 6651-2009, °C <sup>-1</sup>	Максимальный диапазон измерения, °C
100П	100	0,00391	- 196 ... + 600
Pt100		0,00385	- 196 ... + 600
100М		0,00428	- 100 ... + 200
50П	50	0,00391	- 196 ... + 600
Pt50		0,00385	- 196 ... + 600
50М		0,00428	- 100 ... + 200




(Пределы измерений - алгебраическая разность между верхней и нижней границами диапазона измерений)

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 52931-2008	C4
- температура окружающей среды, °C	от - 40 до +80
- влажность (без конденсации влаги) при 35 °C, %, не более	95
- режим работы	непрерывный



Сервисное программное обеспечение ПИ 1601

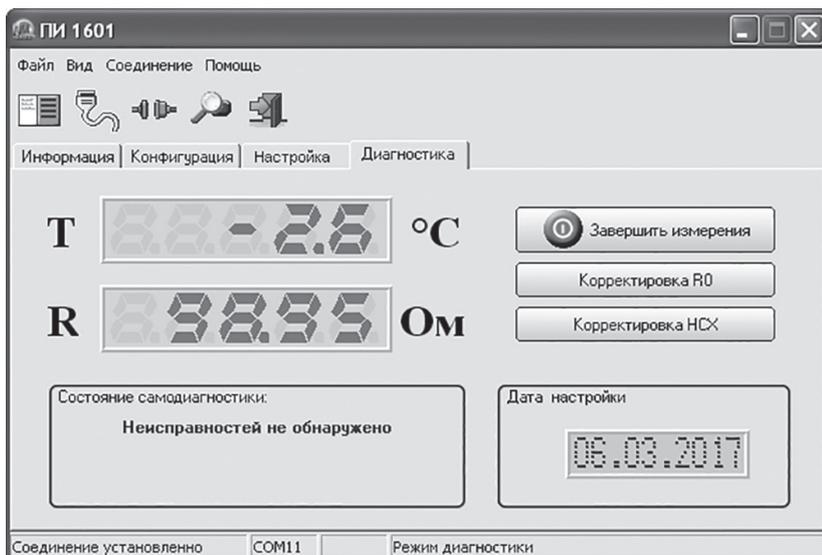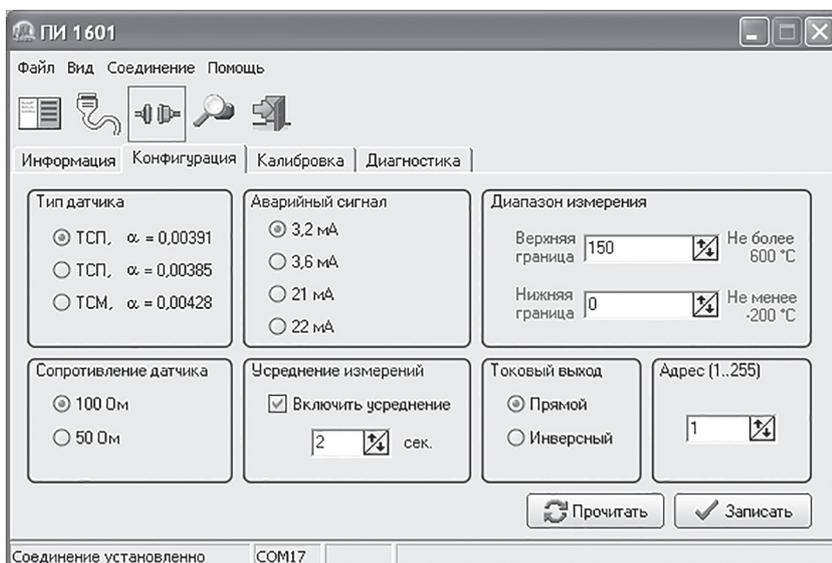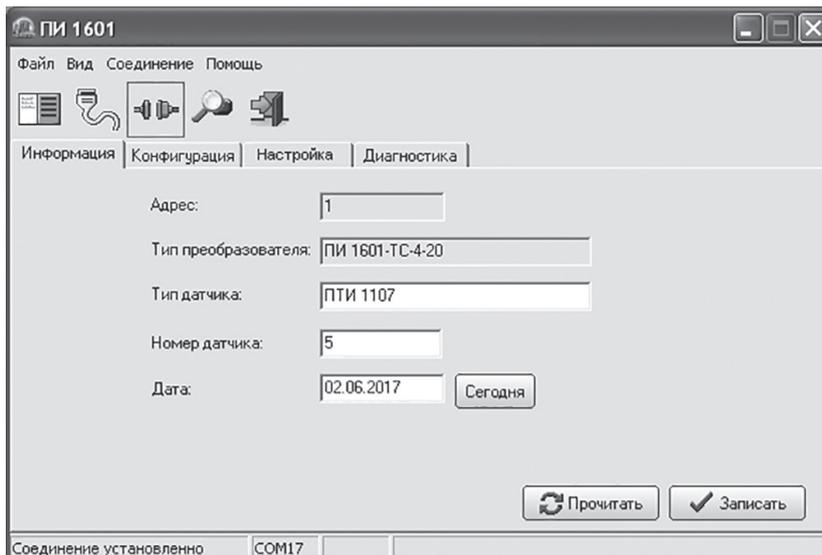

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- преобразователь ПИ 1601-ТС-4-20 - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации МКСН.405591.003 РЭ - 1 экз.;
- комплект монтажных частей - 1 комплект.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Преобразователь измерительный ПИ 1601-ТС-4-20»





# ПИРОМЕТРЫ

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПИРОМЕТРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПП-1	ПТ-1	ПД-9	СТ-2	ПД-4	ПД-5*	ПД-6	ПД-7	ПД-10
Диапазон измерения температуры, °С	-20...+2000	-40...1100	400...1400	300...2000	800...2500	400...1400	300...2000	300...2500	300...2500
Показатель визирования	1:40	1:20	1:100	1:50	1:500	1:150	1:100	1:150	1:150
Рабочая температура, °С	до 50	до 50	до 50	до 50	до 50	-30...+50	до 50	Кабель до 150	
Время отклика, с	1.0	0,5	1.0, 0.2, 0.1	1.0, 0.2, 0.1	1.0, 0.2, 0.1, 0.05	0.5	1.0, 0.2, 0.1, 0.05	1.0, 0.2, 0.1, 0.05	1.0, 0.2, 0.1, 0.05
Выходной сигнал, мА (токовый выход)	Термопарный вход	0 - 20, 4 - 20, 0 - 5 перепрограммируемые пределы токового выхода							
Тип интерфейса	RS232	RS232	RS232	RS232	RS232	RS232	RS232	RS232	RS232
Микропроцессорная обработка сигнала	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Уставка параметров предупреждения	-	две перепрограммируемые уставки				одна перепрограммируемая уставка	две перепрограммируемые уставки		Пид регулятор
Встроенный ЖКИ дисплей, панель управления	+	+	+	Светодиодный	+	Светодиодный	+	+	+
Тип питания	9В	24В	24В	24В	24В	24В	24В	24В	24В
Спектральный диапазон, мкм	8...14	8...14	0,9...1,7	0,9...1,7	0.656 0.950	0,9...1,7	0,9...1,7	0,9...1,7	0,9...1,7
Коэффициент излучения (коррекция)	0.1...1.5 с шагом 0.01	0.1...1.5 с шагом 0.001		0.1...1.5 с шагом 0.01	0.1...1.5 с шагом 0.001				
Предел допускаемой основной погрешности, %	± 1 %	± 1 %	-01: ±5 °С -02: 0.28%+0,5 °С	± 1 %	± 0.5 %, ± 0.2 %	± 0.5 %	± 0.5 %	± 0.5 %	± 1 %

ПД-5\* - Выходной сигнал, мА: 0 - 20, 4 - 20, 0 - 5 перепрограммируемые пределы токового выхода, имитация термопар (13 типов)

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПИРОМЕТРАМИ

Оптическая система формирует поле зрения пирометра – область пространства, в пределах которой производится измерение температуры. Для корректного проведения измерений необходимо, чтобы объект полностью перекрывал поле зрения. В противном случае, во первых, поток теплового излучения, попадающий на приемник (датчик) пирометра от объекта измерения, уменьшится пропорционально сокращению перекрываемой объектом площади, во вторых, на приемник будет попадать излучение заднего фона (объектов, расположенных за объектом измерения).


В качестве параметра, определяющего диаметр поля зрения пирометра, обычно используют "показатель визирования" η, равный отношению диаметра поля зрения к расстоянию до точки измерения.

### Например: для пирометра ПД-9-01.

Показатель визирования пирометра не менее 1:100, что соответствует пятну визирования 10 мм при расстоянии до контролируемой поверхности 1000 мм. На рисунке показано поле зрения пирометра ПД-9

Также следует учитывать, что пирометром может быть измерена только температура поверхности объекта, измерение температуры внутри объекта возможно лишь путем нарушения его целостности (что справедливо и для контактных средств измерения).

Поле зрения пирометра ПД-9

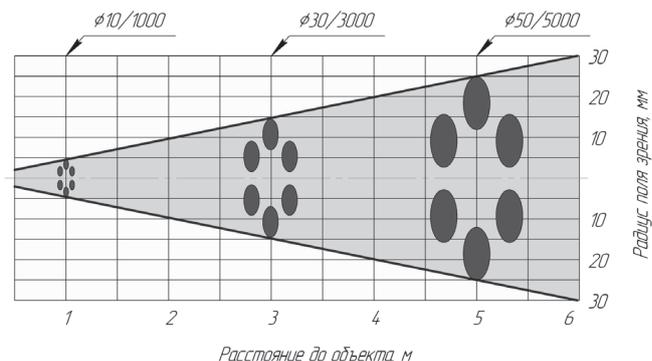



## ПИРОМЕТРЫ ПОРТАТИВНЫЕ СЕРИИ ПП-1



**ТУ 50-00 ДДШ 2.820.008 ТУ**

Тип средства измерения зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № № 22674-07

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Пирометры портативные серии ПП-1 предназначены для бесконтактного измерения температуры поверхности объектов по их собственному тепловому излучению в диапазоне температур от -20 до +2000°C. Пирометры применяются для контроля состояния объектов и технологических процессов в различных отраслях, а также при проведении научных исследований.

Благодаря использованию высококачественной германиевой оптики и специальных инфракрасных фильтров пирометры ПП-1 работают в спектральном диапазоне 8...14 мкм, в котором поглощение ИК-излучения атмосферой минимально. Наведение на объект контроля производится при помощи лазерного целеуказателя. Имеется возможность записи измеренных значений в энергонезависимую память пирометров.

### В ПИРОМЕТРАХ СЕРИИ ПП-1 ПРЕДУСМОТРЕНО:

- лазерный целеуказание;
- включение/выключение внутреннего цифрового фильтра;
- десятиразрядный ЖК-дисплей с подсветкой;
- энергонезависимая память на 20 измерений;
- подключение внешней термопары;
- экспериментальное определение излучательной способности объекта с использованием внешней термопары;
- связь с ЭВМ по интерфейсу RS-232, гальваническая развязка;
- измерение текущего значения напряжения питания прибора;
- индикация значения температуры внутри прибора;
- визуальная и звуковая сигнализация выхода параметров за допустимые значения;
- автоматическое отключение через заданное время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПП-1-01	ПП-1-02	ПП-1-03
Диапазон измеряемых температур, °C	-20...+400	100...1200	400...2000
Спектральный диапазон, мкм	8...14		0,9...1,7
Показатель визирования	1: 40		
Вид индикации	ЖКИ, 10 разрядов, подсветка		
Разрешающая способность индикации, °C	0,1		
Основная абсолютная погрешность, °C, не более	4	4 в диапазоне от 100 до 400 °C	-
Основная приведенная погрешность, % от диапазона, не более	-	1 % в диапазоне от 400 до 1200 °C	1 %
Время установления показаний, с, не более	1		
Диапазон возможной установки коэффициента коррекции излучательной способности	0,10...1,50		
Дискретность установки коэффициента коррекции излучательной способности	0,01		
Связь с ЭВМ	RS-232		
Работа с внешней термопарой			
- тип датчика (НСХ)	ТПП(С), ТПП(Р), ТПР(В), ТЖК(Л), ТМК(Т), ТХКн(Е), ТХА(К), ТНН(Н), ТВР(А1), ТВР(А2), ТВР(А3), ТХК(Л), ТМК(М) по ГОСТ Р 8.585-2001		
- диапазон измерения	полный диапазон согласно ГОСТ Р 8.585-2001		
- погрешность измерения	не нормируется		
- наличие компенсации холодных концов	имеется		
- разрешающая способность индикации, °C	0,1		
- соединительный разъем	аудио штеккер, моно, диаметром 3,5 мм		
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2		
Температура окружающего воздуха, °C	5...50		
Питание	+9 В, элемент типа "Крона" (не входит в комплект поставки), возможно подключение к внешнему блоку питания		
Ток потребления (при выключенной подсветке), мА, не более	15		
Габаритные размеры, мм, не более	60x100x140		
Масса, кг, не более	0,5		

Большая золотая медаль  
"Гарантия качества и безопасности" в номинации  
"Контроль качества и безопасности"



ПП-1



### ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

Входящее в комплект поставки программное обеспечение Piro Visual, совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:

- идентифицировать пирометр;
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение температуры;
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности;
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параметров за допустимые значения;
- считывать измеренные значения, записанные в энергонезависимой памяти пирометра;
- производить визуализацию измерений в виде графика в режиме реального времени;
- вести непрерывную запись текущих измеренных значений в файл на жестком диске компьютера;
- выводить графики или их фрагменты на принтер;
- проводить подстройку пирометра;
- и др.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- пирометр портативный ПП-1;
- руководство по эксплуатации
- ДДШ 2.820.008 РЭ;
- преобразователь термоэлектрический
- ТХА 9909-40 ДДШ 2.821.135-40;
- кабель ДДШ 6.644.090;
- программное обеспечение "Piro Visual".

### ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Пирометр портативный ПП-1-XX»  
где XX - исполнение ПП-1



## ПИРОМЕТРЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ СЕРИИ ПД-4



ТУ 4211-012-02566540-2004

Тип средства измерения утвержден и зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 29468-05

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Пирометры прецизионные серии ПД-4 предназначены для высокоточного измерения и регулирования температуры твердых тел в диапазоне 800...2500°C.

Пирометры снабжены оптическим видеоискателем (визирной трубой) и позволяют измерять температуру объектов диаметром от 10 мм (800...2500°C) и до 3,3 мм (1200...2500°C).

Управление работой пирометров и индикация измеренных значений осуществляются при помощи ЭВМ.

Пирометры могут быть использованы для замены существующих оптических пирометров типа ЭОП-66, ЭОП-93.

Прецизионные стационарные пирометры серии ПД-4 благодаря высокому оптическому разрешению обеспечивают возможность измерения температуры малых объектов, высокоскоростной процессор позволяет обрабатывать и передавать на ПЭВМ и токовый выход до 20 измерений в секунду. Оптическая система наведения позволяет наблюдать область измерения температуры на фоне объекта контроля.

Пирометры прецизионные серии ПД-4 имеют исполнение

**ПД-4-06 - эталонный пирометр 1 разряда,**

подробную информацию см. в разделе «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для контактной и бесконтактной термометрии».

**В ПИРОМЕТРАХ СЕРИИ ПД-4 ПРЕДУСМОТРЕНО:**

- изменяемое фокусное расстояние;
- связь с ЭВМ по интерфейсу RS-232;
- выбор скорости измерений из ряда 1; 5; 10; 25; 50; 100 изм./с;
- включение/выключение внутреннего цифрового фильтра, уменьшающего уровень шумов;
- возможность изменения параметров цифрового фильтра;
- одновременный аналоговый и цифровой выходы;
- вывод результатов измерения в цифровом виде на ЭВМ;
- токовый выход с программируемым диапазоном температур и видом унифицированного токового выходного сигнала (0-5), (0-20) или (4-20) мА;
- выходной логический ключ (5В, 20мА) сигнализация обрыва токового выхода;
- два выходных логических ключа (5В, 20мА) для двух изменяемых уставок;
- индикация на ЭВМ температуры внутри корпуса прибора.

ПД-4

**ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:**


Входящее в комплект поставки программное обеспечение PiroVisual, совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:

- идентифицировать пирометр;
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение измеренной температуры;
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности;
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параметров за допустимые значения;
- производить визуализацию измеренных значений в виде графика в режиме реального времени;
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске;
- выводить графики или их фрагменты на принтер;
- изменять параметры цифрового фильтра ПД-4 и скорость измерений;
- настраивать токовый выход;
- проводить подстройку пирометра;
- и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПД-4-01	ПД-4-02	ПД-4-03	ПД-4-04	ПД-4-05
Диапазон измерений, °C	1000...2500	800...2300	1200...2500	1000...2300	800...2500
Эффективная длина волны, нм	650±200	950±200	656,3±10	950±10	1550±200
Показатель визирования	1:100		1:300		1:100
Номинальное рабочее расстояние, мм	1000±100				420±50
Индикация	на ЭВМ				
Разрешающая способность индикации, °C	0,001				
Разрешающая способность*, °C	до 0,01				
Основная приведенная погрешность, % от диапазона, не более	0,5	0,25		0,5	
Время установления выходного сигнала, мс, не более	50				
Время установления рабочего режима, мин, не более	15				
Диапазон возможной установки коэффициента коррекции излучательной способности	0,100...1,500				
Дискретность установки коэффициента коррекции излучательной способности	0,001				
Связь с ЭВМ	RS-232				
Температура окружающего воздуха, °C	5...40	20±5		5...40	
Питание	+(24±0,5) В				
Потребляемая мощность, Вт, не более	10				
Габаритные размеры, мм, не более:					
- пирометра	257x300x57				
- блока питания	232x96x96				
Масса пирометра, кг, не более	1,5				
*при включении цифрового фильтра					



Схема подключения пирометра прецизионного ПД-4

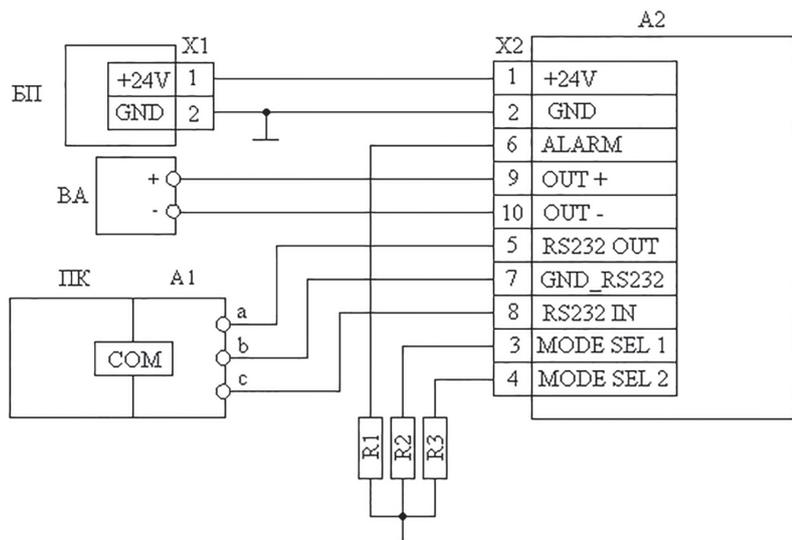

A1 – разъем для COM-порта кабеля ДДШ6.644.089 (из комплекта);

A2 – пирометр прецизионный ПД-4;

БП – блок питания стабилизированный БПС 24-0,3 (из комплекта);

ВА – миллиамперметр постоянного тока с погрешностью не более 0,05 % в диапазоне (0...20) мА, например, прибор комбинированный цифровой В7-99 в режиме миллиамперметра;

ПК – IBM-совместимый компьютер с процессором, не хуже 486;

R1...R3 – резисторы типа С2-36-0.125-250 Ом ± 1 % при проверке работы выходных ключей пирометра, либо любая другая нагрузка с током потребления не более 20 мА при эксплуатации пирометра;

X1 – розетка MSTB 2.5/2-G-5.08;

X2 – розетка 2PMT22КПН10Г1Б1В;

COM – любой из последовательных девятиконтактных портов ПК.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

Наименование	Кол-во
Пирометр прецизионный ПД-4 ДДШ2.820.011	1 шт.
Паспорт ДДШ 2.820.011 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации на пирометр ДДШ2.820.011РЭ	1 экз.
Методика поверки ДДШ 2.820.011 ДЗ	1 экз.
Кабель ДДШ 6.644.089 для ПД-4-01... ПД-4-04, ПД-4-06	1 шт.
Кабель ДДШ 6.644.089-01 для ПД-4-05	1 шт.
Труба визирная ТЗ-6	1 шт.
Светофильтр ДДШ3.900.008	1 шт.
Блок питания стабилизированный БПС 24-0.3 ДДШ2.087.006-01	по заявке потребителя
Программное обеспечение "Piro Visual" 643.02566540.00007 - 01	1 комплект


**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Пирометр прецизионный ПД-4-XX»

XX - исполнение прибора

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- монтажная арматура (держатель)

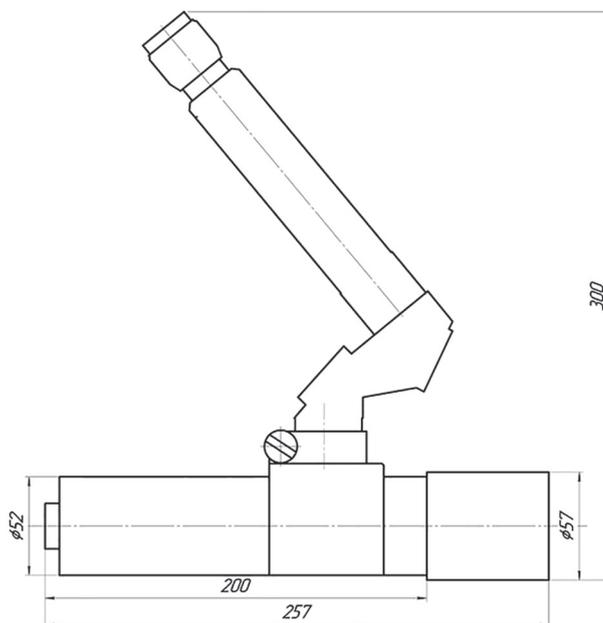

Габаритный чертеж пирометров прецизионных ПД-4-01...ПД-4-05



## ПИРОМЕТРЫ ПД-9-01

ТУ 4211-076-02566540-2007

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Пирометры серии ПД-9 разработаны для применения в металлургии, машиностроении.

Предназначены для измерения температур металлов, сыпучих веществ, полупроводников, расплава стекла на глубине.

**ПИРОМЕТР ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ:**

**ПД-9-01 - рабочее средство измерений;**

**ПД-9-02 - эталонный (образцовый пирометр 1 разряда).**

подробную информацию см. в разделе «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для контактной и бесконтактной термометрии».

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:**

Пирометры серии ПД-9 предназначены для бесконтактного измерения температуры нагретых тел по их тепловому излучению. Пирометры этой серии оснащены шеститочечным круговым лазерным целеуказателем, который значительно упрощает процесс наведения и фокусировки на объекте измерений, подсвечивая контур пятна визирования прибора. Показатель визирования пирометра не менее 1:100, что соответствует пятну визирования 10 мм при расстоянии до контролируемой поверхности 1000 мм. Кожух пирометра выполнен из нержавеющей стали, позволяющей предохранить прибор от коррозии.

Измеренное значение температуры отображается на десятиразрядном ЖК-дисплее со светодиодной подсветкой. При помощи кнопок управления на панели пирометра возможно изменять настройки прибора и проводить коррекцию на излучательную способность объекта контроля.

**МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА БЛОКА ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ПОЗВОЛЯЕТ:**

- индицировать значение измеряемой температуры на ЖК-дисплее с разрешением 0.01°C
- корректировать коэффициент излучательной способности с дискретностью 0.001
- контролировать и выводить на экран монитора персонального компьютера в графическом виде значение температуры в реальном времени, а также сохранять полученные результаты для последующей обработки
- осуществлять подсветку лазерным целеуказателем, показывая действительное пятно контроля на объекте
- производить автоматическую калибровку нуля
- настраивать цифровой фильтр и быстрое действие
- производить выбор режима работы токового выхода (0-5, 0-20, 4-20 мА) и задавать динамический диапазон температуры (например 0-5 мА и диапазон 500-700 °C)
- регулировать температуру двумя логическими ключами
- осуществлять блокировку кнопок управления от несанкционированного доступа к настройкам прибора при помощи пароля

**ВХОДЯЩЕЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PIRO VISUAL, СОВМЕСТИМОЕ С WINDOWS 95/98/XP, ПОЗВОЛЯЕТ:**

- идентифицировать пирометр
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение температуры
- производить визуализацию измерений в виде графика в режиме реального времени
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности
- производить выбор режима работы токового выхода
- производить автоматическую калибровку нуля
- настраивать цифровой фильтр и быстрое действие
- проводить калибровку пирометра
- настраивать режимы работы логических ключей (уставок)
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параметров за допустимые значения
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске
- выводить графики или их фрагменты на принтер



ПД-9-01

ИСПОЛНЕНИЕ пирометра	Диапазон измерений, °C	Спектральный диапазон, мкм
ПД-9-01	400...1400	0.9...1.7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПД-9-01
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °C, в диапазоне температур: 400...800 800...1400	±5 ±10
Разрешающая способность, °C	0.01
Показатель визирования	1:100
Время установления показаний, мс, не более	80
Выходной аналоговый сигнал по току, мА	0 – 5, 0 – 20, 4 – 20
Степень защиты от пыли и воды	IP00
Напряжение питания, В	24 ± 0,5
Потребляемая мощность, Вт	8
Температура окружающей среды, °C	5...50
Коррекция излучательной способности	0.1-1.5, шаг 0.001
Масса пирометра, кг	1,0
Габаритные размеры, мм	207,5x75,5

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

Наименование	Кол-во	Примечание
Пирометр ПД-9-01	1 шт.	
Руководство по эксплуатации ДДШ2.820.019 РЭ	1 экз.	
Методика поверки МП 2412-0020-2009	1 экз.	
Паспорт ДДШ2.820.019 ПС	1 экз.	
Кабель связи с ЭВМ ДДШ6.644.090	1 шт.	
Кабель питания ДДШ6.644.121	1 шт.	
Кабель ДДШ6.644.120	1 шт.	
Блок питания БПС-24-03 ДДШ2.087.006-01	1 шт.	По заявке потребителя
Программное обеспечение "Piro Visual"	1 комплект	CD-диск

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Пирометр ПД-9-01»



## ПИРОМЕТРЫ ПТ-1

ТУ 4211-071-02566540-2006

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Пирометры ПТ-1 разработаны для применения в пищевой, строительной, резинотехнической промышленности, машиностроении.

Предназначены для измерения температур поверхности обмуровки печей, керамики, бетона, резины.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Стационарные пирометры ПТ-1 разработаны для измерения температур от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $1100^{\circ}\text{C}$ . В пирометры этой модели устанавливаются термо-батарейные датчики со встроенным оптическим фильтром, обеспечивающим полосу пропускания 8-14 мкм. Датчик расположен в пассивном (не подогреваемом) термостате, компенсация температуры окружающей среды проводится посредством измерения температуры встроенного датчик терморезистора.

В оптическую систему пирометров устанавливается германиевая оптика и два лазерных модуля для наведения на объект измерений. **Показатель визирования пирометра не менее 1:20, что соответствует пятну визирования 25мм при расстоянии до контролируемой поверхности 500 мм и 50мм - при расстоянии до контролируемой поверхности 1000 мм.** Лазерный двухточечный целеуказатель позволяет точно навести пирометр на объект контроля.

Измеренное значение температуры отображается на десятиразрядном ЖК-дисплее со светодиодной подсветкой.

При помощи кнопок управления на панели пирометра возможно изменять настройки прибора и проводить коррекцию на излучательную способность поверхности объекта контроля.



ПТ-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПТ-1
Диапазон измерений, $^{\circ}\text{C}$	$-40...1100$
Спектральный диапазон, мкм	8...14
Основная погрешность	$\pm 4^{\circ}\text{C}$ ( $-40...400^{\circ}\text{C}$ ) $1\%$ ( $400...1100^{\circ}\text{C}$ )
Разрешающая способность	$0.5^{\circ}\text{C}$
Показатель визирования	1:20
Номинальное рабочее расстояние, мм	$1000 \pm 50$
Температура окружающей среды	$5...50^{\circ}\text{C}$
Коррекция излучательной способности	0.1-1.5, шаг 0.001
Время установления выходного сигнала, с, не более	0,5
Перестраиваемый унифицированный токовый выход, мА	0 – 5, 0 – 20, 4 – 20
Связь с ПК	RS-232
Степень защиты от пыли и воды	IP00
Потребляемый ток от сети 24 В, мА	30
Напряжение питания, В	$24 \pm 0,5$
Потребляемая мощность, В·А, не более	10
Масса пирометра, кг	1,0
Габаритные размеры, мм	150 x 100

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Наименование	Количество	Примечание
Пирометр ПТ-1 ДДШ2.820.016	1 шт.	
Руководство по эксплуатации на пирометр ПТ-1 ДДШ2.820.016 РЭ	1 экз.	
Кабель ДДШ6.644.090	1 шт.	Кабель интерфейсный
Кабель ДДШ6.644.121	1 шт.	Кабель питания
Кабель ДДШ6.644.120	1 шт.	Кабель токового выхода
Блок питания БПС-24-03 ДДШ2.087.006-01	1 шт.	По заявке потребителя
Программное обеспечение "Piro Visual"	1 комплект	CD-диск

### ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Пирометр ПТ-1»

### МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА БЛОКА ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ПОЗВОЛЯЕТ:

- индцировать значение измеряемой температуры на ЖК-дисплее с разрешением  $0.1^{\circ}\text{C}$
- корректировать коэффициент излучательной способности с дискретностью 0.001
- контролировать и выводить на экран монитора персонального компьютера в графическом виде значение температуры в реальном времени, а также сохранять полученные результаты для последующей обработки
- осуществлять наведение на объект контроля при помощи лазерных целеуказателей
- производить автоматическую калибровку нуля
- настраивать цифровой фильтр
- производить выбор режима работы токового выхода (0-5, 0-20, 4-20 мА) и задавать динамический диапазон температуры (например 0-5 мА и диапазон  $500-700^{\circ}\text{C}$ )
- регулировать температуру двумя логическими ключами
- осуществлять блокировку кнопок управления от несанкционированного доступа к настройкам прибора при помощи пароля

### ВХОДЯЩЕЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PIRO VISUAL, СОВМЕСТИМОЕ С WINDOWS 95/98/XP, ПОЗВОЛЯЕТ:

- идентифицировать пирометр
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение температуры
- производить визуализацию измерений в виде графика в режиме реального времени
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности
- производить выбор режима работы токового выхода
- производить автоматическую калибровку нуля
- настраивать цифровой фильтр
- проводить калибровку пирометра
- настраивать режимы работы логических ключей (уставок)
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параметров за допустимые значения
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске
- выводить графики или их фрагменты на принтер



## ПИРОМЕТРЫ СЕРИИ СТ-2

ТУ 4211-071-02566540-2006

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Пирометры серии СТ-2 разработаны для применения в металлургии, машиностроении.

Предназначены для измерения температуры металлов, сыпучих веществ, обмуровок высокотемпературных печей, контроля температуры технологических процессов в жестких климатических условиях.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:**

Пирометры серии СТ-2 разработаны для жестких условий эксплуатации на производстве. Конструкция прибора позволяет максимально изолировать оптические узлы прибора от воздействия пыли, паров, дыма, а также механических повреждений. Корпус пирометра выполнен из нержавеющей стали, позволяющей предохранить прибор от коррозии. Показатель визирования пирометра не менее 1:50, что соответствует пятну визирования 20 мм при расстоянии до контролируемой поверхности 1000 мм. Лазерный двухточечный целеуказатель позволяет точно навести пирометр на объект контроля.

Измеренное значение температуры отображается на точечном светодиодном дисплее, хорошо различимом при плохой освещенности на месте установки прибора. Коррекция на коэффициент излучательной способности объекта контроля осуществляется при помощи двух кнопок на задней части прибора, при этом на дисплее отображается текущее значение поправочного коэффициента.

**Микропроцессорная система блока обработки сигнала позволяет:**

- индцировать значение измеряемой температуры на светодиодном дисплее с разрешением 1 °С;
- корректировать коэффициент излучательной способности с дискретностью 0.01;
- контролировать и выводить на экран монитора персонального компьютера в графическом виде значение температуры в реальном времени, а также сохранять полученные результаты для последующей обработки;
- осуществлять наведение на объект контроля при помощи лазерных целеуказателей;
- производить выбор режима работы токового выхода (0-5, 0-20, 4-20 мА) и задавать динамический диапазон температуры (например 0-5 мА и диапазон 500-700 °С);
- регулировать температуру логическим ключом.

**Входящее в комплект поставки программное обеспечение Piro Visual, совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:**

- идентифицировать пирометр
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение температуры
- производить визуализацию измерений в виде графика в режиме реального времени
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности
- производить выбор режима работы токового выхода
- производить автоматическую калибровку нуля
- настраивать цифровой фильтр и быстродействие
- проводить калибровку пирометра
- настраивать режимы работы логических ключей (установок)
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параметров за допустимые значения
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске
- выводить графики или их фрагменты на принтер.



СТ-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТ-2
Основная приведенная погрешность, %	1
Разрешающая способность, °С	1
Показатель визирования	1:50
Температура окружающей среды, °С	5...50
Коррекция излучательной способности	0.1-1.5, шаг 0.01
Степень защиты от пыли и воды	IP00
Габаритные размеры, мм	195x63
Масса, кг	1

ИСПОЛНЕНИЕ пирометра	Диапазон измерений, °С	Спектральный диапазон, нм
СТ-2-01	300-1000	900-1700
СТ-2-02	900-2300	320-1100

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

Наименование	Кол-во	Примечание
Пирометр СТ-2 ДДШ2.820.021	1 шт.	
Руководство по эксплуатации ДДШ2.820.021 РЭ	1 экз.	
Паспорт ДДШ2.820.021 ПС	1 экз.	
Кабель ДДШ6.644.121	1 шт.	Кабель питания
Кабель ДДШ6.644.127	1 шт.	Кабель токового выхода
Кабель ДДШ6.644.090	1 шт.	Кабель интерфейсный
Блок питания стабилизированный БПС-24-03 ДДШ2.087.006-01	1 шт.	По заявке потребителя
Программное обеспечение ДДШ2.820.021 ПО	1 экз.	CD-диск

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Пирометр СТ-2-XX»

где XX - исполнение прибора.

## ПИРОМЕТРЫ ОПТОВОЛОКОННЫЕ СЕРИИ ПД-5

МКСН.405321.003 ТУ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Пирометр ПД-5 предназначен для бесконтактного измерения и контроля температуры нагретых поверхностей по их собственному инфракрасному излучению, или, совместно с ИК-термопреобразователем, для замены термоэлектрических преобразователей, работающих в диапазоне от 400 до 1700 °С (см. ИКТС и ИКТП).

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Прибор имеет литой пылевлагозащищенный корпус с отверстиями для крепления, работоспособен при температуре окружающей среды от -30 до +50°С. Приемник ИК-излучения выдерживает температуру окружающей среды до +200°С.. Между чехлом и приемником ИК-излучения устанавливается теплоизолирующий переходник со штуцером для подвода воздуха, что позволяет осуществлять продувку переходника охлаждающим воздухом и предотвратить перегрев приемника. Шайба, установленная на переходнике, служит защитным экраном от теплового излучения и выбросов пламени.

Пирометр обеспечивает индикацию температуры объекта с дискретностью 1,0 °С на светодиодном индикаторе, формирует унифицированный выходной сигнал постоянного тока, обеспечивает связь с IBM-совместимым компьютером (ПК).

В пирометре ПД-5 реализована схема имитации термодарного выхода. Температура, измеренная с помощью ИК-термопреобразователя, пересчитывается в значение термо-ЭДС для любого из 13 типов термопар, и напряжение соответствующей амплитуды выдается на контакты разъема. При замене штатной термопары на ИК-термопреобразователь нет необходимости заменять существующую систему контроля/регулирования, можно подключить пирометр к имеющемуся оборудованию.

Пирометр имеет ключ двухпозиционного регулирования, который может управлять внешним твердотельным реле. Таким образом можно осуществлять регулирование температуры или, например, отключить горелку котла при перегреве и т.п.

### ИСПОЛНЕНИЯ ПИРОМЕТРА ПД-5:

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	Длина оптоволоконного кабеля Lk, м	Тип выходных сигналов
-0.02	2	токовый выход (или имитация термопары); RS-232
-0.05	5	
-0.10	10	
-1.02	2	ключ регулирования; RS-232
-1.05	5	
-1.10	10	
-2.02	2	токовый выход (или имитация термопары); ключ регулирования
-2.05	5	
-2.10	10	

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Наименование	Кол-во	Примечание
Пирометр ПД-5	1 шт.	
Руководство по эксплуатации МКСН.405321.003 РЭ	1 экз.	
Паспорт МКСН.405321.003 ПС	1 экз.	
Кабель ДДШ6.644.090	1 шт.	
Кабель МКСН.685631.002	1 шт.	
Блок питания БПС-24-03 ДДШ2.087.006-01	1 шт.	По заявке потребителя
Программное обеспечение "PiroVisual" 643.02566540.00007-01	1 экз.	CD-диск

### ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:


"Пирометр ПД-5 - X";

└─── конструктивное исполнение пирометра ПД-5;  
 └─── тип пирометра.



ПД-5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПД-5
Диапазон измеряемых температур, °С	400 ...1400
Предел допускаемой основной погрешности, %, не более	± 0,5
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от -30 до 50 °С, не превышает	0,025 %/°С
Показатель визирования	1:150
Номинальное рабочее расстояние, мм	1000
Рабочее расстояние, мм	500...3000
Вид индикации	светодиодная
Перестраиваемый унифицированный токовый выход, мА	0 - 5, 0 - 20, 4 - 20
Схема имитации термодарного выхода	R, S, B, J, T, E, K, N, A-1, A-2, A-3, L, M
Связь с ЭВМ	RS-232
Потребляемая мощность, Вт, не более	8
Напряжения питания, В	24 ± 0,5
Время установления рабочего режима, с	300
Время установления показаний, с	0,5
Масса пирометра, кг	1,0
Габаритные размеры измерительного блока, мм	106 x 64 x 34

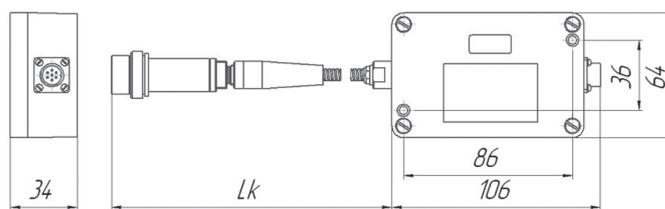

Габаритные и присоединительные размеры пирометра ПД-5

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Вид климатического исполнения	УХЛ 2
Температура окружающей среды, °С	-30 до 50
Относительная влажность воздуха	не более 95 % при температуре окружающей среды 35 °С
Атмосферное давление	от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
Устойчивость к вибрации (группа исполнения)	L3
Способ защиты от поражения электрическим током	класс III
Степень защиты от пыли и воды	IP54

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Пирометр ПД-5-0.05»





## ПИРОМЕТРЫ ОПТОВОЛОКОННЫЕ СЕРИИ ПД-6

ГОСТ 28243-96 по ТУ МКСН.405321.001 ТУ

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Пирометры серии ПД-6 разработаны для массового применения в металлургии, машиностроении, химической промышленности. Высокая степень защиты от электромагнитных помех позволяет использовать данный прибор для измерения температуры в индукционных печах.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Пирометры состоят из двух частей: приемника ИК-излучения (оптической головки) и блока обработки сигнала, соединенных между собой при помощи оптоволоконного кабеля, по которому от оптической головки к блоку обработки сигнала передается излучение от объекта контроля. Для монтажа оптической головки используется специальный кронштейн, поставляемый в составе пирометров.

Приемник ИК-излучения и оптоволоконный кабель выдерживают температуру до 150 °С (кратковременно – до 200 °С). **Приемник ИК-излучения и оптоволоконный кабель не чувствительны к воздействию электромагнитных полей.**

За счет того, что приемник ИК-излучения и блок обработки сигнала разделены между собой оптоволоконным кабелем (длина до 5 м), возможно располагать блок обработки сигнала в безопасной для него зоне, а оптическую головку в непосредственной близости от объекта контроля. Гибкий оптоволоконный кабель и маленькие габариты приемника ИК-излучения позволяют измерять температуру в труднодоступных местах.

Для наведения пирометра на объект контроля температуры пирометр снабжен *шеститочечным лазерным целеуказателем*. Подсветка пятна визирования осуществляется как в режиме измерения температуры, так и в режиме ожидания.

Пирометр имеет *уставку тревожной сигнализации*. Уставка срабатывания ключа позволяет установить верхнее и нижнее значение температуры, при которой срабатывает логический ключ. Его можно использовать для сигнализации повышения и понижения температуры, а так же, при подключении к твердотельному реле, для регулирования температуры объекта.

## В пирометре предусмотрено изменение следующих параметров:

1. «ε» - ввод значения коэффициента коррекции излучательной способности объекта измерения.
2. «Программный фильтр» - его включение снижает уровень шумов для более точных измерений.
3. «Количество измерений в секунду» - изменение быстродействия пирометра.
4. «Звуковая сигнализация превышения заданной температуры»
5. «Температурный диапазон токового выхода»
6. «Диапазон токового выхода» - выбор (0 – 5), (0 – 20), (4 – 20) мА или его отключение.
7. «Верхний и нижний пределы срабатывания ключа»
8. «Инверсия срабатывания ключа»
9. «Калибровка нуля» - автокоррекция.
10. «Пароль блокировки кнопок управления»

Используя цифровой канал пирометра, можно настроить все уставки с помощью компьютера. Для этого, в комплекте с пирометром, поставляется программа "PiroVisual".

## ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

Входящее в комплект поставки программное обеспечение "PiroVisual", совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:

- идентифицировать пирометр;
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение измеренной температуры;
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности;
- производить визуализацию процесса измерения в виде графика в режиме реального времени;
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске ПК;
- выводить графики или их фрагменты на принтер;
- изменять параметры цифрового фильтра и скорость измерений;
- настраивать токовый выход;
- проводить подстройку пирометра.



ПД-6



Оптические элементы прибора выполнены из кварцевого стекла.

Показатель визирования пирометра ПД-6 не менее 1:100, что соответствует пятну визирования 10 мм при расстоянии до контролируемой поверхности 1000 мм. На рисунке показано поле зрения пирометра ПД-6.

Исполнение пирометра	Температурный диапазон, °С	Оптоволоконный кабель	
		Вид	Длина, Л, м
ПД-6-300/1000-01	От 300 до 1000	несъемный	1
ПД-6-300/1000-02			2
ПД-6-300/1000-05			5
ПД-6-300/1000-01 СБЛ		съемный (без лазерной подсветки)	1
ПД-6-300/1000-02 СБЛ			2
ПД-6-300/1000-05 СБЛ			5
ПД-6-400/1400-01	От 400 до 1400	несъемный	1
ПД-6-400/1400-02			2
ПД-6-400/1400-05			5
ПД-6-400/1400-01 СБЛ		съемный (без лазерной подсветки)	1
ПД-6-400/1400-02 СБЛ			2
ПД-6-400/1400-05 СБЛ			5
ПД-6-500/2000-01	От 500 до 2000	несъемный	1
ПД-6-500/2000-02			2
ПД-6-500/2000-05			5
ПД-6-500/2000-01 СБЛ		съемный (без лазерной подсветки)	1
ПД-6-500/2000-02 СБЛ			2
ПД-6-500/2000-05 СБЛ			5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПД-6
Спектральный диапазон, мкм	0,9...1,7
Основная погрешность, %	± 0,5
Показатель визирования	1:100
Разрешающая способность, °С	0,01
Вид индикации	ЖКИ, 10 разрядов, подсветка
Номинальное рабочее расстояние, мм	1000±100
Диапазон рабочих расстояний, м	0,5...10
Выходы:	
- перестраиваемый унифицированный токовый выход, мА	0 – 5, 0 – 20, 4 – 20
- REG 1 (логический ключ)	5В, 20мА
Уставка тревожной сигнализации	световая
Напряжение питания, в	24 ± 0,5
Температура окружающей среды, °С	5...50
Температура эксплуатации приемника ИК-излучения, °С	-20...150
Коррекция излучательной способности	0,1...1,5 (шаг 0,001)
Связь с ПК	RS-232
Степень защиты от пыли и воды	IP52
Питание, В	24±0,5
Габаритные размеры, мм	см. габаритный чертеж
Масса, кг	1





## ПИРОМЕТРЫ ОПТОВОЛОКОННЫЕ СЕРИИ ПД-7



ГОСТ 28243-96 ТУ 4211-050-02566540-2005

Тип средства измерения утвержден и зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 31893-06

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Пирометры серии ПД-7 предназначены для измерения температур расплавов металла, сыпучих веществ, твердых тел.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Пирометры состоят из двух частей: оптической головки и блока обработки сигнала, соединенных между собой оптоволоконным кабелем, по которому от оптической головки к блоку обработки сигнала передается инфракрасное излучение от объекта контроля. Для монтажа оптической головки используется специальный кронштейн, поставляемый в составе пирометров.

Оптическая головка и оптоволоконный кабель выдерживают температуру до 150°C (кратковременно - до 200°C). Оптическая головка и оптоволоконный кабель не чувствительны к воздействию электромагнитных полей. Металлорукав из нержавеющей стали защищает оптоволоконный кабель от механических ударов и влияния агрессивной окружающей среды.

За счет того, что оптическая головка и блок обработки сигнала соединены между собой оптоволоконным кабелем, длина которого может достигать десяти метров (в стандартном исполнении - 2 м), возможно располагать блок обработки сигнала в безопасной для него зоне, а оптическую головку - в непосредственной близости от объекта контроля. Гибкий оптоволоконный кабель и маленькие габариты оптической головки позволяют измерять температуру в труднодоступных местах.

Высокий показатель визирования пирометра (1:150) позволяет контролировать на расстоянии 1000 мм температуру участка поверхности диаметром 6 мм.

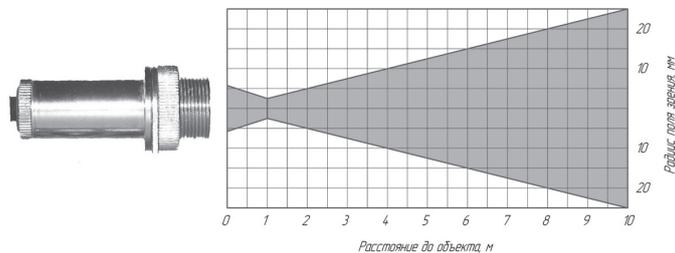


Диаграмма поля зрения пирометра ПД-7

## В ПИРОМЕТРАХ СЕРИИ ПД-7 ПРЕДУСМОТРЕНО:

- связь с ЭВМ по интерфейсу RS-232;
- выбор скорости измерений из ряда 1; 5; 10; 25 изм./с
- включение/выключение внутреннего цифрового фильтра, уменьшающего уровень шумов;
- возможность изменения параметров цифрового фильтра;
- одновременный аналоговый и цифровой выходы;
- вывод результатов измерения в цифровом виде на ЭВМ;
- токовый выход с программируемыми диапазоном температур и видом унифицированного токового выходного сигнала (0-5), (0-20) или (4-20) мА;
- два выходных логических ключа (5В, 20мА) для двух изменяемых уставок;
- лазерное целеуказание действительного поля зрения пирометра на поверхности объекта;
- блокировка при помощи пароля кнопок управления для защиты от несанкционированного доступа к настройкам прибора;
- индикация на ЭВМ температуры внутри прибора

Пирометр имеет уставку тревожной сигнализации. Уставка срабатывания ключа позволяет установить верхнее и нижнее значените температуры, при которой срабатывает логический ключ. Его можно использовать для сигнализации повышения и понижения температуры, а так же, при подключении к твердотельному реле, для регулирования температуры объекта.

ПД-7



Настольное исполнение

Оптические элементы прибора выполнены из кварцевого стекла.

Оптоволоконный кабель отсоединяется от пирометра.

В случае контроля температуры в нескольких точках на объекте, можно пользоваться одним и тем же блоком обработки сигнала, поочередно соединяя его с оптическими головками, размещенными в нужных местах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПД-7-01	ПД-7-02
Диапазон измеряемых температур, °С	300...1000	500...2500
Спектральный диапазон, мкм	0,9...1,7	
Показатель визирования	1:150	
Номинальное рабочее расстояние, мм	1000±100	
Диапазон рабочих расстояний, м	0,5...10	
Вид индикации	ЖКИ, 10 разрядов, подсветка	
Разрешающая способность индикации, °С	0,01	
Основная погрешность, %, не более	0,5	
Время установления выходного сигнала, мс, не более	80	
Диапазон возможной установки коэффициента коррекции излучательной способности	0,100...1,500	
Дискретность установки коэффициента коррекции излучательной способности	0,001	
Связь с ЭВМ	RS-232	
Частота обновления данных на индикаторе, раз/с	5	
Температура эксплуатации оптической головки и оптоволоконного кабеля, °С	-20...+150 (кратковременно - до +200)	
Температура окружающей воздуха блока обработки сигнала, °С	5...50	
Выходы:		
- стандартный токовый перестраиваемый, мА	0 - 5, 0 - 20, 4 - 20	
- REG 1 (логический ключ)	5В, 20мА	
- REG 2 (логический ключ)	5В, 20мА	
Уставка тревожной сигнализации	звуковая, световая	
Степень защиты от пыли и воды	IP00	
Питание, В	24±0,5	
Потребляемая мощность, Вт, не более	9	
Габаритные размеры, мм, не более:		
- блока обработки сигналов	160x68x96,3	
- оптической головки	Ø24x70	
- кабеля оптоволоконного ДДШ6.649.000, мм (стандартное исполнение)	Ø6x2000	
Масса блока обработки сигналов, кг, не более	1	



**ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:**

Входящее в комплект поставки программное обеспечение Piro Visual, совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:

- идентифицировать пирометр;
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение температуры;
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности;
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параметров за допустимые значения;
- производить визуализацию измерений в виде графика в режиме реального времени;
- вести непрерывную запись текущих измеренных значений в файл на жестком диске компьютера;
- выводить графики или их фрагменты на принтер;
- изменять параметры цифрового фильтра ПД-7 и скорость измерений;
- настраивать токовый выход;
- проводить подстройку пирометра;
- и др.

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Пирометр ПД-7-XX», где XX - исполнение ПД-7

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

Наименование	Кол-во	Примечание
Пирометр оптоволоконный ПД-7	1 шт.	
Руководство по эксплуатации ДДШ2.820.014 РЭ	1 экз.	
Паспорт ДДШ2.820.014 ПС	1 экз.	
Методика поверки МП 2412-0008-2006	1 экз.	
Приемник ИК ДДШ5.869.003	1 шт.	
Кабель оптоволоконный ДДШ6.649.000*	1 шт.	
Кабель ДДШ6.644.090	1 шт.	Кабель интерфейсный
Кабель ДДШ6.644.120	1 шт.	Кабель токового выхода
Кабель ДДШ6.644.121	1 шт.	Кабель питания
Блок питания стабилизированный БПС 24-0.3 ДДШ2.087.006-01	1 шт.	По заявке потребителя
Программное обеспечение "Piro Visual" 643.02566540.00007 - 01	1 комплект	CD-диск
Кронштейн ДДШ6.133.051	1 шт.	

\* - по согласованию возможна поставка кабеля длиной 2, 5 или 10 метров.

**ПИРОМЕТРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ ОПТОВОЛОКОННЫЕ СЕРИИ ПД-10**

ТУ 4211-070-02566540-2006

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Пирометры серии ПД-10 разработаны для массового применения в металлургии, машиностроении, химической промышленности. Высокая степень защиты от электромагнитных помех позволяет использовать данный прибор для измерения температуры в индукционных печах.

С помощью пирометров данной серии возможно построение системы регулирования температуры по ПИД-закону.

**Краткое описание:**

Конструктивно и функционально пирометр ПД-10 полностью аналогичен пирометру ПД-7. Дополнительно пирометр комплектуется блоком сканирования силовой сети с оптоэлектронной развязкой. Выход управления нагрузкой предназначен для подключения к твердотельному реле, коммутирующему силовую цепь нагревателя. Твердотельное реле выбирается в зависимости от токов и напряжений нагрузки. Настройка параметров регулятора производится с ПЭВМ либо при помощи кнопок на лицевой панели прибора. Для задания коэффициентов ПИД-закона необходимы базовые знания теории регулирования.

ИСПОЛНЕНИЕ пирометра	Диапазон измерений, °С	Спектральный диапазон, мкм
ПД-10-01	300...1000	0,9...1,7
ПД-10-02	500...2500	0,9...1,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПД-10-01
Основная погрешность,	± 5 °С – в диапазоне 300...500 °С ± 1% – в диапазоне свыше 500 °С
Разрешающая способность, °С	0,01
Показатель визирования	1:150
Потребляемая мощность, Вт, не более	10
Температура окружающей среды, °С	5...50
Температура эксплуатации оптической головки оптоволоконного кабеля, °С	-20...150
Коррекция излучательной способности	0.1-1.5, шаг 0,001
Габаритные размеры:	
- измерительного блока пирометра, мм	160 x 68 x 96,3
- приемника оптического излучения, мм	Ø 24 x 70
- кабель ДДШ6.649.000, не более, мм	Ø 6 x 2000

ПД-10



**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

Наименование	Кол-во	Примечание
Пирометр ПД-10 ДДШ2.820.020	1 шт.	
Руководство по эксплуатации ДДШ2.820.020 РЭ	1 экз.	
Паспорт ДДШ2.820.020 ПС	1 экз.	
Кабель ДДШ6.649.000	1 шт.	Кабель оптоволоконный
Кабель ДДШ6.644.090	1 шт.	Кабель интерфейсный
Кабель ДДШ6.644.121	1 шт.	Кабель питания
Кабель ДДШ6.644.125	1 шт.	Кабель токового выхода
Приемник ИК-излучения ДДШ5.869.003	1 шт.	
Блок питания стабилизированный БПС-24-03 ДДШ2.087.006-01	1 шт.	По заявке потребителя
Блок гальванической развязки ДДШ5.109.031 ДДШ5.109.031-01	1 шт.	220В 380В
Программное обеспечение "Piro Visual"	1 комплект	CD-диск

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Пирометр ПД-10-XX»  
где XX - исполнение ПД-10



## ИК-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВЫХ СРЕД И РАСПЛАВОВ МЕТАЛЛОВ

### ИК-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СТАЦИОНАРНЫЕ ИКТС

ТУ 4211-070-02566540-2006

Различные варианты конструкции ИК-термопреобразователей защищены патентом РФ. Патент на полезную модель №113836.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

ИК-термопреобразователь стационарный (ИКТС) предназначен для измерения температуры воздушных и газообразных сред, расплавов цветных металлов в диапазоне 400...1400 °С (в зависимости от типа чехла).

ИКТС с чехлом из нержавеющей стали (рис.1) предназначен для измерения температуры различных сред, не вступающих или слабо вступающих во взаимодействие с арматурой, в диапазоне 400...1200 °С.

ИКТС с термопарным чехлом (рис.2) предназначен для измерения температуры цветных металлов (алюминий, медь и пр) в диапазоне 400...1250 °С. В зависимости от типа пирометра может отображать и имитировать различные виды токовых и термопарных сигналов.

ИКТС с чехлом из карбида кремния (рис.3) предназначен для измерения температуры в электрических и газовых печах в диапазоне 400...1400 °С. При использовании в комплекте с пирометром ПД-5 (см.таблицу 3) может быть использован в качестве прямой замены большинства типов термопар, т.к. данный пирометр позволяет имитировать сигналы стандартных термопар.

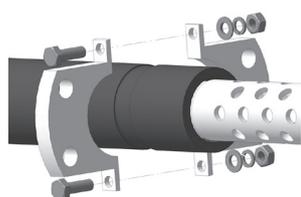


Рисунок 4  
Крепежные части (скобы, болты)  
Применяются для ИКТС  
с чехлом из карбида кремния  
(по рис.3)



Рисунок 1.

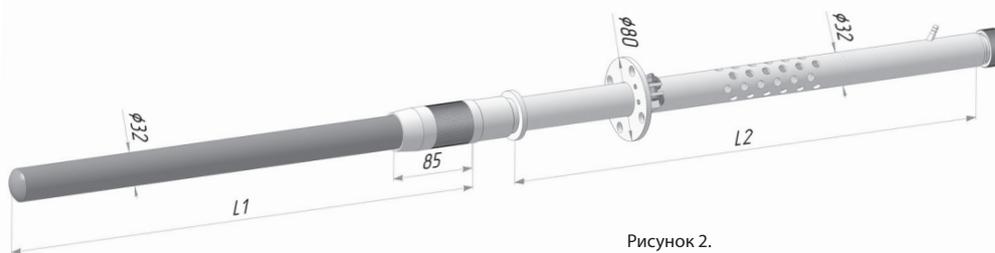


Рисунок 2.



Рисунок 3.

Таблица 1 – Материал и применение ИКТС

Рисунок	Материал чехла	Диапазон температур, °С	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Сталь 15Х25Т	400...1200	Неагрессивные воздушные и газообразные среды, неразрушающие арматуру
2	Термопарный чехол	400...1250	Расплав цветных металлов
3	Газоплотный карбид кремния	400...1400	Электрические и газовые печи, химически-агрессивные среды с высокой температурой

Таблица 2 - КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИК-термопреобразователя

Тип	КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ			
	Номер рисунка конструкции	Длина чехла L <sub>1</sub> , мм	Длина монтажной части (Сталь 12Х18Н10Т) L <sub>2</sub> , мм	Тип пирометра
ИКТС	1	490, 790, 990, 1240, 1590, 1990	200	ПД-5, ПД-6
	2	500	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	
	3	500, 600, 700, 800, 900, 1000	300	

#### ДОСТОИНСТВА ИК-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ:

- в случае износа замене подлежит только чехол, стоимость которого существенно ниже стоимости термоэлектрических датчиков, как платиновой группы, так и ХА типа;
- инерционность преобразователя существенно ниже традиционных датчиков, так как чехол пустой;
- при проведении очередной поверки нет необходимости демонтировать чехол, достаточно отсоединить приемник ИК-излучения от чехла, и поверить прибор непосредственно как пирометр. Это особенно важно, если, например, объект нежелательно разгерметизировать, внутри находятся ядовитые вещества и т.п.
- так как в преобразователе нет драгоценных металлов, он не представляет большого соблазна для хищения.
- в комплекте с пирометром ПД-5 может быть использован в качестве прямой замены большинства типов термопар, т.к. в пирометре ПД-5 реализована схема имитации термопарного выхода (см. ниже).



Пирометр ПД-5



Пирометр ПД-6



Настенное исполнение

Таблица 3 – Исполнения пирометра ПД-5

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	Температурный диапазон, °С	Тип выходных сигналов	Длина оптоволоконного кабеля, м
0.02	400...1400	токовый выход (или имитация термопары); RS-232	2
0.05			5
0.10			10
1.02		RS-232; ключ регулирования	2
1.05			5
1.10			10
2.02		токовый выход (или имитация термопары); ключ регулирования	2
2.05			5
2.10			10

Таблица 4 – Исполнения пирометра ПД-6

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	Температурный диапазон, °С	Длина оптоволоконного кабеля, м
300/1000-01	300...1000	1
300/1000-02		2
300/1000-05		5
400/1400-01	400...1400	1
400/1400-02		2
400/1400-05		5
500/2000-01	500...2000	1
500/2000-02		2
500/2000-05		5

В пирометре ПД-5 реализована схема имитации термопарного выхода. Температура, измеренная с помощью ИК-термопреобразователя, пересчитывается в значение термо-ЭДС для любого из 13 типов термопар, и напряжение соответствующей амплитуды выдается на контакты разъема. При замене штатной термопары на ИК-термопреобразователь нет необходимости заменять существующую систему контроля/регулирования, можно подключить пирометр к имеющемуся оборудованию.

Пирометры ПД-5, ПД-6 имеют ключ двухпозиционного регулирования, который может управлять внешним твердотельным реле. Таким образом можно осуществлять регулирование температуры или, например, отключить горелку котла при перегреве и т.п.

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

- "ИКТС - X - X - X - X - X МКСН.418456.005 ТУ";
  - Обозначение технических условий
  - КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ пирометра (см. таблицы 3, 4)
  - Тип пирометра (ПД-5 или ПД-6)
  - Длина монтажной части L<sub>2</sub>, мм (см. таблицу 2)
  - Длина чехла L<sub>1</sub>, мм (см. таблицу 2)
  - Номер рисунка конструкции (1...3)

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

- ИКТС -1-990-200-ПД-5-0.05 МКСН.418456.005 ТУ
- ИКТС -2-500-700-ПД-6-400/1400-02 МКСН.418456.005 ТУ

В случае заказа ИК-термопреобразователя без пирометра в соответствующих позициях поставить прочерк.





## ИК-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ ИКТП

МКСН.418456.008 РЭ

Различные варианты конструкции ИК-термопреобразователей защищены патентом РФ. Патент на полезную модель №113836.

## НАЗНАЧЕНИЕ

ИК-термопреобразователь переносной ИКТП (далее – ИК-термопреобразователь) предназначен для измерения температуры расплавов черных и цветных металлов с помощью чехла, погружаемого в расплав. ИК-термопреобразователь может использоваться взамен тер-моэлектрических преобразователей, работающих в диапазоне от 500 до 1700 °С.

ИК-термопреобразователь выпускается в конструктивных исполнениях, приведенных в таблице 1.

Таблица 1.

ИСПОЛНЕНИЕ	Материал чехла	НАЗНАЧЕНИЕ
ИКТП-1	Кварц	Измерение температуры расплавов черных металлов
ИКТП-2	Термопарный чехол	Измерение температуры расплавов цветных металлов
ИКТП-3	Кварц, керамика	Измерение температуры расплавов черных и цветных металлов

Таблица 2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИКТП
Диапазон измеряемых температур, °С	500 ... 1700
Пределы допускаемой основной погрешности, %	± 1,0
Напряжение питания, В	24 ± 0,5
Потребляемая мощность, Вт, не более	8
Время установления показаний с момента погружения в расплав металла, с, не более	
- кварцевого чехла	10
- керамического чехла	60
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У2
Устойчивость к вибрации (группа исполнения) по ГОСТ Р52931-2008	L1
Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96	IP42
Габаритные размеры ИК-термопреобразователя (зависят от длины чехла)	2300x1140
Длина L, мм:	
- кварцевого чехла D=20 мм	300
- керамического чехла D=32 мм	400
Масса ИК-термопреобразователя, кг, не более,	4,0
Средняя наработка до отказа, часов	15 000
Средний срок службы, лет	9

Таблица 3.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:	
Температура окружающей среды ИК-термопреобразователя, °С	- 30 ... +50
Относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды 35 °С, %, не более	95

## Устройство и работа ИК-термопреобразователя


Принцип действия ИК-термопреобразователя основан на зависимости энергетической яркости теплового излучения объекта от его температуры.

Излучательная способность расплавов металлов зависит от многих факторов: от марки металла, от наличия оксидной пленки на поверхности зеркала расплава, от температуры и т.д.

Для устранения вышеперечисленных факторов, влияющих на показания температуры, в расплаве металла с помощью специального чехла формируется полость с коэффициентом излучательной способности близкой к модели АЧТ. Это повышает точность измерений пирометрическим способом.

ИК-термопреобразователь переносной ИКТП

Рис. 1

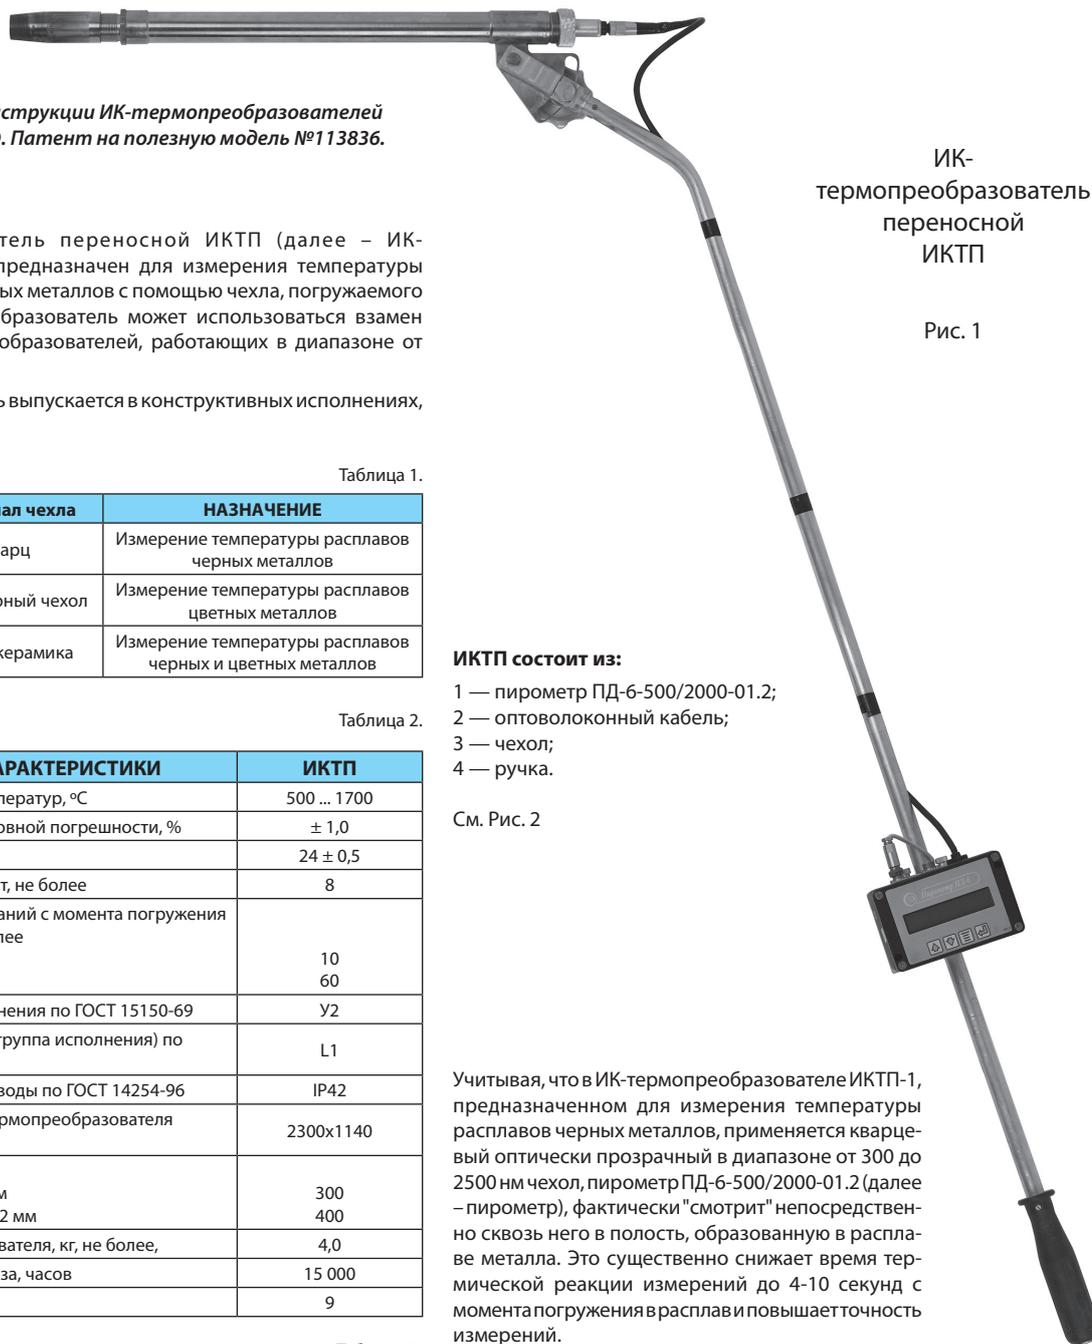

## ИКТП состоит из:

- 1 — пирометр ПД-6-500/2000-01.2;
- 2 — оптоволоконный кабель;
- 3 — чехол;
- 4 — ручка.

См. Рис. 2

Учитывая, что в ИК-термопреобразователе ИКТП-1, предназначенном для измерения температуры расплавов черных металлов, применяется кварцевый оптически прозрачный в диапазоне от 300 до 2500 нм чехол, пирометр ПД-6-500/2000-01.2 (далее – пирометр), фактически "смотрит" непосредственно сквозь него в полость, образованную в расплаве металла. Это существенно снижает время термической реакции измерений до 4-10 секунд с момента погружения в расплав и повышает точность измерений.

Для измерения температуры расплавов цветных металлов применяется ИК-термопреобразователь ИКТП-2 со специальным керамическим чехлом, который также погружается в расплав, образуя модель АЧТ, и пирометр "смотрит" непосредственно в дно чехла. Это существенно повышает точность измерений.

Поток излучения, поступающий от полости, сформированной чехлом, воспринимается линзовой оптической системой приемника ИК-излучения и направляется по оптоволоконному кабелю на датчик. Датчик преобразует энергию излучения в электрический сигнал. Сигнал с датчика усиливается и преобразуется в цифровой код. Цифровой код поступает в блок цифровой обработки, где происходит вычисление и индикация температуры объекта.

При измерении температуры расплавов металлов с помощью ИК-термопреобразователя на пирометре выставляется значение излучательной способности, равное 0,99.

Чехол погружается перпендикулярно зеркалу расплава металла на глубину (180±30) мм. Кварцевый чехол является одноразовым, чехлы из керамики применяются многократно.



Габаритный чертеж ИК-термопреобразователя переносного ИКТП

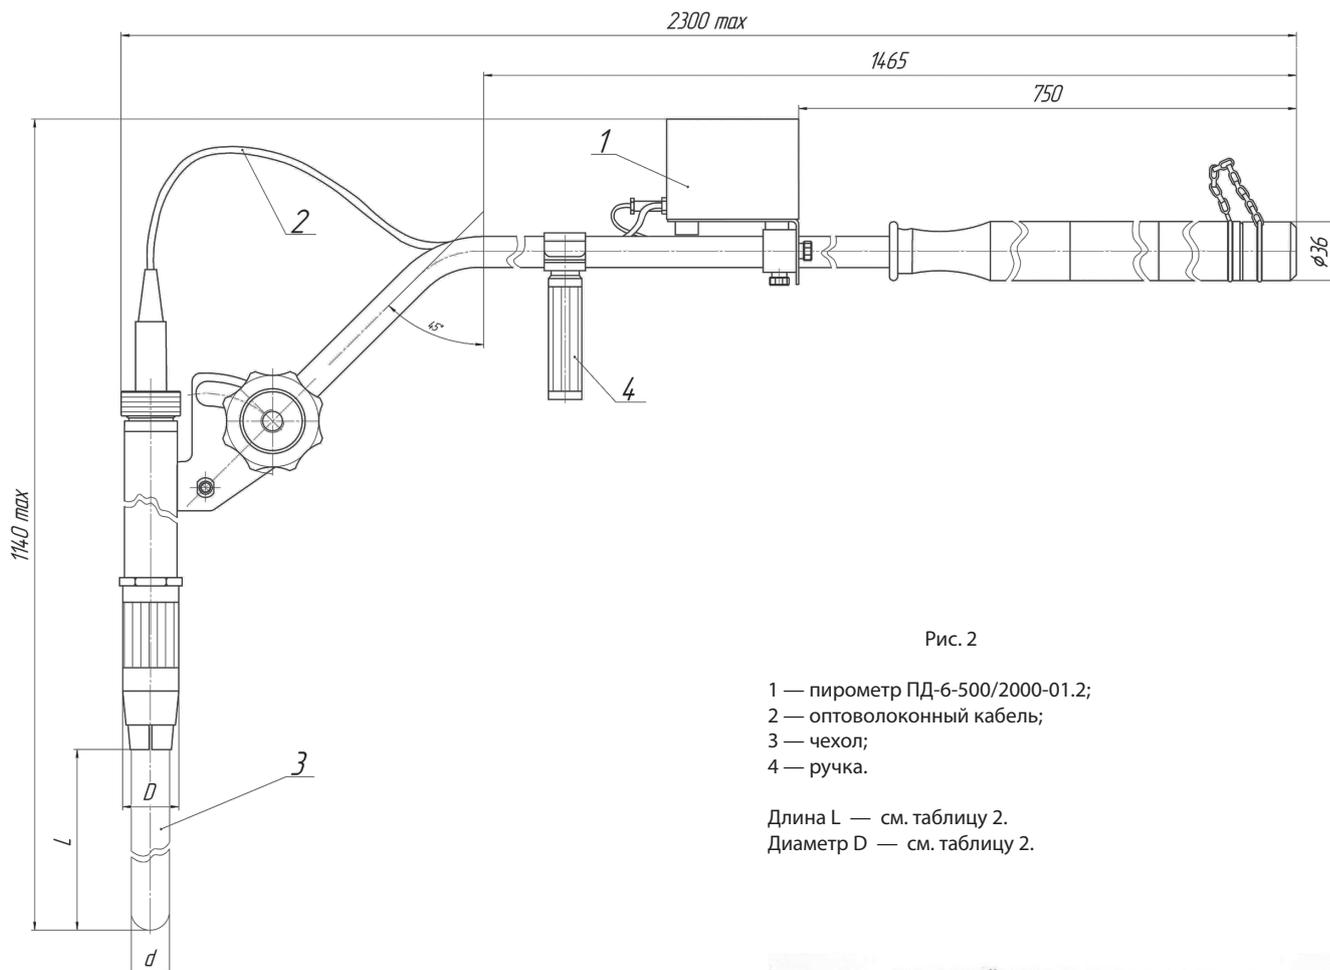


Рис. 2

- 1 — пирометр ПД-6-500/2000-01.2;
- 2 — оптоволоконный кабель;
- 3 — чехол;
- 4 — ручка.

Длина L — см. таблицу 2.  
Диаметр D — см. таблицу 2.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Таблица 4.

Наименование	Кол-во	Примечание
ИК-термопреобразователь ИКТП	1 шт.	
Руководство по эксплуатации МКСН.418456.008 РЭ	1 экз.	
Паспорт МКСН.418456.008 ПС	1 экз.	
Руководство по эксплуатации пирометра ПД-6 МКСН.405321.001 РЭ	1 экз.	
Паспорт пирометра ПД-6 МКСН.405321.001 ПС	1 экз.	
Кабель питания	1 шт.	
Блок питания БПС-24-0.3 ДДШ2.087.006-01	1 шт.	По заявке потребителя
Комплект сменных частей:	1 комплект*	
- чехол кварцевый	10 шт.	для ИКТП-1 и ИКТП-3
- чехол из специальной керамики	1 шт.	для ИКТП-2 и ИКТП-3
- цанга МКСН.723232.006-01	1 шт.	для ИКТП-3
- гайка МКСН.714341.002-01	1 шт.	для ИКТП-3
* Допускается поставка с ИК-термопреобразователем дополнительных комплектов или их частей по заявке потребителя		

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ  
"ИКТП-2 МКСН.418456.008 РЭ"









# МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Перечень средств передачи единицы температуры для организации контактной термометрической лаборатории (криостаты, термостаты, термостаты, печи, калибраторы температуры)

Параметры	Криостаты			Термостаты					Печи					Калибраторы		Печи реперных точек				
	КР -190	КР -80	КР -40-2	ТН-1М; ТН-2М; ТН-3М	ТП-2	ТР 20	ТР-1М	ТПВ-2М, ТПВ-3 (поверхностный)	ТС 600-2	МТП-2МР	МТП 1200-4	ВТП 1600-1	ВТП 1800-1	ПШ 1200	КС 100-1	КС 600-1	ПРТ 50-700	ПРТ 600-1100		
Диапазон воспроизведения температуры, °С	-190...-60	-80...+40	-40...+40	0	95...101,5	15...30	40...200; 150...260; 40...300	40...300; -40...+40	50...600	100...1200	100...1200	300...1600	600...1780	100...1200	-10...+100	50...600	50...700	600...1100		
Максимальная глубина погружения датчика, мм	505	300	300	480; 460; 195	500	-	300; 500	-	160	250; 500	250	300	420	200	180	160	450	585		
Длина равномерного температурного поля, мм	60	290	100	-	-	-	100; 200	Ø 70	80	±25 от центра	±60 от центра	50	50	80	40	40	300	300		
Неравномерность температуры в рабочем объеме термостата, °С	0,1	0,01 в диапазоне -60...+40	0,02 на 10 см	±0,01 для ТН-3М не нормируется	±0,03	0,02	0,02; 0,03; 0,04 на 10 см	0,1	0,1	0,1	1	1	0,2	0,1	0,1	0,6	1	1		
Нестабильность поддержания температуры, °С, не более	±0,05 за 30 минут	±0,02 за 30 минут	±0,02 за 30 минут	-	±0,03 за 30 минут	±0,05 за 30 минут	±(0,02+3*10 <sup>-4</sup> )	± 0,3	±0,05 за 30 минут	0,1 за одну минуту	±0,4 за одну минуту	±0,4 за одну минуту	±0,1 за одну минуту	±(0,02+1*10 <sup>-4</sup>  t )	±0,3 за 30 мин.	±0,3 за 30 мин.	±0,3 за 30 мин.	±0,3 за 30 мин.		
Время выхода на режим, мин, не более	90	150	240	30	60	180	120; 150	120; 240	45	90	240	240	240	120	45	-	-	-	-	
Потребляемая мощность, кВт, не более	0,1	4,5	3,0	-	1,25	0,4	3,0	-	3	5; 8	4,5	2,5	3,5	4; 8	0,2	3	4	4	4	
Количество поверяемых датчиков	4	6	6	13	13	до 10	6	до 3	3	зависит от диаметра поверяемых датчиков			7	3	4	1	1	1	1	
Теплоноситель	жидкий азот	спирт	тосол А40-М	тающий лед	водяной пар	трансформаторное масло	ПМС-100, МЦ-52, ULTRA 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ампула	-	-
Габаритные размеры, мм	Ø225x592	950x510x1300	500x510x1350	500x500x950; 260x280x750; 255x255x2270	260x400x980	790x480x580	256x280x746; 256x280x946	120x190x190	155x195x375	730x200x350; 350; 1230x200x350	730x210x350; 310x370x460; 270x360x100	700x300x400	456x456x800; 310x370x460; 270x360x100	Ø500x560	450x250x450	415x230x815	840x370x460	450x360x100	450x450x840; 310x370x460; 270x360x100	



## ЭТАЛОННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАТИНОРОДИЙ-ПЛАТИНОВЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ППО



**ТУ 50-104-2000**

Тип средства измерения зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под №1442-00 ППО - лауреат конкурса "Сто лучших товаров России".

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Преобразователи термоэлектрические платиноводий-платиновые ППО предназначены для использования в качестве средств поверки при аттестации термоэлектрических термометров в воздушной или нейтральной среде в диапазоне температур 300...1200 °С в лабораторных условиях.

Для ППО 1-го разряда диапазон температур 300...1100 °С.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- основные технические характеристики - в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52314-2005;
- вероятность безотказной работы не менее 0,90 за 500 часов при температуре 1100 °С;
- средний срок службы - не менее 6 лет.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- термопреобразователь - 1 шт.;
- футляр из пенопласта - 1 шт.;
- трубка армирующая запасная - 1 шт.;
- пробирка стеклянная - 2 шт.;
- паспорт - 1 шт.


**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- свидетельство о поверке;
- деревянный или кожаный футляр

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

**«Термопреобразователь ППО-1-1250-01»**

ППО, 1-го разряда, длина термоэлектродов 1250 мм, конструктивное исполнение 01

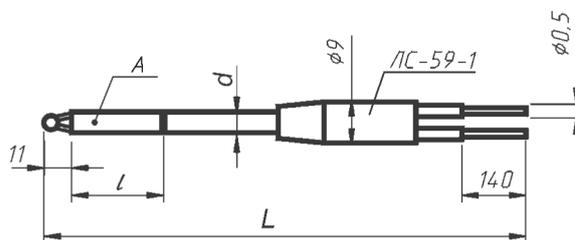


ППО



Тип	Разряд	Длина L, мм	КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	l, мм	d, мм	Масса, г	Марка материала трубки А
для печи МТП-2МР-50-500 (с длиной рабочего пространства 500 мм)							
ППО	1, 2, 3	1000	00	290	4,0	50,02	Керамика С 799
		1250	01			52,48	
		1600	02			56,21	
для печей МТП-2МР-50-500 и МТП-2МР-70-1000 (с длинами рабочего пространства 500 и 1000 мм)							
ППО	1, 2, 3	1250	03	530	4,0	57,52	Керамика С 799
		1600	04			68,61	



Футляр для ППО, ПРО (кожа, дерево)

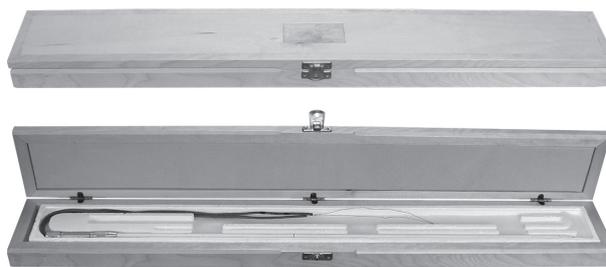

Футляр для ППО, ПРО (дерево)



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАТИНОРОДИЕВЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ПРО**



**ДДШ 2.821.027 ТУ**

**ПРО зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под №41201-09. Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.32.001.А №36008.**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Преобразователи термоэлектрические платинородиевые ПРО предназначены для использования в качестве средств поверки при аттестации термоэлектрических термометров в воздушной или нейтральной среде в диапазоне температур 600...1800°C в лабораторных условиях.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- основные технические характеристики- в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52314-2005;
- вероятность безотказной работы не менее 0,9 за 80 часов при температуре 1600 °С;
- средний срок службы - не менее 6 лет.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- термопреобразователь - 1 шт.;
- футляр из пенопласта- 1 шт.;
- трубка армирующая запасная - 1 шт.;
- пробирка стеклянная - 2 шт.;
- паспорт ДДШ 2.821.027ПС - 1 шт.


**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- свидетельство о поверке;
- деревянный или кожаный футляр

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

**«Термопреобразователь ПРО-2-1600-02»**

ПРО, 2-го разряда, длина термоэлектродов 1600мм, конструктивное исполнение 02

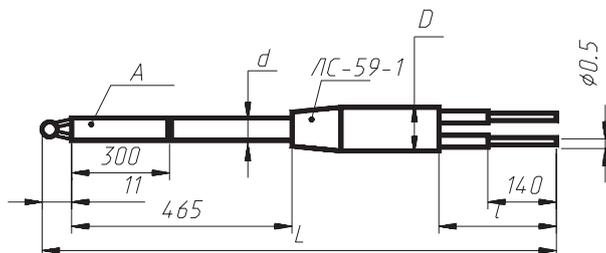

ПРО



Тип	Разряд	Размеры, мм				КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Масса, кг	Марка материала трубки А
		d	D	l	L			
ПРО	1, 2, 3	4,7	9	695	1250	01	0,063	TRA-116316
				1045	1600	02	0,083	OMEGATITE 350
		4,0		695	1250	07	0,064	сапфировый
				1045	1600	08	0,084	стержень



**ЭТАЛОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСП 0307**



**ДДШ2.822.198 ТУ**

ТСП 0307 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 73884-19.  
Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.32.007.А № 72704.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Термометры сопротивления эталонные 3-го разряда ТСП 0307-02 предназначены для поверки рабочих средств измерений, а также для точных измерений температуры в диапазонах температур, °С:

- от минус 196 до 0;
- от 0 до 419,527;
- от 0 до 660,323.


**ОПИСАНИЕ:**

Принцип действия термометров основан на использовании зависимости электрического сопротивления платины от температуры.


Основной частью термометров является чувствительный элемент, состоящий из платиновой проволоки, спирально уложенной в четырехканальную керамическую трубку.

Термометры имеют четыре вывода – два токовых и два потенциальных, измерение сопротивления термометров осуществляется по четырехпроводной схеме.

По устойчивости к климатическим воздействиям термометры сопротивления эталонные соответствуют виду климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

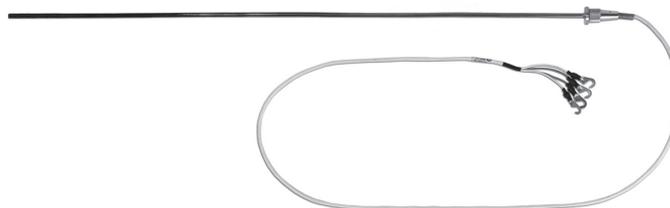

ТСП 0307

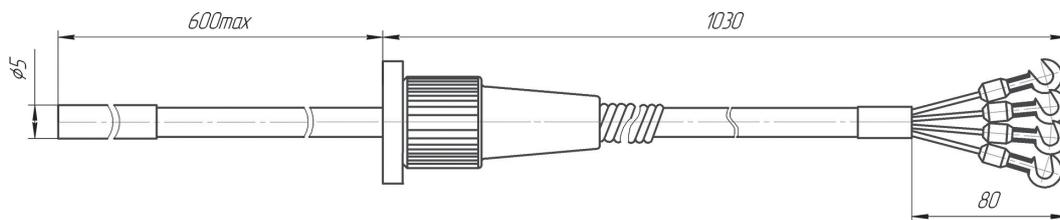

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТСП 0307		
Диапазон измерений температуры, °С	от -196 до +0,01	от +0,01 до +419,527	от +0,01 до +660,323
Номинальное сопротивление при 0 °С, Ом	100±0,5		
Разряд термометров	3		
Нестабильность термометров в тройной точке воды после отжига при температуре на 10°С выше предела измерений, °С, не более	0,01		
Пределы допускаемой доверительной абсолютной погрешности при доверительной вероятности 0,95, °С при температуре, °С:			
в точке кипения азота -196	±0,05		
в тройной точке воды 0,01	±0,02		
в точке плавления галлия 29,7646	±0,02		
в точке затвердевания индия 156,5985	±0,04		
в точке затвердевания олова 231,928	±0,04		
в точке затвердевания цинка 419,527	±0,07		
в точке затвердевания алюминия 660,323	±0,15		
Электрическое сопротивление изоляции между выводами и корпусом термометров при температуре окружающей среды (20±5) °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80 %, МОм, не менее	100		
Габаритные размеры, мм, не более:			
- диаметр защитной арматуры	5		
- длина	600		
Длина погружаемой части, мм, не менее	150		
Масса, г, не более:	150		
Условия эксплуатации:			
- температура окружающей среды, °С	20,0 ± 5,0		
- относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80		
- атмосферное давление, кПа	100 ± 4		
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	35 000		
Средний срок службы, лет	6		

КОМПЛЕКТНОСТЬ:	Кол-во
Термометр сопротивления эталонный 3-го разряда ТСП 0307-02	1 шт.
Футляр	1 шт.
Методика поверки	1 экз.
Паспорт	1 экз.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Термометр сопротивления эталонный 3-го разряда ТСП 0307-02 (диапазон измеряемых температур ХХХХ, °С) ДДШ2.822.198 ТУ»



**ЭТАЛОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭТС-100М1, ЭТС-100М3 3-ГО РАЗРЯДА**




**ТУ 4211-014-0125106998-2018**

Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.001.A №69589  
Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 70903-18

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Термометры сопротивления эталонные ЭТС-100М исполнения ЭТС-100М1 и ЭТС-100М3, 3-го разряда, предназначены для поверки рабочих средств измерения температуры, а также для точных измерений температуры в диапазоне от минус 196 до 660,323 °С согласно поверочной схеме ГОСТ 8.558-2009.

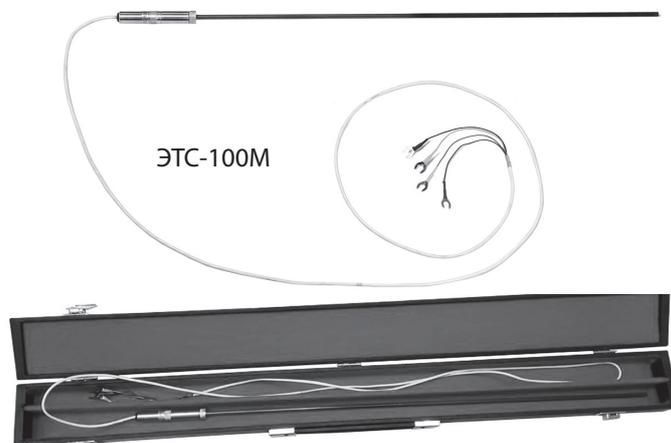

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЭТС-100М1	ЭТС-100М3
Диапазон измеряемых температур, °С	от минус 196 до 660,323	от минус 196 до 419,527
Разряд	3	
Номинальное сопротивление при 0 °С, Ом	100 ± 0,5	
Нестабильность термометров в температурном эквиваленте в тройной точке воды после отжига при температуре на 10 °С выше верхнего предела измерений, °С, не более	0,01	
Отношение $W_{100}$ сопротивления термометров при температуре 100 °С к их сопротивлению в тройной точке воды, не менее	1,3910	
Пределы допускаемой доверительной абсолютной погрешности при доверительной вероятности 0,95, °С, при температуре:		
от минус 196 °С	±0,05	
0,01 °С	±0,02	
231,928 °С	±0,04	
419,527 °С	±0,07	
660,323 °С	±0,15	
Электрическое сопротивление изоляции между выводами и корпусом термометров при температуре окружающей среды (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (60 ± 15) %, МОм, не менее	100	
Размеры термометров:		
- внешний диаметр защитной трубки, мм, не более	5,0	
- длина погружаемой части термометра, мм, не менее	500	
- диаметр головки термометра, мм, не более	20	
Габаритные размеры термометра:		
- диаметр, мм, не более	20	
- длина, мм, не более	670	
- длина внешних соединительных проводов, мм, не менее	1500	
Минимальная глубина погружения, мм, не менее	150	
Масса, г, не более	100	
Условия эксплуатации:		
- температура окружающей среды, °С	20,0 ± 2,0	
- относительная влажность воздуха, %	60 ± 15	
- атмосферное давление, кПа	100 ± 4	
Вероятность безотказной работы за 1000 ч или 50 циклов охлаждения-нагрев от максимальной температуры до (20,0 ± 5,0) °С при доверительной вероятности 0,8 не менее	0,9	
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4	
Средний срок службы, лет	5	
Схема соединений	4-х проводная	
Гарантийный срок эксплуатации термометра со дня продажи при наработке, не превышающей 1000 ч или 50 циклов охлаждения-нагрев	24 месяца	
Ресурс работы термометров между двумя последовательными поверками, часов	1000	

КОМПЛЕКТНОСТЬ:	Кол-во
Термометр сопротивления эталонный ЭТС-100М1 или ЭТС-100М3	1 шт.
Футляр	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Методика поверки	1 экз.
Паспорт	1 экз.

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- свидетельство о поверке - 1 шт.;
- деревянный пенал или кожаный футляр

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

Термометр сопротивления эталонный ЭТС-100М1



## УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЕРКИ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

### УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЕРКИ И ГРАДУИРОВКИ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ УПСТ-2М



ТУ 50-96 ДДШ 1.270.003 ТУ

УПСТ-2М зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений под №16173-02  
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.051.A № 13369/1

Установка обеспечивает одновременную поверку и градуировку 8 преобразователей термоэлектрических и 10 термометров сопротивления.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Установка УПСТ-2М используется в органах Государственной метрологической службы и в метрологических лабораториях юридических лиц и представляет собой единый метрологический комплекс.

Установка УПСТ-2М предназначена:

- для поверки (калибровки) и градуировки эталонных термоэлектрических преобразователей 2-го и 3-го разрядов и рабочих термоэлектрических преобразователей всех типов в диапазоне температур от 0 до 1200 °С двумя методами (прямого и поэлектродного сличения) в соответствии с ГОСТ 8.338-2002, МИ 1744-87;
- для поверки (калибровки) и градуировки термометров сопротивления в диапазоне температур от 0 до 1200°С в соответствии с ГОСТ 8.461-2009.

**Установка УПСТ-2М полностью заменяет серийно выпускаемые установки УПСТ-1, УПСТ-2 и УТТ-6 и обладает следующими преимуществами:**

- возможностью поверки и градуировки термопреобразователей двумя методами-прямого и поэлектродного сличения,
- возможностью поверки и градуировки образцовых термопреобразователей,
- меньшими по сравнению с УТТ-6 и УПСТ-2 габаритными размерами и массой блока управления,
- универсальностью (блочно-модульная конструкция дает возможность поставки в различной комплектации),
- каждое изделие, входящее в состав УПСТ-2М, может поставляться самостоятельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	УПСТ-2М
Диапазон воспроизводимых температур, °С	в пределах 0...1200, зависит от термостатов и печей, входящих в состав конкретной УПСТ-2М
Применяемый прецизионный измеритель напряжения	измеритель В7-99*
Количество одновременно поверяемых (калибруемых, градуируемых) датчиков, шт.: - преобразователей термоэлектрических; - термометров сопротивления.	до 8 до 10
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1
Температура окружающего воздуха, °С	20±5
Питание	~ 220 В; 50 Гц
Габаритные размеры, масса и потребляемая мощность термостатов, печей, измерителя В7-99 и других составных частей УПСТ-2М – смотрите соответствующее ОПИСАНИЕ в разделе "МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"	
* при необходимости вместо В7-99 может использоваться любой тип вольтметра постоянного тока класса точности не хуже 0,01 на пределе измерения 100 мВ и с разрешающей способностью не более 1 мкВ	


В качестве устройств воспроизведения температур в УПСТ-2М используются термостаты и печи. Поставляемые в составе термостатов (кроме нулевого и парового) и печей регуляторы температуры обеспечивают независимое задание и автоматическое поддержание заданных температурных режимов в печах или термостатах, что создает удобство при эксплуатации.

В качестве измерительного прибора используется измеритель В7-99.

**При использовании В7-99 с программой автоматизации УПСТ поверка термоэлектрических преобразователей по ГОСТ 8.338-2002 проводится в полуавтоматическом режиме. Программа автоматизации УПСТ формирует протокол поверки.**

#### ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПСТ (для В7-99):

Программа руководит действиями пользователя по коммутации входов БИ-1, снимает показания с измерителя В7-99, накапливает данные измерений при проведении поверки и формирует протокол поверки, сохраняя результаты в базе данных для последующего просмотра.

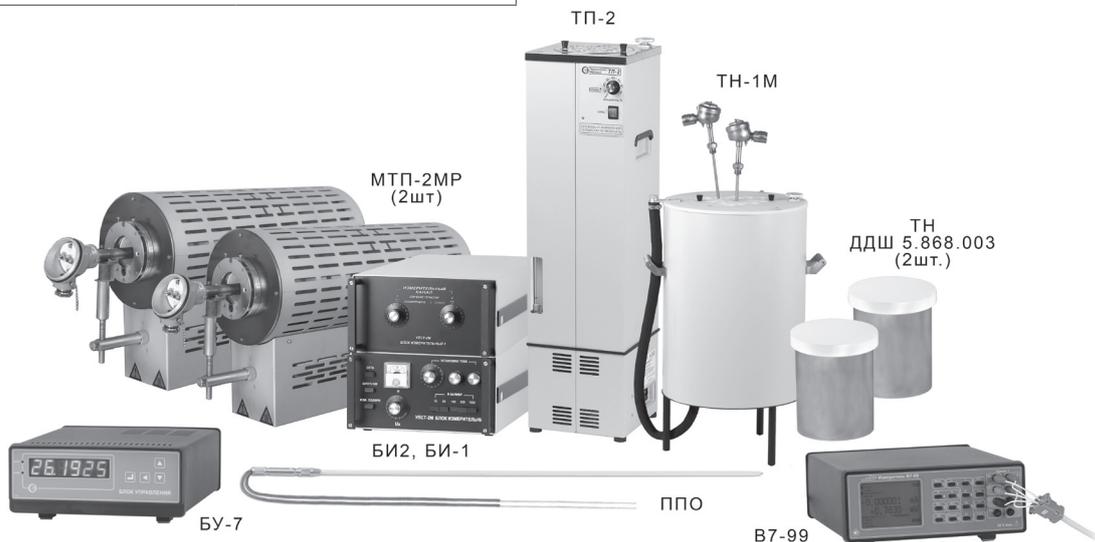



Наряду с прецизионным милливольтметром, печами и термостатами основными элементами УПСТ-2М являются блоки измерительные БИ-1 и БИ-2.

Блок измерительный БИ-1 предназначен для коммутации измерительных цепей при поверке и градуировке преобразователей термоэлектрических.

Блок измерительный БИ-2 предназначен для регулирования тока и коммутации измерительных цепей при поверке и градуировке термометров сопротивления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БИ-1	БИ-2
Вид климатического исполнения по ГОСТ15150-69	УХЛ4.1	
Температура окружающего воздуха, °С	20±5	
Питание	не требует	~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	-	10
Габаритные размеры, мм, не более	242x132x470	
Масса, кг, не более	5	6,5

**КОМПЛЕКТНОСТЬ УПСТ-2М:**

Наименование оборудования	кол-во	примечания
Блок измерительный 1 (БИ-1)	1	При работе с преобразователями термоэлектрическими
Блок измерительный 2 (БИ-2)	1	При работе с термопреобразователями сопротивления
Универсальный измеритель В7-99 *	1	Диапазон измеряемых напряжений постоянного тока -300...+300 мВ
Термостат нулевой ТН-1М	1	Диапазон воспроизводимых температур 0 °С
Термостат паровой ТП-2	1	Диапазон воспроизводимых температур 100 °С
Печь МТП-2МР-50-500	2	Диапазон воспроизводимых температур +100...+1200 °С
Преобразователь термоэлектрический эталонный ППО-2-1000	1	Диапазон измеряемых температур 300...1200 °С 2 разряда, длиной 1000
Термостат нулевой ДДШ 5.868.003	2	Для компенсации холодных концов
Документация	1 к-т	

**Поставляется по дополнительной заявке (при необходимости)\*\* для расширения возможностей УПСТ-2М**

Печь МТП-2МР-70-1000	Диапазон воспроизводимых температур +100...+1200 °С
Преобразователь термоэлектрический эталонный ППО	Диапазон измеряемых температур 300...1200 °С 1, 2, 3 разряда Длиной 1000, 1250, 1600 мм.
Криостат КР -190-1, КР -40-2	Диапазон воспроизводимых температур -190...- 60 °С -40...+40 °С
Термостат регулируемый ТР-1М-300, ТР-1М-500, ТР-1М-В, ТР-1М-У1, ТР-1М-У2	Диапазон воспроизводимых температур +40...+200 °С +150...+300 °С +40...+300 °С
Высокотемпературная печь ВТП 1600	Диапазон воспроизводимых температур +300...+1600 °С
Преобразователь термоэлектрический эталонный ПРО	Диапазон измеряемых температур 600...1800 °С 1, 2, 3 разряда Длиной 1250, 1600 мм.
Эталонный термометр сопротивления ЭТС-100	Диапазон измеряемых температур -196...0 °С или 0...+660 °С
Устройство для дробления льда УДЛ-2	
Выравнивающий блок для печи МТП-2МР-50-500, длина 140 мм. Конструктивное исполнение -00 (рис.1) Конструктивное исполнение -01 (рис.2) Конструктивное исполнение -02 (рис.3)	с одним отверстием для ППО с отверстиями для ППО и поверяемых датчиков типа стакана

\* Возможно использовать измеритель В7-99 с расширенными функциями ППО.  
\*\* см. соответствующие ОПИСАНИЕ в разделе "МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"

Для уменьшения перепада (градиента) температуры в рабочей зоне печь МТП-2МР-50-500 может использоваться совместно с никелевыми выравнивающими блоками. Предприятие может поставлять выравнивающие блоки, изготовленные по эскизу потребителя, либо блоки-заготовки, в которых потребитель может самостоятельно высверливать отверстия под конкретные датчики температуры. См. раздел **ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ.**

**Блоки выравнивающие**


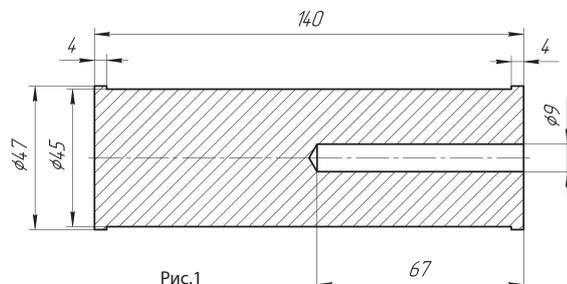


Рис.1

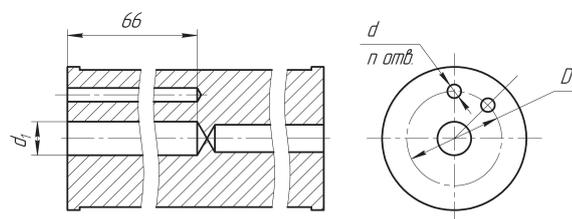

Устанавливает потребитель при заказе:

- размеры (d, d<sub>1</sub>),
- взаимное расположение (D),
- количество отверстий (n) -

Рис.2  
Остальное - см. рис.1

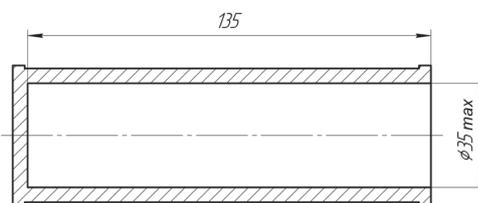


Рис.3  
Остальное - см. рис.1

**Блок выравнивающий для печи МТП-2МР-70-1000** имеет длину 80 мм. и изготавливается в одном исполнении типа стакана МКШ.715131.014 (рис.4)

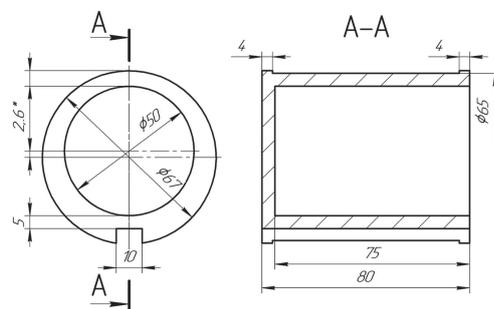


Рис.4 Блок выравнивающий МКШ.715131.014

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

"Установка УПСТ-2М в комплекте:

- блоки измерительные БИ-1, БИ-2,
- измеритель В7-99,
- термостат нулевой ТН-1М,
- термостат паровой ТП-2,
- печь МТП-2МР-50-500 - 2 шт.,
- термостат нулевой ДДШ 5.868.003 - 2 шт."





## АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПОВЕРКИ ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ АРМ ПТС



ТУ 50-00 ДДШ 1.270.004 ТУ

Тип средства измерения зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под №22190-01

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Установка для поверки термопреобразователей сопротивления АРМ ПТС предназначена для проведения автоматизированной поверки и градуировки термопреобразователей сопротивления (ТС) в соответствии с ГОСТ 8.461-2009 и комплектов ТС, предназначенных для измерения разности температур.

### ФУНКЦИИ АРМ ПТС:

- управление режимом работы измерительного коммутатора, ко входу которого подключаются поверяемые датчики температуры и образцовый термометр сопротивления;
- управление режимом работы регулируемого термостата (в составе рабочего места может работать до трех регулируемых термостатов);
- поверка ТС с НСХ преобразования Pt10, 10П, 10М, Pt50, 50П, 50М, Pt100, 100П, 100М, Pt500, 500П, Pt1000, 1000П по двух-, трех- и четырехпроводным схемам подключения по ГОСТ 6651-2009;
- поверка комплектов ТС, предназначенных для измерения разности температур;
- градуировка ТС;
- просмотр результатов предыдущих поверок;
- проведение метрологического обслуживания АРМ с формированием соответствующих протоколов;
- обеспечение доступа к подробному файлу справки, содержащему текстовую и графическую информацию в объеме, достаточном для обучения неподготовленного пользователя работе с АРМ ПТС.

При проведении поверки (градуировки) в нескольких температурных точках достаточно указать значения этих точек или границы температурного диапазона и шаг перестройки по температуре (остальная часть поверочных работ выполняется установкой автоматически, без участия поверителя).

### КОМПЛЕКТНОСТЬ АРМ ПТС:

Наименование	Обозначение	Кол-во
Коммутатор измерительный <sup>1)</sup>	КИ 9901	1 шт.
Термостат нулевой <sup>2), 4)</sup>	ТН-1М ТУ50-95 ДДШ2.998.004ТУ	1 шт.
Термостат паровой <sup>2), 4)</sup>	ТП-2 ТУ 3443-003-02566540-2003	1 шт.
Термостат регулируемый <sup>2), 4), 5)</sup>	ТР-1М ТУ50-96 ДДШ2.998.006ТУ	1 шт.
Комплект ЗИП <sup>1)</sup>	Согласно ведомости ЗИП ДДШ1.270.004ЗИ	1
Компьютер <sup>2), 3)</sup>	IBM PC 486 и выше	1 шт.
Принтер <sup>3)</sup>		1 шт.
Эталонный термометр сопротивления <sup>2), 3)</sup>	ЭТС-100 ХД2.821.066	1 шт.
Удлинитель сетевой <sup>3)</sup>		1 шт.
Программное обеспечение <sup>1)</sup>	ДДШ1.270.004 ПО	1
Руководство по эксплуатации <sup>1)</sup>	ДДШ1.270.004 РЭ	1 экз.
Методика поверки <sup>1)</sup>	МП 37-221-01	1 экз.
Паспорт <sup>1)</sup>	ДДШ1.270.004 ПС	1 экз.

- 1) – входит в минимальный КОМПЛЕКТНОСТЬ;  
 2) – наличие в составе установки обязательно;  
 3) – наличие в комплекте поставки установки определяется заказчиком;  
 4) – номенклатура и количество термостатов определяется заказчиком;  
 5) – теплоноситель ПМС-100 поставляется ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ потребителя.

Примечание: допускается замена термостатов другими средствами воспроизведения температуры с характеристиками не хуже заданных.



АРМ ПТС представляет собой блочно-модульный метрологический комплекс, состоящий из отдельных изделий, объединенных измерительным коммутатором КИ9901 и управляемый с помощью персонального компьютера. Установка АРМ ПТС работает под управлением программного обеспечения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРМ ПТС
Диапазон температур, в котором возможно проведение поверки и калибровки	определяется диапазоном температур, воспроизведение которых обеспечивают используемые термостаты
Типы поверяемых датчиков	медные и платиновые термометры сопротивления с R <sub>0</sub> не более 1000 Ом
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения сопротивления, %	0,01
Пределы допускаемого среднего квадратического отклонения (СКО) случайной составляющей погрешности, %, не более	0,001
Типы поверяемых датчиков по ГОСТ 6651-2009	Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, 10П, 10М, 50П, 50М, 100П, 100М, 500П, 1000П
Количество одновременно поверяемых датчиков, шт.	до 10
Классы поверяемых датчиков по ГОСТ Р 8.625-2006	АА, А, В, С
Схема подключения датчиков	2-х, 3-х, 4-х проводная
Время измерения по одному каналу, с	5 ... 16
Время установления рабочего режима, ч, не более	2, определяется временем выхода термостата на заданный режим
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1
Температура окружающего воздуха, °С	20±5
Питание	~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность КИ9901*, Вт	15
Габаритные размеры КИ9901 (без клеммной панели)*, мм, не более	270x110x355
Масса КИ9901*, кг, не более	4

\* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ термостатов, криостатов и др. составных частей АРМ ПТС – см. ОПИСАНИЕ в разделе "МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

- «АРМ ПТС в комплекте:
- обязательный комплект поставки,
  - термостат нулевой ТН-2М - 1 шт.;
  - термостат паровой ТП-2 - 1 шт.»



## ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ

### ИЗМЕРИТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ В7-99



Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 37935-08.  
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.005.A № 31858/1  
**ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ** за разработку и производство импортозамещающего, универсального, высокоточного измерителя В7-99 на 11-ом Московском Международном форуме «MetroExpo-2015»



V7-99

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Измерители универсальные прецизионные В7-99 предназначены для высокоточного измерения и статистической обработки значений сигналов термоэлектрических преобразователей (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585 и с индивидуальной градуировочной характеристикой, сигналов термометров сопротивления (ТС) по ГОСТ Р 8.625-2006 и с индивидуальной градуировочной характеристикой, а также значений напряжения, силы постоянного тока и сопротивления.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** – различные отрасли промышленности.

Измерения производятся по двум независимым каналам с возможностью вычисления разности значений в случае измерения по двум каналам однородных величин.

Прибор выполнен в виде настольного переносного прибора с ЖКИ индикатором, клавиатурой из 16 кнопок и группой гнезд для подключения измерительных кабелей, на контакты которых подаются измеряемые сигналы. Все режимы и параметры работы прибора задаются пользователем в диалоговом режиме работы с кнопками по ЖКИ индикатору. Измеритель может работать под управлением персонального компьютера. Управление осуществляется по интерфейсу RS-232.

- 2 независимых канала измерения
- Измерение напряжения, сопротивления, силы тока, сигналов термопар, сигналов термометров сопротивления
- Жидкокристаллический индикатор с подсветкой
- Математические функции
- Автоматическая компенсация температуры холодных концов при измерении сигналов термоэлектрических преобразователей
- Термостатированный аналого-цифровой преобразователь для высокоточных измерений

#### Внешний вид


#### Лицевая панель



#### Задняя панель



#### Выводимые на индикатор символы и значения

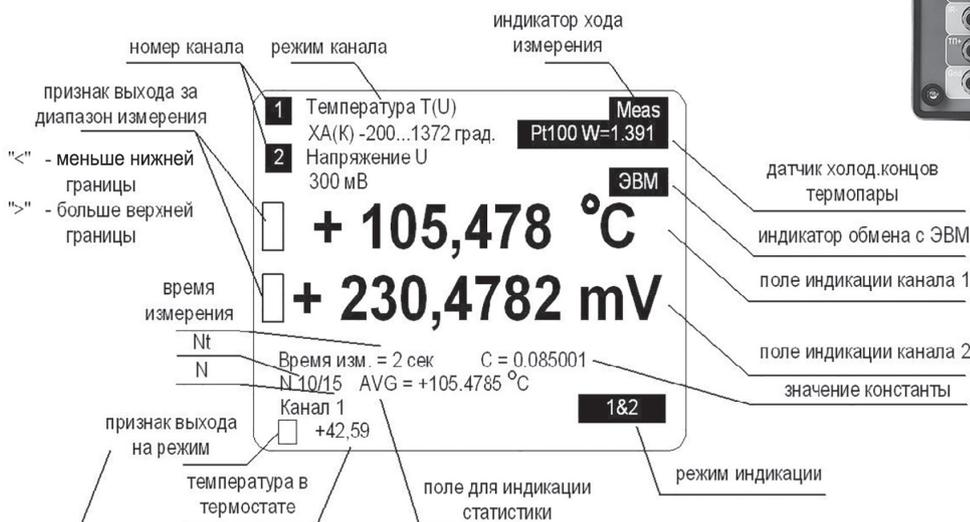

T < - прибор не прогрет; T = - прибор готов к работе; T > - прибор перегрет



Метрологические ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение напряжения постоянного тока

Диапазон	Цена единицы наименьшего разряда	Максимальное значение отсчета	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности <sup>[1]</sup>	Входное сопротивление
±300 мВ	0,0001 мВ (100 нВ)	303, 0000 мВ	$\pm(1,5 \cdot 10^{-3} + 4,5 \cdot 10^{-5} \cdot  U )$ мВ	500,0 МОм

[1] U - измеренное напряжение, мВ

Измерение силы постоянного тока

Измерение силы тока доступно только для канала 1.

Диапазон	Цена единицы наименьшего разряда	Максимальное значение отсчета	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности <sup>[1]</sup>	Входное сопротивление
±3 мА	0,000001 мА (1 нА)	3, 030000 мА	$\pm(0,3 + 0,45 \cdot  I ) \cdot 10^{-3}$ мА	150 Ом
±30 мА	0,00001 мА (10 нА)	30, 30000 мА	$\pm(3 + 0,45 \cdot  I ) \cdot 10^{-3}$ мА	20 Ом

[1] I - измеренный ток, мА

Прибор обеспечивает расчет линейной функции для унифицированных токовых сигналов (4..20, 0..5) мА:  $Y = a \cdot (I - X_{min}) + b$ , где a, b - коэффициенты, вводимые пользователем. Это позволяет производить пересчет измеренного значения тока непосредственно в значение измеряемой величины.

Измерение сопротивления

Диапазон	Цена единицы наименьшего разряда	Максимальное значение отсчета	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности <sup>[1]</sup>
(0..30) Ом	0,00001 Ом (10 мкОм)	30, 30000 Ом	$\pm(0,0005 + 0,00025 \cdot  R-10 )$ Ом
(0..300) Ом	0,0001 Ом (100 мкОм)	303, 0000 Ом	$\pm(0,005 + 0,00025 \cdot  R-100 )$ Ом
(0..3000) Ом	0,001 Ом (1 мОм)	3030, 000 Ом	$\pm(0,05 + 0,00025 \cdot  R-1000 )$ Ом

[1] R - измеренное сопротивление, Ом

Измерение сигналов термоэлектрического преобразователя

Тип термоэлектрического преобразователя	Диапазон измеряемых температур	Цена единицы наименьшего разряда	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности
ППО (2, 3 разряда)	(+300..+1200) °С	0,001 °С	±2 °С
ПП(S)	(-50..+1768) °С		
ПР(B)	(-250..+1820) °С		
ВР(A-1)	(0..+2500) °С		±1,5 °С
ЖК(J)	(-210..+1200) °С		±0,2 °С
ХА(K)	(-200..+1372) °С		
НН(N)	(-200..+1300) °С		
ХК(L)	(-200..+800) °С		

- Прибор обеспечивает возможность ввода, хранения и изменения наборов коэффициентов индивидуальных градуировок для преобразователей термоэлектрических типа ППО
- Прибор обеспечивает расчет значений напряжения образцовых термоэлектрических преобразователей типа ППО в точках  $t = 100 \cdot n$  °С при  $n = 3..12$  согласно МИ 1744-87 по введенным значениям ЭДС в 3-х реперных точках
- Прибор обеспечивает компенсацию температуры свободных (холодных) концов термоэлектрического преобразователя при помощи внешнего термометра сопротивления 100П (например, с использованием компенсационной коробки КК-2, входящей в КОМПЛЕКТНОСТЬ).

Измерение сигналов термометров сопротивления

Тип термометра сопротивления	Диапазон измеряемых температур	Цена единицы наименьшего разряда	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности <sup>[1]</sup>
R0 = 10, 50, 100 Ом	[2]	0,001 °С	$\pm(0,015 + 0,00025 \cdot  t )$ °С
50M, 100M	(-50..+200) °С		
50П, 100П	(-200..+750) °С		
Pt50, Pt100	(-200..+750) °С		

[1] t - измеренная температура, °С  
[2] диапазон зависит от индивидуальной ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ конкретного ТС

- Прибор обеспечивает возможность ввода, хранения и изменения наборов коэффициентов индивидуальных градуировок для термометров сопротивления.
- Прибор обеспечивает расчет значений температуры образцового термометра сопротивления по значению сопротивления, вводимого пользователем.

Математические функции

- вычисление разности однородных величин, измеренных по каналам 1 и 2
- вычисление разности между измеряемой величиной по каналу 1 и константой, вводимой пользователем
- выполнение статистической обработки и расчета величин для канала 1:
  - среднего арифметического
  - среднеквадратического отклонения
  - минимального значения
  - максимального значения
  - разницы между максимальным и минимальным значениями




**СЕРВИСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ В7-99**

Программное обеспечение входит в КОМПЛЕКТНОСТЬ.

**ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ:**

- установка и отображение настроек и режима работы прибора;
- чтение измеренных прибором значений, отображение их в табличном и графическом виде;
- сохранение данных в файл и чтение данных из файла для отображения и анализа;
- расчет статистических показателей в режиме реального времени и по сохраненным данным.

Подключение к прибору осуществляется через последовательный коммуникационный порт RS-232 посредством интерфейсного кабеля, входящего в КОМПЛЕКТНОСТЬ прибора.

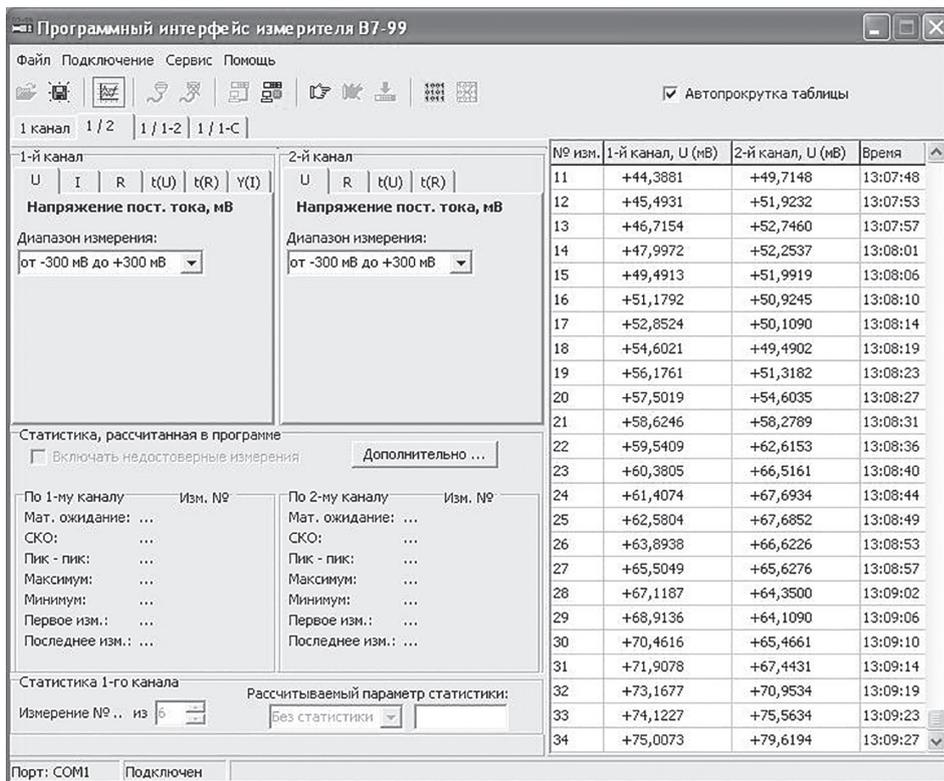

**ОСНОВНОЕ ОКНО**

**Основное меню** содержит пункты для выбора требуемых действий программы.

**Панель инструментов** содержит кнопки, дублирующие наиболее часто используемые пункты основного меню программы, и служит для быстрого выбора требуемого действия.

**Область отображения и установки режима** прибора содержит элементы, связанные с режимом индикации прибора (вкладки режима индикации) и режимами измерения каналов прибора (панели режима каналов).

**Таблица результатов** измерений отображает измеренные значения по каждому каналу прибора.

**Панель статистики**, рассчитываемой программой, отображает текущие статистические показатели результатов измерений, рассчитанные для каждого канала прибора.

**Строка состояния** программы отображает состояние подключения и сообщения программы при возникновении ошибок.

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОКНО**

Окно "График" отображает результаты измерений в виде графика для каждого канала.

Ось Y графика соответствует измеряемой величине, ось X представляет время измерения.


Линия графика рисуется зеленым цветом; при выходе измеренного значения за пределы диапазона измерения, отрезок линии перед этим измерением рисуется красным цветом.

Управление графиком как с помощью мыши, так и с помощью клавиатуры.

При установленном флажке "В границах данных" перемещение в каком-либо направлении возможно до крайнего значения измеренной величины.

При установленном флажке "Автосдвиг по X" появление нового измерения вызывает сдвиг графика влево по оси времени.

Кнопка "Настроить" открывает окно настройки параметров графика.

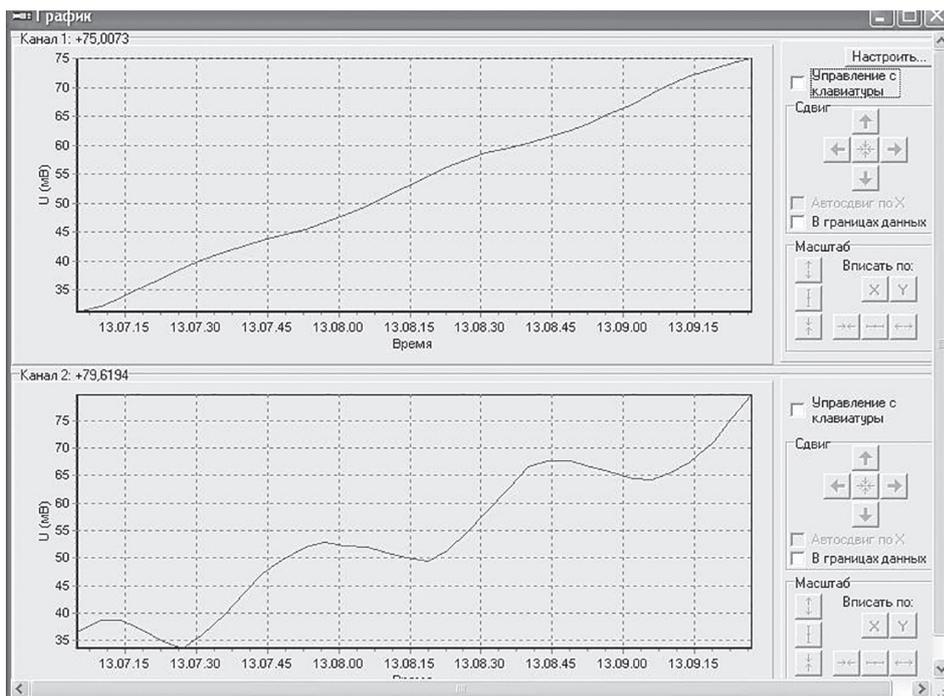



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	В7-99
Питание	(220±22) В, (50±1) Гц
Потребляемая мощность, ВА	25
Рабочая температура применения, °С	+10 .... +50
Интерфейс	RS-232
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	250x115x370
Масса, кг	5
Гарантийный срок	1 год
Интервал между поверками	1 год
Время установления рабочего режима	Не более 2 часов

КОМПЛЕКТНОСТЬ	Кол-во
В7-99	1 шт.
формуляр ДДШ.2.728.002 ФО	1 шт.
руководство по эксплуатации ДДШ.2.728.002 РЭ	1 шт.
программное обеспечение 643.02566540.00002-01	1 комп.
методика поверки ДДШ 2.728.002 МП	1 шт.
кабель сетевой SCZ-1	1 шт.
кабель интерфейсный ДДШ 6.644.033	1 шт.
кабель измерительный ДДШ 6.644.069	2 шт.
кабель измерительный ДДШ 6.644.072	2 шт.
перемычка ДДШ.6.644.047	10 шт.
коробка компенсационная КК-2 МКСН.405544.025	2 шт.

#### Принадлежности



кабель измерительный  
ДДШ 6.644.069



кабель измерительный  
ДДШ 6.644.072



коробка компенсационная  
КК-2 МКСН.405544.025



кабель  
интерфейсный  
ДДШ 6.644.033

#### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

“Измеритель универсальный прецизионный В7-99  
ТУ 4381-075-02566540-2007 ”

# КРИОСТАТЫ, ТЕРМОСТАТЫ, ПЕЧИ

## КРИОСТАТ КР -190

ТУ 3443-007-02566540-2003

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Криостат регулируемый КР -190 предназначен для охлаждения средств измерения температуры при их поверке и исследовании в лабораторных условиях.

Криостат имеет два исполнения, отличающиеся количеством и диаметрами колодцев для установки исследуемых средств измерения температуры: КР -190-1 и КР -190-2.

Криостат состоит из термостабилизирующего блока (БТС-1 или БТС-2) и блока управления БУ-7-9. Термостабилизирующий блок представляет собой цилиндрический медный блок с высверленными колодцами. Для работы криостата необходимо помещать термостабилизирующий блок в криогенный сосуд марки СК-25, заполненный жидким азотом.

КР -190-1 (КР -190-2)



Криогенный  
сосуд СК-25



Блок термостабилизирующий  
БТС-1 (БТС-2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КР -190-1	КР -190-2
Диапазон воспроизводимых температур, °С	-190...-60	
Используемый термостабилизирующий блок	БТС-1	БТС-2
Диаметры и количество колодцев для установки средств измерения:		
- колодцы Ø 4,5 мм, шт.	1	3
- колодцы Ø 5,5 мм, шт.	-	6
- колодцы Ø 6,5 мм, шт.	-	2
- колодцы Ø 8,5 мм, шт.	2	-
- колодцы Ø 10 мм, шт.	2	-
- колодцы Ø 13,5 мм, шт.	1	-
Глубина колодцев термостабилизирующего блока, мм, не менее	505	
Минимальная длина датчика, погружаемого в криостат, мм	485	
Вертикальный градиент температуры в рабочей зоне (60 мм от дна колодцев термостабилизирующего блока), °С/см, не более	0,1	
Нестабильность поддержания температуры за 30 мин, °С, не более	±0,05	
Время выхода на температурный режим (термостабилизирующий блок помещен в криогенный сосуд и имеет температуру ниже -190 °С), ч, не более	1,5	
Вид индикации	цифровая светодиодная	
Разрешающая способность индикации, °С		
- в диапазоне -60,00...-99,99 °С	0,001	
- в диапазоне -100,0...-190,0 °С	0,01	
Дискретность задания требуемой температуры, °С	0,01	
Связь с ЭВМ	RS-232	
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1	
Температура окружающего воздуха, °С	20±5	
Питание	~ 220 В; 50 Гц	
Потребляемая мощность, Вт, не более	100	
Габаритные размеры, мм, не более		
- блока термостабилизирующего БТС-1 (БТС-2)	Ø225x592	
- блока управления БУ-7-9	270x360x100	
Масса, кг, не более:		
- блока термостабилизирующего БТС-1(БТС-2) без массы криогенного сосуда и жидкого азота	4	
- блока управления БУ-7-9	5	



БУ-7-9

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- блок термостабилизирующий (БТС-1 для КР -190-1 или БТС-2 для КР -190-2);
- блок управления БУ-7-9;
- сосуд криогенный СК-25 ТУ 26-04-622-88;
- кабели соединительные (4 шт.);
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.

### ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:

- образцовый термометр сопротивления платиновый низкотемпературный ТСПН-4В второго разряда;
- программное обеспечение 643.02566540.00019-01.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

При одновременном заказе КР -190-1 и КР -190-2 криостат комплектуется двумя термостабилизирующими блоками (БТС-1 и БТС-2), остальные позиции комплекта поставляются, как при заказе одного из исполнений криостата.

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Криостат регулируемый КР -190-1»



**ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КРИОСТАТ КР -80**

**МКСН.702232.001 ТУ**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Криостат КР -80 предназначен для нагрева и охлаждения датчиков температуры (термопар и термометров сопротивления), ртутных, спиртовых и др.термометров при поверке и градуировке в лабораторных условиях.

В качестве теплоносителя используется этиловый спирт.

Криостат выполнен в металлическом корпусе, внутри которого расположен резервуар. В резервуар заливается теплоноситель (около 10 кг) — спирт этиловый ректификованный. Внутри резервуара находится цилиндр, в котором организован термостатированный объем. Для улучшения характеристик криостата теплоноситель в резервуаре непрерывно перемешивается. В термостатированном объеме теплоноситель движется снизу вверх. Уровень теплоносителя считается нормальным, если теплоноситель переливается через верхний край насадки. Разница уровней теплоносителя внутри насадки и снаружи при перемешивании не должна превышать 40 мм.

КР -80 имеет защиту: при утечке фреона не включается.

В КР -80 предусмотрена система поддержания уровня теплоносителя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КР-80
Диапазон воспроизведения температур, °С	-80...+40
Теплоноситель	спирт
Одновременно поверяется:	
- термопар или термометров сопротивления	6
- ртутных, спиртовых термометров	до 13
Рабочий объем криостата, мм, не менее	Ø110x300
Максимальная глубина погружения датчика, мм	300
Неравномерность температуры в рабочем объеме криостата на глубине от 10 до 300 мм, °С	
- в диапазоне от -80 до 60,01°С, не более	0,03
- в диапазоне от -60 до +40°С, не более	0,01
Нестабильность заданной температуры за 30 мин, °С, не более	±0,02
Время выхода на температурный режим, ч, не более	2,5
Вид индикации	цифровая светодиодная
Разрешающая способность индикации, °С	0,01
Дискретность задания требуемой температуры, °С	0,01
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4.1
Связь с ЭВМ	RS-232
Температура окружающего воздуха, °С	20±5
Питание	220В; 50Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более	4,5
Габаритные размеры, мм, не более	950x510x1300
Масса криостата без теплоносителя, кг	160

КОМПЛЕКТНОСТЬ:	Кол-во
Криостат регулируемый КР -80	1 шт
Кабель ХТ1 ДДШ6.644.004	1 шт
Кабель ДДШ6.644.033	1 шт
Спирт этиловый	15 кг
Сертификат соответствия на спирт	1 экз
Кассета ДДШ6.212.004	1 шт
Плата ДДШ 6.670.002	1 шт
Насадка МКСН.713111.002	1 шт
Насадка МКСН.713111.003	1 шт
Заглушки с отверстиями под датчики диаметром:	
4 мм (МКСН.716111.003-01)	7 шт
6 мм (МКСН.716111.003-02)	7 шт
8 мм (МКСН.716111.003-03)	7 шт
10 мм (МКСН.716111.003-04)	7 шт
Заглушка без отверстия МКСН.716111.003	7 шт
Пассик ДДШ 8.844.001	1 шт
Руководство по эксплуатации МКСН. 702232.001 РЭ	1 экз
Паспорт МКСН. 702232.001 ПС	1 экз
Крышка МКСН 301251.005	1 шт

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- Программное обеспечение 643.02566540.00019-01

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Криостат регулируемый КР -80»

**КРИОСТАТ КР -40-2**



**ТУ 3443-002-02566540-2003**

*КР -40-2 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 26147-09. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.051.A № 35435*

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Криостат КР -40-2 предназначен для поверки и исследования средств измерения температуры в лабораторных условиях.

В качестве теплоносителя используется тосол марки А40-М ТУ6-15-1701-92.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КР -40-2
Диапазон воспроизводимых температур, °С	-40...+40
Теплоноситель	тосол А40-М
Одновременно поверяется:	
- термомпар или термометров сопротивления	до 6
- ртутных, спиртовых термометров	до 13
Максимальная глубина погружения датчика, мм	300
Неравномерность температуры в рабочем объеме криостата, °С, не более	0,02
Нестабильность поддержания температуры за 30 мин, °С, не более	±0,02
Время выхода на температурный режим, ч, не более	4
Вид индикации	цифровая светодиодная
Разрешающая способность индикации, °С	0,01
Дискретность задания требуемой температуры, °С	0,01
Связь с ЭВМ	RS-232
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1
Температура окружающего воздуха, °С	20±5
Питание	~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более	3
Габаритные размеры, мм, не более	500x510x1350
Масса криостата без теплоносителя, кг, не более	95

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- криостат КР-40-2 с крышкой с 7 отверстиями;
- теплоноситель тосол А40-М (15 кг) с сертификатом соответствия;
- набор заглушек (пробок) с отверстиями под датчики диаметром: 10 мм; 8 мм; 6 мм; 4 мм; без отверстий, - (по 7 каждого вида);
- кассета\* для поверки стеклянных термометров диаметром 6...18 мм;
- плата для подключения датчиков при поверке;
- кабель питания;
- кабель для связи с компьютером;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки.

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- программное обеспечение 643.02566540.00001-02;
- эталонный термометр сопротивления ЭТС-100 с градуировкой в положительном диапазоне температур;
- эталонный термометр сопротивления ЭТС-100 с градуировкой в отрицательном диапазоне температур;
- устройство ТПВ-3 для поверки поверхностных датчиков температур.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Криостат регулируемый КР -40-2»

«Криостат регулируемый КР -40-2 с эталонным термометром сопротивления ЭТС-100»





**ТЕРМОСТАТЫ НУЛЕВЫЕ ТН-1М, ТН-2М, ТН-3М**

**ТУ 50-95 ДДШ 2.998.004 ТУ** (для ТН-1М и ТН-2М)

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Термостаты нулевые ТН-1М и ТН-2М предназначены для создания точки 0°С при поверке и градуировке термометров в лабораторных и цеховых условиях.

Термостат ТН-3М предназначен для термостатирования свободных концов термопар.

Термостат нулевой ТН-1М является аналогом термостата, изготавливаемого Акмолинским заводом «Эталон»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТН-1М	ТН-2М	ТН-3М
Номинальная температура термостатируемой среды в рабочей камере, °С	0		
Рабочая среда	тающий лед		
Количество поверяемых датчиков, шт.	до 13		
Номинальный объем рабочей камеры, м³	0,0236	0,0114	0,0049
Максимальная глубина камеры, мм	480	460	195
Неравномерность температуры в рабочем объеме термостата, °С, не более	±0,01		-
Время выхода на температурный режим, ч, не более	0,5		
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У4.2	У3	-
Температура окружающего воздуха, °С	25±10		
Питание	-		
Габаритные размеры, мм, не более	500x500x950	260x280x750	255x255x270
Масса, кг, не более	20	11	5,5



ТН-1М

ТН-2М

ТН-3М

**КОМПЛЕКТНОСТЬ ТН-1М, ТН-2М:**

- термостат нулевой ТН-1М (ТН-2М);
- комплект ЗИП (плата для подключения датчиков, пробирки диаметром от 8 мм до 29 мм, втулки, заглушки);
- паспорт;
- руководство по эксплуатации (только для ТН-2М);
- ведомость ЗИП.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ ТН-3М:**

- термостат нулевой ТН-3М;
- набор пробирок (12 шт.);
- паспорт.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Термостат нулевой ТН-1М»

**ТЕРМОСТАТ ПАРОВОЙ ТП-2**



**ТУ 3443-003-02566540-2003**

ТП-2 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 25916-03  
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.051.A № 16299

Декларация ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.74908/22 от 22.08.22 о соответствии требованиям  
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Термостат паровой ТП-2 предназначен для поверки термопреобразователей сопротивления при температуре кипения воды в лабораторных условиях.

Термостат ТП-2 полностью взаимозаменяет термостат ТП-1М, производимый ранее на нашем предприятии (тогда - Омский опытный завод «Эталон»). По сравнению с ТП-1М он имеет меньшие массогабаритные показатели и улучшенную систему аварийного отключения при выкипании воды. Введение в ТП-2 регулирования мощности и внешнего радиатора позволило достичь меньших расхода воды и выхода пара в окружающее помещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТП-2
Номинальная температура термостатируемой среды в рабочей камере, °С	95...101,5 при атмосферном давлении 84-106,7 кПа
Рабочая среда	водяной пар
Количество поверяемых датчиков, шт.	до 13
Объем заправляемой воды, л	3
Максимальная глубина камеры, мм	500
Неравномерность температуры в рабочем объеме термостата, °С, не более	0,03
Нестабильность поддержания температуры в рабочей камере за 30 мин, °С, не более	±0,03
Время выхода на температурный режим, ч, не более	1,0
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1
Температура окружающего воздуха, °С	20±5
Питание	~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более:	1,25
Габаритные размеры, мм, не более	260x400x980
Масса без воды, кг, не более	20



ТП-2

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- термостат паровой ТП-2;
- плата для подключения датчиков;
- пробирки d=8 мм (7 шт.), d=15 мм (7 шт.), d=23 мм (8 шт.), d=29 мм (8 шт.);
- втулки с отверстиями диаметром d=8 мм (6 шт.), d=15 мм (6 шт.), d=23 мм (7 шт.), d=29 мм (7 шт.);
- заглушки (13 шт.);
- кабель сетевой;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ :**

«Термостат паровой ТП-2»



**ТЕРМОСТАТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ TP 20**

ТУ 3443-014-02566540-2004

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Термостат регулируемый TP 20 предназначен для термостатирования комплекта эталонных катушек электрического сопротивления типа P310, P321, P331 и нормальных элементов типа X482 в лабораторных условиях.

В качестве теплоносителя используется трансформаторное масло, удовлетворяющее требованиям ГОСТ 982-80.

Термостат позволяет с помощью переключателя из всех подключенных выбрать требуемую катушку электрического сопротивления или нормальный элемент, при этом ток подается на клеммы "I<sub>N</sub>+" и "I<sub>N</sub>-", а напряжение измеряется на клеммах "U<sub>N</sub>+" и "U<sub>N</sub>-".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TP 20
Диапазон воспроизводимых температур, °С	15*...30
Теплоноситель	трансформаторное масло, 30 л
Одновременно термостатируется катушек или нормальных элементов, шт.	до 10
Допускаемая абсолютная погрешность воспроизведения заданной температуры за 30 минут, °С, не более:	
- для заданной температуры 20 °С	±0,05
- для остального диапазона температур	±0,2
Перепад температуры между двумя любыми точками в рабочей камере, °С, не более	0,02
Скорость нагрева, °С/ч, не менее	10
Скорость охлаждения (в зависимости от температуры окружающей среды), °С/ч	0,5...2,5
Вид индикации	цифровая светодиодная
Разрешающая способность индикации, °С	0,01
Дискретность задания требуемой температуры, °С	0,01
Связь с ЭВМ	RS-232
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1
Температура окружающего воздуха, °С	20±5
Питание	~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более	0,4
Габаритные размеры, мм, не более	790x480x580
Масса термостата без теплоносителя, кг	60
* при окружающей температуре 20 °С.	

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- термостат регулируемый TP 20;
- теплоноситель - трансформаторное масло, удовлетворяющее требованиям ГОСТ 982-80, (30 л);
- пластина для герметизации;
- кабель питания;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- программное обеспечение 643.02566540.00001-01;
- кабель для связи с ПК.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Термостат регулируемый TP 20»

**ТЕРМОСТАТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ TP-1M**



ТУ 3443-001-02566540-2002

Сертификат об утверждении типа средств измерений ОС.С.32.051.А №33998/1; зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 24473-08

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Термостат регулируемый TP-1M предназначен для поверки и исследования средств измерения температуры в лабораторных условиях в диапазоне температур от 40 до 300 °С.

Выпускаются пять исполнений термостата, отличающиеся глубиной погружения и диапазоном воспроизводимых температур: TP-1M-300, TP-1M-500, TP-1M-B, TP-1M-Y1 и TP-1M-Y2. Достоинством данного термостата является микропроцессорное управление, позволяющее получать высокую стабильность поддержания температуры и малую дискретность задания температуры. Термостат подключается к компьютеру по интерфейсу RS-232.

Исполнения термостатов регулируемых TP-1M-300 и TP-1M-500 воспроизводят температуру в диапазоне от 40 до 200 °С, при этом во всем диапазоне в качестве теплоносителя используется полиметилсилоксановая жидкость ПМС-100 ГОСТ 13032-77 с температурой вспышки не ниже 305 °С. При работе в диапазоне от 40 до 95 °С в качестве теплоносителя допускается использовать воду.

Исполнение термостата регулируемого TP-1M-B воспроизводит температуру в диапазоне от 150 до 300 °С, при этом во всем диапазоне в качестве теплоносителя используется масло цилиндрическое МЦ-52 ГОСТ 6411-76 с температурой вспышки не ниже 310 °С.

С целью реализации диапазона 40...300°С при использовании одного теплоносителя выпускаются исполнения TP-1M-Y1 и TP-1M-Y2. В качестве теплоносителя в них используется теплоноситель с температурой воспламенения не менее 340 °С, которое имеет малый коэффициент вязкости во всем диапазоне температур от 40 до 300 °С, является прозрачным и меньше испаряется при 300 °С.

Термостат регулируемый TP-1M состоит из термованны (ТЖ-1-300 или ТЖ-1-500) и блока управления (БУ-7-5).

TP-1M



БУ-7-5

ТЖ-1-300  
(ТЖ-1-500)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТР-1М-300	ТР-1М-500	ТР-1М-В	ТР-1М-У1	ТР-1М-У2
Диапазон воспроизводимых температур, °С	40...200		150...300	40...300	
Теплоноситель:					
- во всем диапазоне воспроизводимых температур	ПМС-100 (13 кг)	ПМС-100 (20 кг)	МЦ-52 (13 кг)	ULTRA 300 (12,5 л)	ULTRA 300 (20 л)
- в диапазоне 40...95 °С	вода		-		
Используемая термованна	ТЖ-1-300	ТЖ-1-500	ТЖ-1-300		ТЖ-1-500
Используемый блок управления	БУ-7-5				
Используемая камера вытяжная	КВ-1		КВ-1В		
Одновременно поверяется:					
- терморпар или термометров сопротивления			до 6		
- ртутных, спиртовых термометров	до 13		-	до 13	
Максимальная глубина погружения датчика, мм	300	500	300		500
Неравномерность температуры в рабочем объеме термостата, °С, не более	0,02+3·10 <sup>-5</sup> ·t				
Нестабильность поддержания температурного режима за 30 мин, °С, не более	±(0,02+3·10 <sup>-5</sup> ·t)				
Время выхода на температурный режим, ч, не более	2		2,5	2	
Вид индикации	цифровая светодиодная, 6 разрядов (высота цифр 14 мм)				
Разрешающая способность индикации, °С					
- в диапазоне 100,0...300,0	0,001				
- в диапазоне 0...99,99	0,0001				
Дискретность задания требуемой температуры, °С	0,01				
Связь с ЭВМ	RS-232				
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1				
Температура окружающего воздуха, °С	20±5				
Питание	~ 220 В; 50 Гц				
Потребляемая мощность, кВт, не более	3				
Габаритные размеры, мм, не более:					
- термованны	256x280x746	256x280x946	256x280x746		256x280x946
- блока управления	270x360x100				
- вытяжной камеры	500x500x2000		500x500x2500		
Масса, кг, не более:					
- термованны (без теплоносителя)	20	30	20		30
- блока управления	4,5				
- вытяжной камеры	45		50		

**КОМПЛЕКТНОСТЬ ТР-1М-300, ТР-1М-500:**

- термованна (ТЖ-1-300 для ТР-1М-300 и ТЖ-1-500 для ТР-1М-500);
- жидкость ПМС-100 (13 кг для ТР-1М-300 и 20 кг для ТР-1М-500);
- блок управления БУ-7-5;
- поддон, черпак, кружка;
- плата для подключения датчиков;
- набор заглушек (пробок) с отверстиями под датчики диаметром: 10 мм; 8 мм; 6 мм; 4 мм; без отверстий, - (по 7 каждого вида);
- кассета\* для поверки стеклянных термометров диаметром 6...18 мм;
- набор кабелей соединительных (3 шт.);
- кабель для связи с компьютером;
- паспорт; руководство по эксплуатации;
- методика поверки;
- программное обеспечение 643.02566540.00019-01.

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- камера вытяжная КВ-1\* с паспортом;
- эталонный термометр сопротивления ЭТС-100;
- устройство ТПВ-2М\* для поверки поверхностных датчиков температур (устанавливается на ТР-1М-300, ТР-1М-500);
- охладитель;

\* - Доп. см. "Вспомогательное оборудование для поверки датчиков температуры"

**КОМПЛЕКТНОСТЬ ТР-1М-У1 и ТР-1М-У2:**

- термованна (ТЖ-1-300 для ТР-1М-У1 и ТЖ-1-500 для ТР-1М-У2);
- теплоноситель (12,5 л для ТР-1М-У1 и 20 л для ТР-1М-У2);
- блок управления БУ-7-5;
- камера вытяжная КВ-1В\* с паспортом;
- плата для подключения датчиков;
- набор заглушек (пробок) с отверстиями под датчики диаметром: 10 мм; 8 мм; 6 мм; 4 мм; без отверстий, - (по 7 каждого вида);
- кассета\* для поверки стеклянных термометров диаметром 6...18 мм;
- набор кабелей соединительных (3 шт.);
- кабель для связи с компьютером;
- паспорт; руководство по эксплуатации;
- методика поверки;
- программное обеспечение 643.02566540.00019-01.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ ТР-1М-В:**

- термованна ТЖ-1-300;
- масло МЦ-52 (13 кг);
- блок управления БУ-7-5;
- техническое моющее средство "Дикорин" (0,3 кг)
- камера вытяжная КВ-1В\* с паспортом;
- поддон;
- плата для подключения датчиков;
- набор заглушек (пробок) с отверстиями под датчики диаметром: 10 мм; 8 мм; 6 мм; 4 мм; без отверстий, - (по 7 каждого вида);
- набор кабелей соединительных (3 шт.);
- кабель для связи с компьютером;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки;
- программное обеспечение 643.02566540.00019-01.

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- эталонный термометр сопротивления ЭТС-100;
- устройство ТПВ-4\* для поверки поверхностных датчиков температур;

\*- доп. см. "Вспомогательное оборудование для поверки датчиков температуры"

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- эталонный термометр сопротивления ЭТС-100;
- устройство ТПВ-4\* для поверки поверхностных датчиков температур (устанавливается на ТР-1М-У1 и ТР-1М-У2);

\* - Доп. см. "Вспомогательное оборудование для поверки датчиков температуры"

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Термостат регулируемый ТР-1М-300»

«Термостат регулируемый ТР-1М-300 с камерой вытяжной КВ-1»

**ТЕРМОСТАТ СУХОБЛОЧНЫЙ ТС 600-2**

ДДШ 2.998.015 ТУ

ТС 600-2

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Термостат сухоблочный ТС 600-2 предназначен для нагрева средств измерения температуры в диапазоне от 50 до 600°C в лабораторных и цеховых условиях:

- при работе с погружными термометрами используется выравнивающий блок, в котором рассверлены колодцы требуемого диаметра.
- при работе с термометрами для измерения температуры поверхности используется блок выравнивающий поверхностный БВП-01.

Термостат ТС 600-2 состоит из термостата сухоблочного ТС-3 и блока управления БУ-7-10.

Термостат ТС 600-2 полностью заменяет термостат ТС 600-1.



БУ-7-10



ТС-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТС 600-2	ТС 600-2 при работе с блоком выравнивающим поверхностным БВП-01
Диапазон воспроизводимых температур, °С	50...600	50...400
Глубина погружения датчиков, мм	160	-
Диаметр выравнивающего блока, мм	44	44
Диаметр изотермической поверхности, мм	-	35
Допускаемая абсолютная погрешность воспроизведения заданной температуры, °С, не более	±0,6	±(0,3+0,005*t)
Перепад температуры на дне колодца нагревательного блока, °С, не более	0,1	-
Вертикальный градиент температуры в рабочей зоне (длина рабочей зоны 80 мм от дна колодца), °С/см, не более	0,1	-
Нестабильность поддержания температуры за 30 мин, °С, не более	±0,05	±0,1 (на поверхности)
Время выхода на температурный режим, мин, не более	45	90
Связь с ЭВМ		RS-232
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69		УХЛ4.1
Температура окружающего воздуха, °С		20±5
Питание		~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более		3
Габаритные размеры, мм, не более:		
- термостата ТС-3		155x195x375
- блока управления БУ-7-10		270x360x100
Масса, кг, не более:		
- термостата ТС-3		20
- блока управления БУ-7-10		4,5

**КОМПЛЕКТНОСТЬ ТС 600-2:**

- термостат сухой ТС-3;
- блок управления БУ-7-10;
- сменный выравнивающий блок с отверстиями d=4,5 мм (2 отв.), d=5,3 мм (2 отв.), d=5,8 мм (1 отв.), d=6,5 мм (2 отв.), d=8,5 мм (1 отв.), d=10,5 мм (1 отв.);
- выравнивающий блок-заготовка (2 шт.) (по заявке потребителя отверстия выравнивающих блоков-заготовок рассверливаются под указанный потребителем диаметр);
- сменные экраны (3 шт. - по одному экрану на каждый выравнивающий блок);
- съемник для извлечения выравнивающих блоков;
- кабели соединительные (3 шт.);
- кабель для связи с компьютером;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- программное обеспечение 643.02566540.00019-01.

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- блок выравнивающий поверхностный БВП-01 с паспортом.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Термостат сухой ТС 600-2»



**МАЛОИНЕРЦИОННАЯ ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ МТП-2МР**



**ТУ 50-96 ДДШ 1.298.000 ТУ**

МТП-2МР сертифицированы в составе установки УПСТ-2М



Декларация ЕАЭС № RU Д-РУ.РА 01.В.52213/21 от 14.10.21 о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

МТП-2МР

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Малоинерционная трубчатая печь МТП-2МР предназначена для нагрева средств измерения температуры в диапазоне от 100 до 1200°С в лабораторных условиях при их поверке, калибровке, испытаниях.

Печь МТП-2МР состоит из печи МТП-2М и блока управления (терморегулятора) БУ-7-4.



МТП-2М



БУ-7-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МТП-2МР-50-500	МТП-2МР-70-1000
Диапазон воспроизводимых температур, °С	100...1200	
Принцип работы	печь сопротивления горизонтального типа	
Используемая печь	МТП-2М-50-500	МТП-2М-70-1000
Используемый терморегулятор*	БУ-7-4	
Номинальные размеры рабочего пространства, мм	Ø 50, длина 500	Ø 70, длина 1000
Температурный градиент в средней части, °С/см, не более	0,8	
Нестабильность поддержания заданного температурного режима, °С/мин, не более	0,1	
Время разогрева до максимальной температуры, мин, не более	90	
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4,2	
Питание	~ 220 В; 50 Гц	
Потребляемая мощность, кВт, не более:		
- печи	5	8
- терморегулятора	0,022	
Габаритные размеры, мм, не более:		
- печи	730x200x350	1230x200x350
- терморегулятора	270x360x100	
Масса, кг, не более:		
- печи	16	39
- терморегулятора	4,5	
* - возможна поставка печи без терморегулятора		

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

Наименование изделия	Количество для печи	
	МТП-2МР-50-500	МТП-2МР-70-1000
печь МТП-2М-50-500	1 шт.	-
печь МТП-2М-70-1000	-	1 шт.
блок управления БУ-7-4	1 шт.	1 шт.
кабель ХТ1 ДДШ 6.644.004	1 шт.	1 шт.
кабель ХТ3 ДДШ 6.644.033	1 шт.	1 шт.
трубка кварцевая 25x2.5x620 ТУ 5932-014-00288679-01	1 шт.	-
трубка кварцевая 25x2.5x1100 ТУ 5932-014-00288679-01	-	1 шт.
программное обеспечение "Termocontrol" 643.02566540.00019-01	1 комплект	1 комплект
паспорт ДДШ 1.298.000 ПС	1 экз.	1 экз.
Примечание - По согласованию с предприятием-изготовителем потребитель может дополнительно заказать для МТП-2МР-50-500 никелевый выравнивающий блок длиной 140 мм по чертежам потребителя (см. стр. 104, в составе установки УПСТ-2М)		

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

с терморегулятором: «Печь МТП-2МР-50-500»;  
 без терморегулятора: «Печь МТП-2М-50-500».  
 По дополнительной заявке - преобразователь термоэлектрический эталонный ППО

**ПЕЧЬ ШАРОВАЯ ПШ 1200**

ТУ 3443-008-02566540-2005

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Печь шаровая ПШ 1200 предназначена для нагрева малогабаритных средств измерения температуры в диапазоне от 100°С до 1200°С в лабораторных условиях при их поверке и калибровке, кроме средств измерения, содержащих в конструкции кварцевое стекло.

Печь шаровая ПШ 1200 состоит из печи сферической ПС и блока управления БУ-7-4.

Поддержание температуры в печи ПС осуществляется автоматически при помощи микропроцессорного блока управления БУ-7-4.

**ДОСТАВКА ПЕЧИ:**

Доставка печи шаровой ПШ 1200 от предприятия-изготовителя до места эксплуатации печи осуществляется только представителем предприятия изготовителя с обязательной пусконаладкой печи.

Заказчик обеспечивает встречу представителя с оборудованием и готовое рабочее место для проведения пусконаладочных работ.



**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПШ 1200
Диапазон воспроизводимых температур, °С	100...1200
Принцип работы	сферическая печь сопротивления
Диаметр рабочей зоны, мм	80
Глубина погружения нагреваемых средства измерения, мм	200
Количество каналов под нагреваемые средства измерения	8
Диаметр каналов под нагреваемые средства измерения, мм	15±3
Температурный градиент в рабочей зоне, °С/см, не более	0,2
Нестабильность поддержания температурного режима, °С/мин, не более	0,1
Время выхода на рабочий режим, ч, не более	2
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1
Температура окружающего воздуха, °С	20±5
Питание	~220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более	8
Габаритные размеры, мм, не более	
- печи ПС	500x500x560
- блока управления БУ-7-4	270x360x100
Масса, кг, не более	
- печи ПС	50
- блока управления БУ-7-4	4,5

Наименование изделия	Кол-во
Печь сферическая ПС	1 шт.
Блок управления БУ-7-4	1 шт.
Кабель ХТ1 ДДШ6.644.004	1 шт.
Кабель ХТ2 ДДШ6.644.092	1 шт.
Кабель ХТ3 ДДШ6.644.033	1 шт.
Заглушка ДДШ8.632.085	8 шт.
Заглушка ДДШ8.632.085-01	8 шт.
Опора ДДШ8.074.058	4 шт.
Стержень ДДШ8.352.024	8 шт.
Гайка ДДШ8.935.049	4 шт.
Держатель ДДШ6.152.010	8 шт.
Трубка керамическая ДДШ7.352.007	1 шт.
Паспорт ДДШ1.298.003 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации ДДШ1.298.003 РЭ	1 экз.
Программное обеспечение "Termocontrol" 643.02566540.00019-01	1 комплект

**КАК ОБОРУДОВАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧИ ПШ 1200**

1. Место установки печи должно предусматривать возможность подключения блока управления к щиту электропитания с автоматическим выключателем с током срабатывания не менее 40 А, возможность заземления блока управления и печи сферической. На время проведения ПНР необходимо присутствие электрика, для подключения блока управления к щиту электропитания.

2. При необходимости работы с печью с помощью ПК, необходимо наличие на месте установки печи ПК, с операционной системой Windows XP или Windows 7, не хуже:

- процессор Intel Pentium III или лучше;
- оперативная память - 256 Mb;
- свободное место на диске для установки программного обеспечения - 3 Mb;
- видеосистема, способная поддерживать разрешение 800x600 и качество цветопередачи 256 цветов;
- порт RS-232 (9 pin).

Для установки программного обеспечения для работы с печью необходимы права администратора.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Печь ПШ 1200»



**ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕЧЬ ВТП 1600-1**

ТУ 3443-022-02566540-2004

ВТП 1600-1

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Высокотемпературная печь ВТП 1600-1 предназначена для нагрева средств измерения температуры в лабораторных и цеховых условиях.

Печь ВТП 1600-1 состоит из термоблока и блока управления БУ-7-6.

ВТП 1600-1 оснащена микропроцессорным управлением, позволяющим получать высокую стабильность поддержания температуры и малую дискретность задания температуры.

Рабочим пространством печи является внутренний объем трубы из высокотемпературной высокоплотной керамики. Эта труба благодаря своим физическим свойствам обеспечивает защиту средств измерения из благородных металлов от агрессивных испарений, возникающих при температурах выше 1000°C. Таким образом, допускается использование средств измерения из благородных металлов без специальной защиты (сапфировых трубок).



термоблок



БУ-7-6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВТП 1600-1-00
Диапазон воспроизводимых температур, °С	300...1600
Номинальные размеры рабочего пространства печи, мм:	
- диаметр	18±1
- длина	550
Температурный градиент по длине печи в ее средней части (± 25 мм от центра рабочего пространства), °С/см, не более	1
Нестабильность поддержания заданного температурного режима, °С/мин, не более	±0,4
Время разогрева печи от температуры (20±5) °С до максимальной рабочей температуры 1600 °С, ч, не более	4
Скорость нагрева и охлаждения печи, °С/мин, не более	10
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2
Температура окружающего воздуха, °С	20±5
Питание	~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более:	
- термоблока	2,5
- блока управления БУ-7-6	0,022
Габаритные размеры, мм, не более:	
- термоблока	700x300x400
- блока управления БУ-7-6	270x360x100
Масса, кг, не более:	
- термоблока	40
- блока управления БУ-7-6	4,5

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

Наименование изделия	Кол-во
Термоблок	1 шт.
Блок управления БУ-7-6	1 шт.
Кабель ХТ1 ДДШ6.644.004	1 шт.
Кабель ХТ1 ДДШ6.644.033	1 шт.
Нагреватель Лантерм К16/300/200	2 шт.
Труба керамическая	1 шт.
Заглушка ДДШ 8.632.080	2 шт.
Программное обеспечение "Termocontrol" 643.02566540.00019-01	1 комплект
Паспорт ДДШ1.298.004 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации ДДШ1.298.004 РЭ	1 экз.

**ДОСТАВКА ПЕЧИ:**

Доставка печи высокотемпературной ВТП 1600-1 от предприятия-изготовителя до места эксплуатации печи осуществляется только представителем предприятия изготовителя с обязательной пусконаладкой печи.

Заказчик обеспечивает встречу представителя с оборудованием и готовое рабочее место для проведения пусконаладочных работ.

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Печь ВТП 1600-1-00»

**Как оборудовать рабочее место для подключения Печи ВТП-1600-1-00.**

1. Место установки печи должно предусматривать возможность подключения блока управления к щиту электропитания с автоматическим выключателем с током срабатывания не менее 25 А, возможность заземления блока управления и термоблока. На время проведения ПНР необходимо присутствие электрика, для подключения блока управления к щиту электропитания.

2. При необходимости работы с печью с помощью ПК, необходимо наличие на месте установки печи ПК, с операционной системой Windows XP или Windows 7, не хуже:

- процессор Intel Pentium III или лучше;
- оперативная память - 256 Mb;
- свободное место на диске для установки программного обеспечения - 3 Mb;
- видеосистема, способная поддерживать разрешение 800x600 и качество цветопередачи 256 цветов;
- порт RS-232 (9 pin).

Для установки программного обеспечения для работы с печью необходимы права администратора.

**ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕЧЬ ВТП 1800-1**

МКСН.681118.014 ТУ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Печь высокотемпературная ВТП 1800-1 предназначена для нагрева рабочих и эталонных преобразователей термоэлектрических при их поверке в диапазоне температур от 600 до 1780 °С в соответствии с ГОСТ 8.338 и ГОСТ 8.779, а также для нагрева любых объектов в указанном диапазоне температур.

Печь ВТП 1800-1 состоит из термоблока, силового узла, блока управления БУ-7-11 и комплекта соединительных кабелей.

Нагреватель имеет форму трубы, установлен в печи вертикально. Рабочим пространством печи является внутренний объем чехла, установленного в полости нагревателя.

Силовой узел выполнен в отдельном металлическом корпусе и предназначен для подачи пониженного питающего напряжения на печь ВТП 1800-1. Он содержит в себе понижающий трансформатор, силовые ключевые элементы для коммутации питающего напряжения термоблока и охлаждающий вентилятор.

Регулирование температуры проводится блоком управления с помощью БУ-7-11.

Блок БУ-7-11 выполнен в отдельном корпусе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВТП 1800-1
Диапазон воспроизводимых температур, °С	от 600 до 1780
Время разогрева печи от температуры (20±5) °С до максимальной рабочей температуры 1780 °С, час, не более	4
Скорость нагрева и охлаждения печи, °С/мин, не более	20
Нестабильность поддержания заданного температурного режима, °С/мин, не более	±0,4
Перепад температур по длине термоблока в его средней части (± 25 мм от центра рабочего пространства) при температуре 1400 °С не превышает, °С	±2,5
что соответствует температурному градиенту, °С/см, не более	1
Размеры рабочего пространства печи, мм:	
диаметр	18
глубина	420
Глубина погружения до центра рабочей зоны, мм	380
Габаритные размеры, мм, не более	
термоблока	456x456x800
силового узла	310x370x460
блока управления БУ-7-11	270x360x100
Масса, кг, не более:	
термоблока	57
силового узла	53
блока управления БУ-7-11	4,5
Потребляемая мощность, кВт·А, не более	3,5

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Высокотемпературная печь ВТП 1800-1»

ВТП 1800-1



термоблок

термоблок



БУ-7-11

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Связь с компьютером через интерфейс RS-232.
- Высокоточное и высокостабильное микропроцессорное управление и регулирование.
- Рабочим пространством печи является внутренний объем трубы из высокотемпературной высокоплотной керамики обеспечивающая защиту средств измерения из благородных металлов от агрессивных испарений, возникающих при температурах выше 1000°С. Таким образом, **допускается использование средств измерения из благородных металлов без специальной защиты** (сапфировых трубок).
- Система естественного воздушного охлаждения термоблока позволяет работать с печью **без применения принудительного водяного охлаждения**.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

Наименование изделия	Кол-во
Термоблок	1 шт.
Узел силовой-1 МКСН.431421.003-01	1 шт.
Блок управления БУ-7-11	1 шт.
Кабель ХТ1 МКСН.685631.033	1 шт.
Кабель ХТ2 МКСН .685631.014	1 шт.
Кабель ХТ3 ДДШ 6.644.022	1 шт.
Кабель ХТ4 МКСН .685631.013	1 шт.
Кабель ХТ5 МКСН .685631.031	1 шт.
Кабель ХТ6 ДДШ6.644.033	1 шт.
Чехол МКСН.305179.010	1 шт.
Заглушка МКСН.715141.034	2 шт.
Заглушка МКСН.715141.040	2 шт.
Диффлектор МКСН.304167.004	1 шт.
Огнеупорное керамическое волокно 300x200x25мм.	1 шт.
Программное обеспечение 643.02566540-00019-01	1 комплект
Паспорт МКСН.681118.014 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации МКСН.681118.014 РЭ	1 экз.





**МАЛОИНЕРЦИОННАЯ ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ МТП 1200**



**ТУ МКСН.681118.002 ТУ**

*Печь МТП 1200-4 декларирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Декларация ЕАЭС № RU Д-РУ.РА 04.В.32916/22 от 21.06.22*


МТП 1200

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Печь МТП 1200 предназначена для нагрева средств измерения температуры в лабораторных условиях.

Печь МТП 1200 состоит из термоблока и блока управления БУ-7-2.

Основной особенностью печи является низковольтное питание нагревателей 36В, что обеспечивает высокую электробезопасность и надежность. Кроме этого печь МТП 1200 содержит три нагревателя, позволяющие получить уникальный градиент температуры вдоль оси печи, а микропроцессорный блок управления и современное сервисное программное обеспечение обеспечивают удобную настройку и работу с печью.

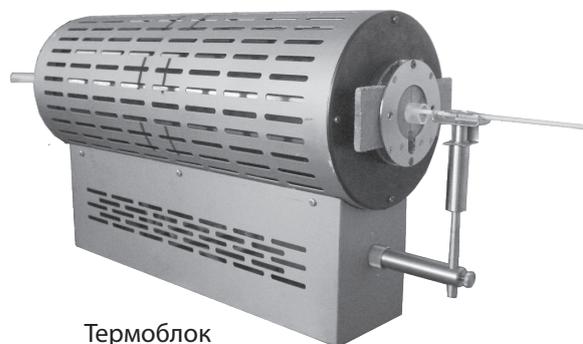

Термоблок



БУ-7-2



Узел силовой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МТП 1200-4	МТП 1200-5
Диапазон воспроизводимых температур, °С	100...1200	
Номинальные размеры рабочего пространства, мм	Ø 50, длина 500	Ø 50, длина 1000
Нестабильность поддержания заданного температурного режима в диапазоне рабочих температур печи, °С/мин. не более	0,1	
Время выхода на температурный режим, мин., не более	90	
Перепад температуры по длине термоблока в его средней части (± 60 мм от центра рабочего пространства) при температуре в термоблоке (1200±5) °С 0,6 °С, что соответствует температурному градиенту, °С/см не более	±0,1	
Дискретность задания температуры, °С	0,1	
Разрешающая способность индикатора температуры, °С	0,01	
- в диапазоне от 100 до 999 °С	0,1	
- в диапазоне от 1000 до 1200 °С		
Связь с ЭВМ	RS-232	
Максимальная потребляемая мощность, кВт·А,		
- МТП 1200-4	4,5	5,5
- МТП 1200-5		
Питание	380 В; 50Гц.	
Габаритные размеры, мм, не более:		
- термоблока МТП 1200-4	730x210x350	1230x210x350
- термоблока МТП 1200-5		
- узла силового	310x370x460	310x370x460
- блока управления БУ-7-2	270x360x100	270x360x100
Масса, кг, не более:		
- термоблока МТП 1200-4	18	39
- термоблока МТП 1200-5	53	53
- узла силового	5	5
- блока управления БУ-7-2		

КОМПЛЕКТНОСТЬ	Кол-во	
	МТП 1200-4	МТП 1200-5
Термоблок ДДШ 2.983.017	1 шт	-
Термоблок МКСН.681119.007		1 шт
Блок управления БУ-7-2 МКСН.405544.005-002	1 шт	
Узел силовой-3 МКСН.431421.003	1 шт	
Кабель МКСН.685631.033	1 шт	
Кабель МКСН.685631.014	1 шт	
Кабель ДДШ 6.644.022	1 шт	
Кабель ДДШ 6.644.033	1 шт	
Трубка кварцевая 25x2,5x620	1 шт	
Трубка кварцевая 25x2,5x1050		1 шт
Программное обеспечение "Termocontrol" 643.02566540.00019-01	1 комплект	
Паспорт МКСН.681118.002 ПС	1 экз	
Руководство по эксплуатации МКСН.681118.002 РЭ	1 экз	

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Печь МТП 1200-4»

КАЛИБРАТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

КАЛИБРАТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ СУХОБЛОЧНЫЕ КС 100-1, КС 600-1



ТУ 4381-005-02566540-2007

КС 100-1, КС 600-1 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под №37366-08  
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.005.A №30970

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Калибраторы температуры сухоблочные КС (далее – калибраторы) предназначены для поверки и калибровки различных средств измерения температуры (термопреобразователей сопротивления, термоэлектрических преобразователей, цифровых термометров и др.) в лабораторных и промышленных условиях.

Принцип действия калибратора основан на воспроизведении и поддержании заданной температуры в металлическом выравнивающем блоке с помощью элементов Пельтье или резистивных элементов, измерении сигнала поверяемого (калибруемого) средства измерения температуры и выводе его на дисплей.

Калибратор реализует метод сличения поверяемого средства измерения с индивидуально градуируемым платиновым термопреобразователем сопротивления повышенной точности, что значительно уменьшает погрешность калибровки. Такой термопреобразователь, изогнутый под углом 120°, устанавливается рядом с поверяемым средством измерения и подключается к специальному разъему калибратора.

Калибратор обеспечивает измерение и преобразование входных сигналов в виде напряжения и сопротивления, в том числе поступающих от термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Калибраторы выпускаются в двух исполнениях, отличающихся диапазоном воспроизводимых температур:

- КС 100-1 с диапазоном от минус 10 °С до +100 °С;
- КС 600-1 с диапазоном от +50 °С до +600 °С.



КС 100-1  
КС 600-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КС 100-1	КС 600-1
Диапазон воспроизводимых температур, °С	-10...+100	50...600
Глубина погружения в рабочее пространство, мм, не менее	180	160
Диаметр выравнивающего блока, мм	35	44
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при воспроизведении заданной температуры, °С:		
- без использования внешнего термометра сопротивления с индивидуальной градуировкой	$\pm (0,1+1 \cdot 10^{-3} \cdot  t )$	
- с использованием внешнего термометра сопротивления с индивидуальной градуировкой	$\pm (0,05+6 \cdot 10^{-4} \cdot  t )$ ,	
Нестабильность поддержания температуры за 30 мин., °С	$\pm (0,02+1 \cdot 10^{-4} \cdot  t )$	
Горизонтальный перепад температуры между колодцами выравнивающего блока, °С, не более	$\pm (0,03+4 \cdot 10^{-4} \cdot  t )$	
Вертикальный перепад температуры в изотермической рабочей зоне (0-40) мм от дна колодца выравнивающего блока, °С, не более	$\pm (0,03+4 \cdot 10^{-4} \cdot  t )$	
Время выхода на режим стабилизации температуры, мин	45	
Связь с ЭВМ	RS-232	
Рабочие условия эксплуатации:		
- температура окружающего воздуха, °С	20±5	
- относительная влажность окружающего воздуха, %, не более	80	
- атмосферное давление, кПа	84-106,7	
Питание	~ 220 В; 50 Гц	
Потребляемая мощность, кВт, не более	0,2	3
Габаритные размеры, мм, не более	450x250x450	
Масса, кг, не более	20	25
Наработка на отказ, ч, не менее:	2 000	
Средний срок службы, лет, не менее	5	
Примечание: t – значение воспроизводимой температуры, °С		



Диапазоны измерения (преобразования) входного сигнала и пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении входного сигнала приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Входная величина		Диапазон измерения (преобразования)	Пределы допускаемой абсолютной погрешности
ТЭДС термоэлектрического преобразователя по ГОСТ Р 8.585-2001 в режиме измерения без автоматической компенсации свободных концов:	ПП(S)	от 0 до 1760 °С	±0,4 °С
	ХА(K)	от -200 до +1300 °С	±0,2 °С
	ХК(L)	от -200 до +800 °С	±0,2 °С
ТЭДС термоэлектрического преобразователя по ГОСТ Р 8.585-2001 в режиме измерения с автоматической компенсацией свободных концов	ПП(S)	от 0 до 1760 °С	±0,8 °С
	ХА(K)	от 0 до 1300 °С	±0,6 °С
	ХК(L)	от 0 до 800 °С	±0,6 °С
Сопротивление термопреобразователя сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006	W100=1,428: 50M, 100M	от -50 до +200 °С	±(1,5·10 <sup>-2</sup> + 2,5·10 <sup>-4</sup> · t ) °С
	W100=1,391: 10П, 50П, 100П, 500П, 1000П	от -200 до +660 °С	
	W100=1,385: 50П, 100П, 500П, 1000П	от -200 до +660 °С	
Напряжение постоянного тока		от -300 до +300 мВ	±(3·10 <sup>-3</sup> + 4,5·10 <sup>-5</sup> · U ) мВ
Сопротивление постоянному току		от 0 до 30 Ом	±(5·10 <sup>-4</sup> + 2,5·10 <sup>-4</sup> · R-10 ) Ом
		от 0 до 300 Ом	±(5·10 <sup>-3</sup> + 2,5·10 <sup>-4</sup> · R-100 ) Ом
		от 0 до 3000 Ом	±(5·10 <sup>-2</sup> + 2,5·10 <sup>-4</sup> · R-1000 ) Ом
Примечание: t, U, R – измеряемые значения температуры, напряжения и сопротивления соответственно в °С, мВ, Ом.			

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

Наименование изделия	Обозначение	Кол-во	Исполнение:	
			КС 100-1	КС 600-1
Калибратор температуры сухоблочный КС	ДДШ 2.998.016	1 шт.	+	-
	ДДШ 2.998.017	1 шт.	-	+
Термометр сопротивления с индивидуальной градуировкой ТСП0307	ДДШ2.822.198	1 шт.	+	+
Устройство компенсации УК-5	ДДШ2.821.200	1 шт.	+	+
Кабель сетевой	SCZ-1, 220 В, 10 А	1 шт.	+	+
Кабель интерфейсный	ДДШ6.644.079	1 шт.	+	+
Сменный выравнивающий блок с отверстиями диаметром 4,5 мм (2 отв.), 5,3 мм (2 отв.), 5,8 мм (1 отв.), 6,5 мм (2 отв.), 8,5 мм (1 отв.), 10,5 мм (1 отв.)	ДДШ8.236.029	1 шт.	-	+
Сменный выравнивающий блок с отверстиями диаметром 4,5 мм (1 отв.), 5,3 мм (2 отв.), 6,5 мм (2 отв.)	ДДШ8.236.032	1 шт.	+	-
Блок выравнивающий (заготовка)	ДДШ8.236.028	2 шт.	-	+
Блок выравнивающий (заготовка)	ДДШ8.236.031	2 шт.	+	-
Сменный экран	ДДШ8.634.102	1 шт.	-	+
Сменный экран	ДДШ8.634.101	2 шт.	-	+
Съемник для извлечения выравнивающих блоков	ДДШ6.894.001	1 шт.	+	+
Розетка РС4ТВ с кожухом	АВ0.364.047 ТУ	1 шт.	+	+
Вилка РС4ТВ	АВ0.364.047 ТУ	1 шт.	+	+
Вилка	743402-15	4 шт	+	+
Программное обеспечение	643.02566540.00003-01	1 шт.	+	+
Паспорт	ДДШ 2.998.016 ПС	1 экз.	+	+
Руководство по эксплуатации	ДДШ 2.998.016 РЭ	1 экз.	+	+
Методика поверки	МП 07 -221-2008	1 экз.	+	+

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Калибратор температуры сухоблочный КС 100-1»  
«Калибратор температуры сухоблочный КС 600-1»

**КАЛИБРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ СУХОБЛОЧНЫЙ КС 1200-2 РАЗРАБОТКА**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Калибратор КС 1200-2 предназначен для воспроизведения температуры в диапазоне от +100 до +1200 °С при калибровке (поверке) термопреобразователей сопротивления и преобразователей термоэлектрических.

Калибратор КС 1200-2 представляет собой моноблочную конструкцию, в одном корпусе размещаются тепловая башня, силовые элементы, микропроцессорный регулятор температуры, прецизионный многоканальный вольтметр, ЖК-дисплей с сенсорным управлением.

КС 1200-2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КС 1200-2
Диапазон воспроизводимых температур, °С	100 до 1200
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при воспроизведении заданной температуры, °С	±1,5
Нестабильность поддержания заданного температурного режима в диапазоне рабочих температур за 30 мин, °С, не более	±0,3
Горизонтальный перепад температуры между колодцами выравнивающего блока, не более, °С	0,1
Вертикальный перепад температуры в рабочей зоне, не более, °С /см	0,16
Длина рабочей зоны (от дна колодца), мм	50
Глубина погружения датчиков в калибратор до центра рабочей зоны, мм	300
Глубина каналов в выравнивающем блоке, мм	200
Диаметр выравнивающего блока, мм	47
Время выхода в режим стабилизации температуры, мин., не более:	
- в диапазоне температур от 100 до 300	120
- в диапазоне температур от 300 до 1200	60
Количество одновременно поверяемых датчиков, шт	от 1 до 4
Дискретность задания температуры, °С	0,1
Разрешающая способность индикатора температуры, °С	
- в диапазоне от 300 до 999,999 °С	0,001
- в диапазоне от 1000 до 1200 °С	0,01
Связь с ПК по интерфейсу	RS-232
Максимальная потребляемая мощность, кВ-А	2
Габаритные размеры, мм, не более (Ш*В*Г)	257x575x534
Масса, кг, не более	20




**ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ**

**КАССЕТА ДЛЯ ПОВЕРКИ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ**

ДДШ 6.212.004

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Кассета для поверки стеклянных термометров применяется при поверке стеклянных термометров в термостатах регулируемых ТР-1М-300, ТР-1М-500, ТР-1М-У1, ТР-1М-У2 и в криостате КР-40-2. Дополнительно см. рисунок в пункте "Видеоискатель"

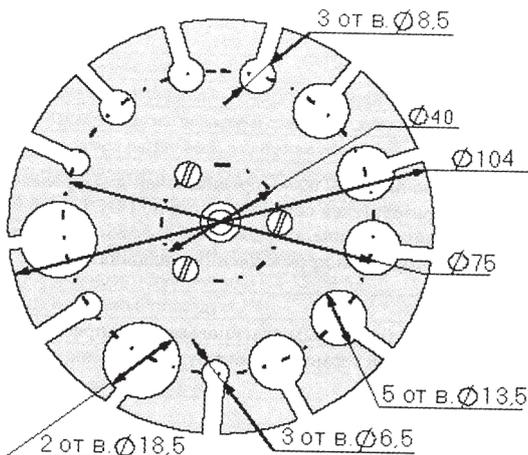

**КАМЕРА ВЫТЯЖНАЯ КВ-1 (КВ-1В)**

ДДШ 2.969.003

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Камера вытяжная КВ-1 (КВ-1В) предназначена для защиты атмосферы помещения, в котором располагается камера, от вредных паров или веществ, выделяемых объектом (термованна ТЖ-1-300 или ТЖ-1-500 из состава термостатов ТР-1М), находящимся в камере.

Камера вытяжная КВ-1В представляет собой камеру КВ-1 с установленным на ней вытяжным зонтом ДДШ 5.883.002.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КВ-1	КВ-1В
Габаритные размеры, мм, не более	500x500x2000	500x500x2500
Масса, кг, не более	45	50



Термованна ТЖ-1-300 (из состава термостатов ТР-1М) внутри камеры вытяжной КВ-1

**ШТАТИВ ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ**

МКСН.304269.003

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Штатив предназначен для удобства погружения термопреобразователей в рабочее пространство печей и термостатов при проверке их параметров. Выпускается в двух модификациях:

- МКСН.304269.003 — основная модификация;
- МКСН.304269.003-01 — штатив без подставки, для установки на изделие\*.

\*При наличии в изделии встроенного крепления с установочным диаметром 21 мм

Технические характеристики	МКСН.304269.003	МКСН.304269.003-01
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	250x260x760	160x260x760
Масса, кг	10	3,5
Количество держателей для термопреобразователей, шт.	2	2
Вспомогательная шкала позиционирования держателей, мм	0 - 450	0 - 450
Наличие подставки	Есть	Нет


**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Штатив для термопреобразователей МКСН.304269.003»

**КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:**

МКСН.304269.003

МКСН.304269.003-01

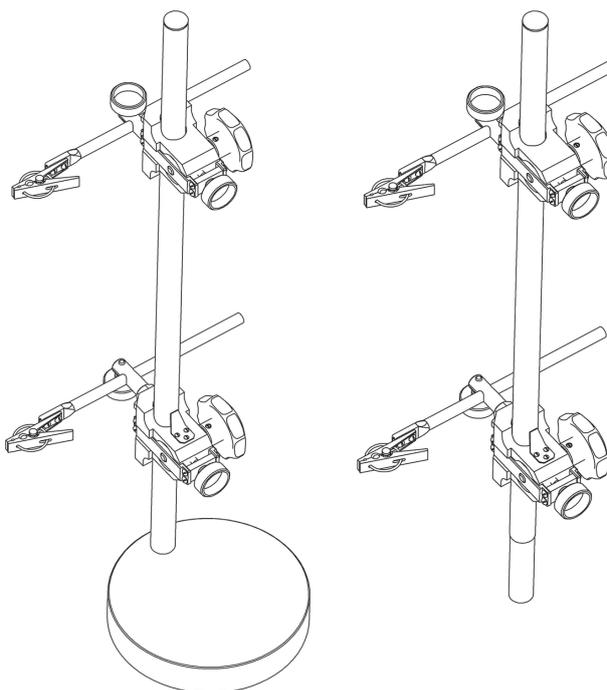



## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ЛЬДА УДЛ-2

ТУ 50-240-80

### НАЗНАЧЕНИЕ:


Устройство для дробления льда УДЛ-2 предназначено для измельчения льда, используемого в термостатах, реализующих температуру 0°С при поверочных работах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	УДЛ-2
Средний размер ледяной крошки, мм, не более	3
Время измельчения бруска льда размером 40x80x95 мм, с, не более	5
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2
Количество поддонов размером 41x91x240 мм	30
Питание	трехфазная сеть; ~ 380 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более	1
Габаритные размеры, мм, не более	480x220x430
Масса, кг, не более	30

Устройство поставляется с поддонами для замораживания воды и с устройствами (кружка и короб) для приема ледяной крошки.

Объем кружки для приема ледяной крошки 3,9 литра.

Короб применяется, если ледяную крошку нужно направить сразу в заполняемый термостат.

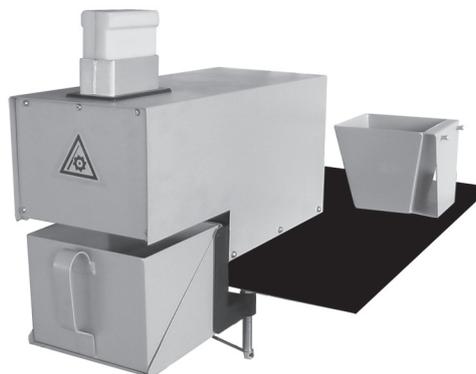

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Устройство УДЛ-2»

## ТЕРМОСТАТЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ТПВ-2М, ТПВ-3, ТПВ-4, БВП-01

ТПВ-2М выпускается по ДДШ 5.868.015;

ТПВ-3 выпускается по ДДШ 5.868.016;

ТПВ-4 выпускается по МКСН.440211.001;

БВП-01 выпускается по ДДШ 5.868.014.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТПВ-2М	ТПВ-4	ТПВ-3	БВП-01*
Термостат, используемый в качестве базы	ТР-1М-300, ТР-1М-500	ТР-1М-У1, ТР-1М-У2	КР -40-2	ТС 600-2
Диапазон воспроизводимых температур, °С	40...200	40...300	-40...+40	50...400
Диаметр рабочей зоны, мм	70		35	
Погрешность воспроизведения температуры, °С	1		0,3+0,005* <i>t</i>	
Перепад температур в пределах рабочей зоны, °С	0,7		0,3	-

\* см. дополнительно ОПИСАНИЕ ТС 600-2

### НАЗНАЧЕНИЕ

Термостаты поверхностные ТПВ-2М, ТПВ-3, ТПВ-4 и блок выравнивающий поверхностный БВП-01 применяются для проверки поверхностных датчиков температуры.

ТПВ-2М, ТПВ-3, ТПВ-4, БВП-01 эксплуатируются только совместно с криостатами и термостатами согласно таблице.

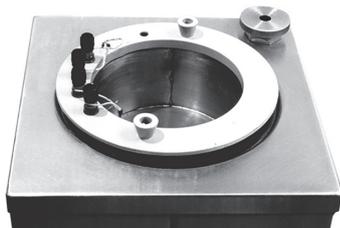

Термостат ТР-1М с ТПВ-2М



Термостаты поверхностные ТПВ-3



Блок выравнивающий поверхностный БВП-01

### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Термостат поверхностный ТПВ-2М»



**БЛОКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ДЛЯ ПЕЧЕЙ МТП-2МР**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Выравнивающие блоки для печей МТП-2МР изготавливаются из никелевого сплава и могут использоваться совместно с печами для уменьшения перепада (градиента) температуры в рабочей зоне.

Предприятие может поставлять выравнивающие блоки, изготовленные по эскизу потребителя, либо блоки-заготовки, в которых потребитель может самостоятельно высверливать отверстия под конкретные датчики температуры.

**Блок выравнивающий для печи МТП-2МР-50-500** имеет длину 140 мм и изготавливается в трех исполнениях: -00, -01, -02.



Блоки выравнивающие

Кон-струк. исполнение	ДДШ	Рис.	Комментарии
-00	ДДШ7.069.003	1	С одним отверстием для ППО. Потребитель самостоятельно высверливает отверстия под конкретные датчики температуры.
-01	ДДШ7.069.003-01	2	С отверстиями для ППО и поверяемых датчиков. Отверстия высверливаются по эскизу потребителя.
-02	ДДШ7.069.003-02	3	Типа стакана

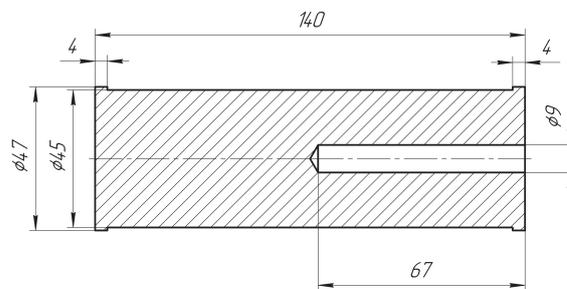


Рис.1 Блок выравнивающий ДДШ7.069.003

**Блок выравнивающий для печи МТП-2МР-70-1000** имеет длину 80 мм. и изготавливается в одном исполнении типа стакана МКСН.715131.014 (рис.4)

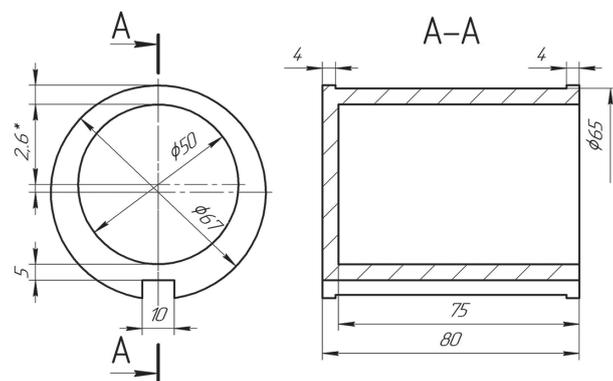


Рис.4 Блок выравнивающий МКСН.715131.014

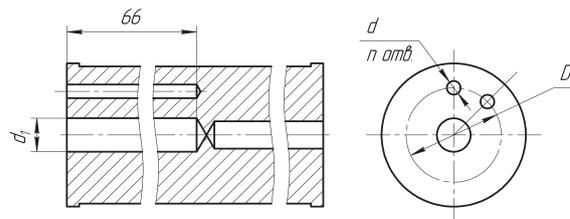


Рис.2 Блок выравнивающий ДДШ7.069.003-01. (Остальное - см. рис.1)

Устанавливает потребитель при заказе:

- размеры (d, d1),
- взаимное расположение (D),
- количество отверстий (n)

**Пример записи при заказе:**

Блок выравнивающий для печи МТП-2МР-50-500 ДДШ7.069.003-01  
 Блок выравнивающий для печи МТП-2МР-70-1000 МКСН.715131.014

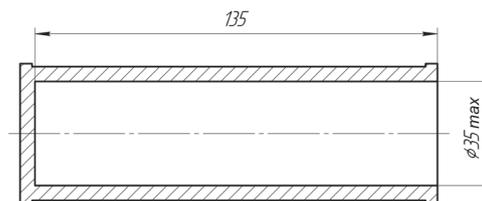


Рис.3 Блок выравнивающий ДДШ7.069.003-02. (Остальное - см. рис.1)



## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РЕПЕРНЫХ ТОЧЕК ТЕМПЕРАТУРНОЙ ШКАЛЫ МТШ-90

### ПЕЧИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕПЕРНЫХ ТОЧЕК ТЕМПЕРАТУРНОЙ ШКАЛЫ МТШ-90 ПРТ 50-700, ПРТ 600-1100-2

**Печь ПРТ 50-700 выпускается по МКСН.681118.011 ТУ**

**Печь ПРТ 600-1100-2 выпускается по МКСН.681118.013 ТУ**

**ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ** за разработку и изготовление печей для воспроизведения реперных точек в составе государственного эталона температуры в диапазоне 50...1100°C

**12-ый Московский международный инновационный форум**

«Точные измерения - основа качества и безопасности», 17 - 19 мая 2016 года, ВДНХ



#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Печи ПРТ 50-700 и ПРТ 600-1100 предназначены для реализации реперных точек МТШ-90 в лабораторных условиях в диапазоне температур (50...700) °С и (600...1100) °С соответственно.

#### ОСОБЕННОСТИ:

Обеспечивают длительное плато;  
Связь с компьютером через интерфейс RS-232;  
Высокоточное и высокостабильное микропроцессорное управление;  
Трехзонный нагреватель, обеспечивающий малый температурный градиент вдоль ампулы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРТ 50-700	ПРТ 600-1100-2
Диапазон воспроизводимых температур, °С	50...700	600...1100
Перепад температуры на расстоянии 300 мм от дна, °С, не более	0,6	
Нестабильность поддержания температуры, °С, не более	±0,3	
Диаметр колодца под ампулу, мм	54	
Питание	~220 В; 50 Гц	
Потребляемая мощность, кВт, не более	4,5	4
Габаритные размеры, мм, не более	415x230x815	450x450x840
- печи реализации		310x370x460
- силового узла		270x360x100
- блока управления БУ-7-2		
Масса, кг, не более	40	50
- печи реализации		60
- силового узла		5
- блока управления БУ-7-2		

Печь ПРТ 50-700



Печь ПРТ 600-1100-2



**Печь ПРТ 50-700** представляет собой моноблочную конструкцию, то есть в одном корпусе размещаются тепловая башня, цифровой микропроцессорный регулятор температуры, узел индикации и силовые элементы. Узлы микропроцессорного регулятора температуры расположены на отдельной панели, которая отделена от тепловой башни значительным воздушным зазором. На нижнем основании печи установлены ключевые силовые элементы, предназначенные для коммутации напряжения питания нагревателей

**Печь ПРТ 600-1100-2** состоит из печи реализации, силового узла и блока управления БУ-7-2. Печь реализации представляет собой вертикальную трехзонную печь с напряжением питания нагревателей 36В.

Силовой узел выполнен в отдельном металлическом корпусе, предназначен для подачи питающего напряжения на нагреватели печи реализации и содержит в себе понижающий трансформатор, силовые ключевые элементы для коммутации питающего напряжения нагревателей печи реализации и охлаждающий вентилятор.

В комплект печи ПРТ 600-1100-2 входит блок управления БУ-7-2 - трехканальный блок для печи реализации.

БУ-7-2



Силовой узел

Печь реализации





КОМПЛЕКТНОСТЬ печи ПРТ 50-700	Кол-во
печь реперных точек ПРТ 50-700 МКСН.681118.011	1 шт
кабель МКСН.685631.033	1 шт
кабель ДДШ 6.644.033	1 шт
ручка ДДШ 6.465.013	2 шт
блок выравнивающий МКСН.715131.008	1 шт
съемник МКСН.303658.010	1 шт
заглушка МКСН.713311.042	1 шт
захват МКСН.301524.004	1 шт
контейнер МКСН.307641.009-01	1 шт
ампула для реализации точки затвердевания индия *	
ампула для реализации точки затвердевания олова *	
ампула для реализации точки затвердевания цинка *	
ампула для реализации точки затвердевания алюминия *	
программное обеспечение "Termoscontrol" 643.02566540.00019-01	1 комплект
паспорт МКСН.681118.011 ПС	1 экз
руководство по эксплуатации МКСН.681118.011 РЭ	1 экз
программа и методика аттестации ПА 101.00285-2014	1 экз
* Поставляется ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ заказчика	

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Печь ПРТ 600-1100-2»

КОМПЛЕКТНОСТЬ печи ПРТ 600-1100-2	Кол-во
печь реализации 5 МКСН.681118.015	1 шт.
узел силовой-3 МКСН.431421.003	1 шт.
блок управления БУ-7-2 МКСН.405544.005-02	1 шт.
кабель МКСН.685631.033	1 шт.
кабель МКСН.685631.014	1 шт.
кабель ДДШ 6.644.022	1 шт.
кабель МКСН.685631.013	1 шт.
кабель МКСН.685631.011	1 шт.
кабель ДДШ 6.644.033	1 шт.
блок выравнивающий МКСН.715131.009	1 шт.
съемник МКСН.303658.013	1 шт.
штулка МКСН.713311.046	1 шт.
захват МКСН. 301524.004-01	1 шт.
контейнер МКСН.307641.009-02	1 шт.
ампула для реализации точки затвердевания алюминия *	
ампула для реализации точки затвердевания серебра *	
ампула для реализации точки затвердевания меди *	
программное обеспечение "BU7 service" 643.02566540.00026-01	1 комплект
паспорт МКСН.681118.013 ПС	1 экз.
руководство по эксплуатации МКСН.681118.013 РЭ	1 экз.
программа и методика аттестации ПА 101.00953-2015	1 экз.
* Поставляется ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ заказчика	

**ОТЖИГОВАЯ ПЕЧЬ ОП 700-1**

МКСН.681118.008 ТУ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Отжиговая печь ОП 700-1 (далее - печь) предназначена для снятия эффекта закалки платины эталонных термометров сопротивления методом отжига по заданному температурному профилю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОП 700-1
- Диапазон воспроизводимых температур, °С	60 ... 700
- Нестабильность поддержания заданного температурного режима в диапазоне рабочих температур печи, °С	± 0,3
- Диаметр рабочего пространства, мм.	50
- Глубина рабочего пространства, мм.	500
- Перепад температуры на участке длиной 50 мм, °С, не более	2
- Дискретность задания температуры, °С	0,1
- Разрешающая способность индикатора температуры, °С	0,01
- Связь с ЭВМ по интерфейсу	RS-232
- Максимальная потребляемая мощность, кВт, А,	4,5
- Габаритные размеры, мм, не более:	
- термоблока	400x900x550
- блока управления БУ-7-4	270x100x360
- Масса, кг, не более:	
- термоблока	60
- блока управления БУ-7-4	5
- Средняя наработка на отказ, ч, не менее	2000
- Средний срок службы, лет, не менее	5

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Печь отжиговая ОП 700-1»

ОП 700-1

Термоблок



Блок управления БУ-7-4

КОМПЛЕКТНОСТЬ	Кол-во
Термоблок МКСН.681118.009	1 шт
Блок управления БУ-7-4 МКСН.405544.005-004	1 шт
Кабель ДДШ 6.644.004 (ХТ1)	1 шт
Кабель МКСН.685631.012 (ХТ2)	1 шт
Выравнивающий блок	1 шт
Съемник	1 шт
Заглушка	1 шт
Паспорт МКСН.681118.008 ПС	1 экз
Руководство по эксплуатации МКСН.681118.008 РЭ	1 экз



# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ ПИРОМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

## ЭТАЛОННЫЙ ПИРОМЕТР 1 РАЗРЯДА ПД-4-06



**ТУ 4211-012-02566540-2004**

Тип средства измерения зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 29468-05

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Пирометры эталонные ПД-4-06 1 разряда предназначены для высокоточного измерения и регулирования температуры в полостях образцовых излучателей в виде моделей абсолютно черного тела (АЧТ), ампул реперных точек, а также поверки рабочих пирометрических средств в диапазоне 1200...2500°С.

В этих пирометрах использованы специальные интерференционные фильтры для обеспечения узкого диапазона эффективных длин волн  $656,3 \pm 10$  нм.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Пирометры снабжены оптическим видоискателем (визирной трубой) и позволяют измерять температуру объектов диаметром от 2 мм.

Управление работой пирометров и индикация измеренных значений осуществляются при помощи ЭВМ.

Пирометры ПД-4-06 благодаря высокому оптическому разрешению обеспечивают возможность измерения температуры малых объектов, высокоскоростной процессор позволяет обрабатывать и передавать на ПЭВМ и токовый выход до 25 измерений в секунду. Оптическая система наведения позволяет наблюдать область измерения температуры на фоне объекта контроля.

Пирометры могут быть использованы для замены существующих оптических пирометров типа ЭОП-66, ЭОП-93.

### В ПИРОМЕТРАХ ПД-4-06 ПРЕДУСМОТРЕНО:

- изменяемое фокусное расстояние;
- связь с ЭВМ по интерфейсу RS-232;
- выбор скорости измерений из ряда 1; 5; 10; 25 изм./с;
- включение/выключение внутреннего цифрового фильтра, уменьшающего уровень шумов;
- возможность изменения параметров цифрового фильтра;
- одновременный аналоговый и цифровой выходы;
- вывод результатов измерения в цифровом виде на ЭВМ;
- токовый выход с программируемыми диапазоном температур и видом унифицированного токового выходного сигнала (0-5), (0-20) или (4-20) мА;
- выходной логический ключ (5В, 20мА) сигнализация обрыва токового выхода;
- два выходных логических ключа (5В, 20мА) для двух изменяемых уставок;
- индикация на ЭВМ температуры внутри корпуса прибора.

### ВХОДЯЩЕЕ В КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PIRO VISUAL, СОВМЕСТИМОЕ С WINDOWS 95/98/XP, ПОЗВОЛЯЕТ:

- идентифицировать пирометр;
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение измеренной температуры;
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности;
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параметров за допустимые значения;
- производить визуализацию измеренных значений в виде графика в режиме реального времени;
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске;
- выводить графики или их фрагменты на принтер;
- изменять параметры цифрового фильтра ПД-4 и скорость измерений;
- настраивать токовый выход;
- проводить подстройку пирометра;
- и др.

### ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Пирометр прецизионный ПД-4-06»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПД-4-06
Диапазон измерений, °С	1200...2500
Эффективная длина волны, нм	656,3±10
Показатель визирования	1:500
Номинальное рабочее расстояние, мм	1000±100
Индикация	на ЭВМ
Разрешающая способность индикации, °С	0,001
Разрешающая способность*, °С	до 0,01
Основная приведенная погрешность, % от диапазона, не более	0,2
Время установления выходного сигнала, мс, не более	50
Время установления рабочего режима, мин, не более	15
Диапазон возможной установки коэффициента коррекции излучательной способности	0,100...1,500
Дискретность установки коэффициента коррекции излучательной способности	0,001
Связь с ЭВМ	RS-232
Температура окружающего воздуха, °С	20±2
Питание	+ (24±0,5) В
Потребляемая мощность, Вт, не более	10
Габаритные размеры, мм, не более:	
- пирометра	379x310x82
- блока питания	232x96x96
Масса пирометра, кг, не более	1,5
*при включении цифрового фильтра	

КОМПЛЕКТНОСТЬ:	Кол-во
Пирометр прецизионный ПД-4-06 ДДШ2.820.011	1 шт.
Паспорт ДДШ 2.820.011 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации на пирометр ДДШ2.820.011РЭ	1 экз.
Методика поверки ДДШ 2.820.011 ДЗ	1 экз.
Кабель ДДШ 6.644.089 для ПД-4-01... ПД-4-04, ПД-4-06	1 шт.
Кабель ДДШ 6.644.089-01 для ПД-4-05	1 шт.
Труба визирная ТЗ-6	1 шт.
Светофильтр ДДШ3.900.008	1 шт.
Блок питания стабилизированный БПС 24-0.3 ДДШ2.087.006-01	1 шт.
Программное обеспечение "Piro Visual" 643.02566540.00007 - 01	1 комплект



**ЭТАЛОННЫЙ ПИРОМЕТР 1 РАЗРЯДА ПД-9-02**

ТУ 4211-076-02566540-2007

**ПД-9-02 - эталонный (образцовый) пирометр 1 разряда)**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Пирометры ПД-9-02 предназначены для высокоточного измерения температуры в полостях образцовых излучателей в виде моделей абсолютно черного тела (АЧТ), ампул реперных точек, а также поверки рабочих пирометрических средств.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:**

Пирометры ПД-9-02 предназначены для бесконтактного измерения температуры нагретых тел по их тепловому излучению. Пирометры этой серии оснащены шеститочечным круговым лазерным целеуказателем, который значительно упрощает процесс наведения и фокусировки на объекте измерений, подсвечивая контур пятна визирования прибора. Показатель визирования пирометра не менее 1:100, что соответствует пятну визирования 10 мм при расстоянии до контролируемой поверхности 1000 мм. Кожух пирометра выполнен из нержавеющей стали, позволяющей предохранить прибор от коррозии.

Измеренное значение температуры отображается на десятиразрядном ЖК-дисплее со светодиодной подсветкой. При помощи кнопок управления на панели пирометра возможно изменять настройки прибора и проводить коррекцию на излучательную способность объекта контроля.



ПД-9-02

**Микропроцессорная система блока обработки сигнала позволяет:**

- индицировать значение измеряемой температуры на ЖК-дисплее с разрешением 0.01 °С
- корректировать коэффициент излучательной способности с дискретностью 0.001
- контролировать и выводить на экран монитора персонального компьютера в графическом виде значение температуры в реальном времени, а также сохранять полученные результаты для последующей обработки
- осуществлять подсветку лазерным целеуказателем, показывая действительное пятно контроля на объекте
- производить автоматическую калибровку нуля
- настраивать цифровой фильтр и быстродействие
- производить выбор режима работы токового выхода (0-5, 0-20, 4-20 мА) и задавать динамический диапазон температуры (например 0-5 мА и диапазон 500-700 °С)
- регулировать температуру двумя логическими ключами
- осуществлять блокировку кнопок управления от несанкционированного доступа к настройкам прибора при помощи пароля

**Входящее в КОМПЛЕКТНОСТЬ программное обеспечение Piro Visual, совместимое с Windows 95/98/XP, позволяет:**

- идентифицировать пирометр
- отображать текущее, минимальное и максимальное значение температуры
- производить визуализацию измерений в виде графика в режиме реального времени
- задавать коэффициент коррекции излучательной способности
- производить выбор режима работы токового выхода
- производить автоматическую калибровку нуля
- настраивать цифровой фильтр и быстродействие
- проводить калибровку пирометра
- настраивать режимы работы логических ключей (уставок)
- сигнализировать о неисправности прибора или выходе параметров за допустимые значения
- вести непрерывную запись измерений в файл на жестком диске
- выводить графики или их фрагменты на принтер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПД-9-02
Диапазон измерений, °С	400...1400
Спектральный диапазон, мкм	0.9...1.7
Пределы допускаемой основной погрешности, °С, при доверительной вероятности 0,95	0,0028 t + 0,5
Разрешающая способность, °С	0.01
Показатель визирования	1:100
Температура окружающей среды, °С	20 ± 2
Коррекция излучательной способности	0.1-1.5, шаг 0.001
Степень защиты от пыли и воды	IP00
Напряжение питания, В	24 ± 0,5
Потребляемая мощность, Вт	8
Масса пирометра, кг	1,0
Габаритные размеры, мм	207,5x75,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ:	Кол-во	Примечание
Пирометр ПД-9-02	1 шт.	
Руководство по эксплуатации ДДШ2.820.019 РЭ	1 экз.	
Методика поверки МП 2412-0020-2009	1 экз.	
Паспорт ДДШ2.820.019 ПС	1 экз.	
Кабель связи с ЭВМ ДДШ6.644.090	1 шт.	
Кабель питания ДДШ6.644.121	1 шт.	
Кабель ДДШ6.644.120	1 шт.	
Блок питания БПС-24-03 ДДШ2.087.006-01	1 шт.	По заявке потребителя
Программное обеспечение "Piro Visual"	1 комплект	CD-диск

**ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Пирометр ПД-9-02»

**АБСОЛЮТНО ЧЕРНЫЕ ТЕЛА (АЧТ)**

Излучатели в виде моделей абсолютно черного тела (АЧТ) предназначены для настройки, градуировки, калибровки и поверки пирометров и пирометрических преобразователей со спектральными характеристиками, расположенными в любой области спектра.

**ИЗЛУЧАТЕЛЬ В ВИДЕ МОДЕЛИ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА  
АЧТ 70/-40/80**



**МКСН.065142.003 ТУ**

АЧТ 70/-40/80 зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений под № 69533-17. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.670 № 68174.



Декларация ЕАЭС № RU Д-РУ.РА04.В.32902/22 от 21.06.22 о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".



АЧТ 70/-40/80 является эталонным излучателем в виде модели абсолютно черного тела не ниже второго разряда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АЧТ 70/-40/80
Диапазон воспроизводимых температур, °С	минус 40* ... 80
Используемый блок управления	БУ-10
Коэффициент излучения полости, не менее	0,997
Диаметр излучающей полости, мм	70
Глубина излучающей полости, мм	270
Разряд	2-ой
Время выхода излучателя с (20±5) °С на указанные стационарные режимы должно быть, мин, не более: 50 °С; 80 °С; минус 10 °С минус 40 °С	35 90
Время перехода с одного стационарного режима на другой, мин, не более	25
Дрейф температуры излучателя за 15 минут для стационарного режима поддержания температуры, °С, не более	±0,1
Нестабильность поддержания температуры излучателя в стационарном режиме в течение 15 минут, °С, не более	0,1
Доверительная погрешность излучателя при доверительной вероятности 0,95, °С, не более от минус 40°С до 0°С от 0°С до плюс 80 °С где $t_{уст}$ – установленная температура, °С	±1,0 ±(1+0,004· $t_{уст}$ )
Связь с ЭВМ	RS-232
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4.1 с категорией размещения 4.2
Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха, °С Относительная влажность воздуха, % Давление, кПа	20±5 от 20 до 80 от 84 до 106,7 (от 630 до 800 мм рт. ст.)
Питание	~ 220 В; 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВ·А	1,0
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	3000
Средний срок службы, лет, не менее	5
Габаритные размеры, мм, не более - излучателя теплового ИТ - блока управления БУ-10	455x230x375 455x160x375
Масса излучателя, кг, не более: - излучателя теплового ИТ - блока управления БУ-10	12,0 9,5
* При окружающей температуре не более 20 °С	



АЧТ 70/-40/80

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Излучатель в виде модели абсолютно черного тела АЧТ 70/-40/80 (в дальнейшем – АЧТ, излучатель) предназначен для настройки, поверки и калибровки средств бесконтактного измерения температуры (пирометров полного и частичного излучения, сканирующих пирометров и тепловизионных систем) в диапазоне температур от минус 40 до плюс 80 °С в лабораторных и цеховых условиях.

Излучатель является стационарным, однофункциональным, ремонтируемым в условиях предприятия-изготовителя изделием.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:	Кол-во
излучатель тепловой ИТ МКСН.418236.002	1 шт.
блок управления БУ-10 МКСН.405544.031	1 шт.
кабель МКСН.434641.028 (ХТ1)	1 шт.
кабель ДДШ6.644.033 (ХТ2)	1 шт.
кабель сетевой SCZ-1.220В.10А (ХТ3)	1 шт.
крышка МКСН.301251.032	1 шт.
руководство по эксплуатации МКСН.065142.003 РЭ	1 экз;
методика поверки МП	1 экз;

**ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:**

«Излучатель в виде модели абсолютно черного тела АЧТ 70/-40/80 МКСН.065142.003 ТУ»



**ИЗЛУЧАТЕЛИ В ВИДЕ МОДЕЛИ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА  
АЧТ-165/40/100 И АЧТ-45/100/1100**



**АЧТ-165/40/100 выпускается по ТУ 4276-067-02566540-2006**

**АЧТ-45/100/1100 выпускается по ТУ 4276-001-02566540-2004**

АЧТ-45/100/1100 зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений под 40099-08.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.32.010.А №34679/1.



**АЧТ-165/40/100 и АЧТ-45/100/1100 являются эталонными излучателями в виде модели абсолютно черного тела не ниже 2-ого разряда.**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

**АЧТ-165/40/100** предназначено для градуировки и поверки пирометров в диапазоне температур 40...95°C в лабораторных и цеховых условиях.

АЧТ-165/40/100 состоит из

- излучателя теплового ИТ,
- блока управления БУ-7-5,
- эталонного термометра сопротивления ЭТС-100
- измерителя универсального прецизионного В7-99.

Блок управления поддерживает температуру в рабочей зоне ИТ примерно в соответствии с заданной. Точное значение температуры АЧТ определяется по измеренному В7-99 значению сопротивления ЭТС-100, пересчитанному в значение температуры.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

**АЧТ-45/100/1100** предназначено для градуировки и поверки пирометров в диапазоне температур 300...1100°C в лабораторных и цеховых условиях.

АЧТ-45/100/1100 состоит из

- печи трубчатой ПТ,
- блока управления БУ-7-4,
- эталонного преобразователя термоэлектрического ППО (2-го разряда),
- термостата нулевого ДДШ 5.868.003
- прецизионного милливольтметра В7-99.

Блок управления поддерживает температуру в рабочей зоне ПТ примерно соответствующей заданной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АЧТ-165/40/100	АЧТ-45/100/1100
Диапазон воспроизводимых температур, °С	40 ...95	300 ...1100
Используемый блок управления	БУ-7-5	БУ-7-4
Коэффициент излучательной способности	0,99	
Апертура (диаметр выходного отверстия полости излучения), мм, не менее	165	45
Разряд	2-ой	
Доверительная погрешность воспроизведения температуры при доверительной вероятности 0,95, не более	1°C+0,6% от установленной температуры	
Погрешность поддержания температуры в стационарном режиме, °С, не более	±0,15	±0,5
Дрейф температуры излучателя за 15 минут, °С, не более	0,1	0,25
Время выхода на стационарный режим, мин, не более	от 40 до 60 °С, 50 мин	120 мин
	от 60 до 95 °С, 90 мин	
Время перехода с одного стационарного режима на другой в диапазоне температур, мин, не более	от 40 до 95 °С 50 мин	от 300 до 600 °С, 120 мин
		от 600 до 1100 °С, 120 мин
Разрешающая способность индикации температуры (на блоке управления), °С	0,01	0,001 (до 999,999°C) 0,01 (свыше 1000,01°C)
Связь с ЭВМ	RS-232 (передается значение температуры, измеренное блоком управления)	
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1	
Температура окружающего воздуха, °С	20±5	
Питание	~ 220 В; 50 Гц	
Потребляемая мощность, кВт, не более	3	5
Габаритные размеры*, мм, не более		
- излучателя теплового ИТ	332x440x620	-
- печи трубчатой ПТ	-	200x340x800
- блока управления	241x110x370	
- термостата нулевого	-	Ø200x265
- В7-99	270x110x360	-
Масса*, кг, не более:		
- излучателя теплового ИТ (без теплоносителя)	20	-
- печи трубчатой ПТ	-	25
- блока управления	4,5	4,5
- термостата нулевого	-	2,5
- В7-99	5	-

\* масса и габариты В7-54/3, ЭТС-100, ППО не указаны



**КОМПЛЕКТНОСТЬ АЧТ-165/40/100:**

- излучатель тепловой ИТ;
- блок управления БУ-7-5;
- эталонный термометр сопротивления ЭТС-100;
- кабели соединительные (3 шт.);
- руководство по эксплуатации.
- кабель интерфейсный ДДШ 6.644.033;
- программное обеспечение 643.02566540.00019-01, позволяющее отображать график работы АЧТ в режиме реального времени на компьютере.

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- измеритель универсальный прецизионный В7-99 (универсальный вольтметр В7-54/3 или омметр Щ306/1)\*.

\*Допускается вместо В7-99 использовать другие приборы класса точности не хуже 0,01 с разрешающей способностью не более 0,01 Ом на пределе измерения 1 кОм.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ АЧТ-45/100/1100:**

- печь трубчатая ПТ;
- никелевая излучающая вставка для печи ПТ;
- диафрагмы (10 мм и 20 мм) (2 шт.) - применяются при проверке показателя визирования пирометров;
- блок управления БУ-7-4;
- эталонный термопреобразователь ППО-2-1250-01 (2-го разряда с градуировкой от 300°С до 1200°С);
- термостат нулевой ДДШ 5.868.003 (для компенсации холодных концов ППО);
- руководство по эксплуатации;
- программное обеспечение 643.02566540.00019-01, позволяющее отображать график работы АЧТ в режиме реального времени на компьютере.

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- прецизионный милливольтметр В7-99\*\*;
- кабель интерфейсный ДДШ 6.644.033.

\*\* При использовании В7-99 - температура автоматически отображается на дисплее прибора.

АЧТ-165/40/100



излучатель тепловой ИТ



БУ-7-5



В7-99

АЧТ-45/100/1100



печь трубчатая ПТ с установленной диафрагмой

БУ-7-4

термостат нулевой ДДШ 5.868.003



В7-99

**ИЗЛУЧАТЕЛЬ В ВИДЕ МОДЕЛИ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА АЧТ-30/900/2500****ТУ4276-083-02566540-2007**АЧТ-30/900/2500 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под 38818-08.  
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.E.32.010.A №33044.**УНИКАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ:***По своим характеристикам данное АЧТ не имеет российских и импортных аналогов, производимых серийно.*

Излучающая полость для такого широкого диапазона воспроизводимых температур (900...2500°C) имеет достаточно большую апертуру (диаметр) выходного отверстия (30 мм) и требуемый коэффициент излучательной способности (0,99).

**АЧТ-30/900/2500 является эталонным излучателем в виде модели абсолютно черного тела не ниже второго разряда.****НАЗНАЧЕНИЕ:**

АЧТ-30/900/2500 предназначено для градуировки, калибровки и поверки рабочих средств измерения температуры (пирометров и пирометрических преобразователей полного излучения, частичного излучения и спектрального отношения) в диапазоне температур от 900 до 2500°C в лабораторных условиях.

**Краткое ОПИСАНИЕ:**

АЧТ-30/900/2500 реализует модель "абсолютно черного тела" с автоматическим поддержанием температуры излучающей полости и атмосферой инертного газа (аргона) внутри и представляет собой эталонную меру температуры переменного значения в диапазоне от 900 до 2500°C для бесконтактных средств измерения температуры.

При замене излучающей полости на заказываемый дополнительно нагреватель специальной конструкции, имеющий пенал для размещения ампул реперных точек, АЧТ-30/900/2500 может использоваться как печь нагрева ампул для воспроизведения реперных точек плавления (затвердевания) чистых металлов (Ag, Cu, Au, Pt и др.).

АЧТ-30/900/2500 выполнено в виде моноблока, состоящего из высокотемпературной печи и шкафа управления (ШУ). Внутри высокотемпературной печи поддерживается атмосфера инертного газа (аргона), поступающего из баллона (баллон с аргоном и редуктор к нему в КОМПЛЕКТНОСТЬ не входят и приобретаются потребителем самостоятельно). Для охлаждения используется проточная вода. АЧТ имеет систему защиты, автоматически выключающую АЧТ при прерывании подачи аргона или воды, а также при перегреве печи. Для устранения влияния внешних факторов на процесс поверки (градуировки, калибровки) выходное отверстие печи прикрывается (на фото не показано) внешней диафрагмой. Конструкция АЧТ имеет возможность быстрой замены излучающей полости, расположенной внутри печи (не более 15-20 минут после остывания излучающей полости).

Температурой излучателя управляет оптоволоконный быстродействующий пирометр, расположенный на лицевой панели шкафа управления (ШУ) и обеспечивающий необходимую точность поддержания температуры полости излучения.

Управление температурными режимами излучателя осуществляется как с клавиатуры пирометра так и с ЭВМ, посредством интерфейсного соединения.

Индикация текущей температуры отображается на дисплее пирометра, а также в графическом и цифровом режиме на мониторе ЭВМ.

Для точного определения температуры в рабочей зоне АЧТ используется эталонный пирометр ПД-4-06 (1-го разряда). Значение температуры, измеренное эталонным пирометром ПД-4-06, отображается на компьютере, к которому подключается ПД-4-06.

АЧТ-30/900/2500



АЧТ может работать в двух режимах - автоматическом и ручном. При выборе автоматического режима работы пользователь задает требуемое значение температуры. При выборе ручного режима работы пользователь сам задает значение подаваемой мощности, влияющее на скорость нагрева и на конечное значение температуры.

Простота в управлении и наличие ручного режима работы создают дополнительное удобство при использовании АЧТ-30/900/2500 в качестве оборудования для проведения экспериментальных и научно-исследовательских работ.

На время транспортирования внешняя диафрагма демонтируется и устанавливается на АЧТ-30/900/2500 непосредственно на месте эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ в таблице приведены для автоматического режима работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	АЧТ-30/900/2500
Диапазон воспроизводимых температур, °С	900...2500
Коэффициент излучательной способности	0,99
Апертура (диаметр выходного отверстия полости излучения), мм., не менее	30
Разряд	2-ой
Доверительная погрешность воспроизведения температуры при доверительной вероятности 0,95, % от установленной температуры, не более	0,5
Погрешность поддержания температуры в стационарном режиме, °С, не более	±0,5
Дрейф температуры излучателя за 15 минут, °С, не более:	
- в диапазоне 900...1700°С	0,25
- в диапазоне 1700...2500°С	0,3
Время выхода на стационарный режим для температур, мин, не более:	
- 900°С	20
- 1700°С	40
- 2500°С	60
Время перехода с одного стационарного режима на другой, мин, не более:	
- от 900 до 1700°С	25
- от 1700 до 2500°С	25
Тип нагревательного элемента	графитовый трубчатый нагреватель переменного сечения с продувкой аргоном
Расход аргона, л/мин	0,55...0,75
Охлаждение	водяное
Скорость потока воды в системе охлаждения, л/мин	5...6
Связь с ЭВМ	RS-232 (два канала связи, включая канал связи ПД-4-06)
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1 с категорией размещения 4.2
Температура окружающего воздуха, °С	20±5
Питание	трехфазная сеть, ~ 380 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более	20
Габаритные размеры излучателя (без установленных внешней диафрагмы и пирометра обратной связи), мм, не более	512×1230×750
Масса, кг, не более	250

#### ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АЧТ-30/900/2500:

На этапе моделирования и оптимизации конструкторских решений в работе над АЧТ-30/900/2500 принимали участие ведущие специалисты по температурным измерениям в области бесконтактной термометрии Всероссийского научно-исследовательского института им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ, С-Петербург), а также специалисты института высоких температур (ИВТАН, Москва).

Первый образец излучателя АЧТ-30/900/2500, разработанный по техническому заданию ВНИИМ для использования как средство измерений в составе первичного эталона температуры для бесконтактных средств измерений для диапазона от 900 до 2500°С, был проверен в ВНИИМ на соответствие заявленным характеристикам и использовался для реализации точек фазового перехода (плавления - затвердевания) чистых металлов в составе государственного эталона при проведении сличений среди национальных лабораторий (Франция, Германия и др.) в целях обеспечения единства измерений в соответствии с международной температурной шкалой МТШ-90.

На сегодняшний момент излучатель с установленным нагревателем специальной конструкции, имеющий пенал для размещения ампул реперных точек, применяется во ВНИИМ для исследования новых точек фазовых переходов плавления и затвердевания высокотемпературных эвтектик для дальнейшего построения и корректировки шкалы МТШ-90.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- излучатель (моноблок);
- внешняя диафрагма;
- кабель интерфейсный ДДШ 6.644.090;
- программное обеспечение 643.02566540.007-01 (CD диск);
- комплект ЗИП:
  - патрубок (2шт.) (сменные детали для излучающей полости);
  - экстрактор (приспособление для замены нагревателя);
  - набор отверток и торцевых головок;
- кабель сетевой;
- руководство по эксплуатации.

#### ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:

- пирометр эталонный ПД-4-06 (1-го разряда)\*;
- набор шлангов для подключения воды и аргона.

\* Допускается вместо эталонного пирометра ПД-4-06 (1-го разряда) использовать другой пирометр, обеспечивающий характеристики не хуже, чем у данного пирометра.

*Примечание - Баллон с аргоном и редуктор к нему в КОМПЛЕКТНОСТЬ не входят и приобретаются потребителем самостоятельно.*



**ИЗЛУЧАТЕЛЬ В ВИДЕ МОДЕЛИ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА АЧТ 75/50/600 РАЗРАБОТКА****НАЗНАЧЕНИЕ:**

Излучатель в виде модели абсолютно черного тела АЧТ 75/50/600 предназначен для настройки, поверки и калибровки средств бесконтактного измерения температуры (пирометров и пирометрических преобразователей полного излучения, частичного излучения и спектрального отношения) в диапазоне температур от 50 до 600 °С в лабораторных и цеховых условиях. АЧТ 75/50/600 представляет собой моноблочную конструкцию, в одном корпусе размещаются излучатель, силовые элементы, микропроцессорный регулятор температуры, индикатор и кнопки управления.

АЧТ 75/50/600



Технические характеристики	АЧТ 75/50/600
Диапазон воспроизводимых температур, °С	50 до 600
Диаметр излучающей полости, мм	75
Коэффициент излучения полости, не менее	0,998
Полость должна обеспечивать визирование пирометров с оптическим разрешением	12:1 и более
Нестабильность поддержания температуры излучателя в стационарном режиме в течение 15 минут, °С, не более	±0,1
Дрейф температуры излучателя за 15 минут для стационарного режима поддержания температуры, °С, не более	±0,1
Доверительная погрешность излучателя при доверительной вероятности 0,95, °С не более	±(1,23...3,3)
Время выхода в режим стабилизации температуры, мин., не более	60
Время перехода с одного стационарного режима на другой, мин., не более	60
Дискретность задания температуры, °С	0,1
Разрешающая способность индикатора температуры, °С	0,001
Связь с ПК по интерфейсу	RS-232
Максимальная потребляемая мощность, кВ·А, не более	3,0
Габаритные размеры, мм, не более	815x230x415
Масса, кг, не более	25

**ИЗЛУЧАТЕЛЬ В ВИДЕ МОДЕЛИ ПРОТЯЖЕННОГО ЧЕРНОГО ТЕЛА ПЧТ-540/40/100**



**ТУ 4276-002-02566540-2003**

Тип средства измерения зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 26476-10.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

ПЧТ-540/40/100 предназначено для проверки диапазона измерения и определения погрешности тепловизионных приборов (тепловизионных и термографических систем, сканирующих пирометров, тепловизоров и других средств бесконтактного контроля температуры) в диапазоне температур от 30 до 95 °С, а также определения с использованием мир угла поля зрения и геометрических параметров разрешения по горизонтали и вертикали данных тепловизионных приборов.

**Краткое ОПИСАНИЕ:**

Основными составными частями излучателя в виде модели протяженного черного тела ПЧТ-540/40/100 являются:

- излучатель протяженный тепловой ИПТ;
- блок управления БУ-7-8;
- эталонный термометр сопротивления ЭТС-100;
- измеритель универсальный прецизионный В7-99;
- набор мир: крестовая, щелевая и круговая.

ИПТ выполнен в металлическом корпусе, с лицевой стороны которого расположена излучающая поверхность, которая имеет специальное глубокоматовое покрытие, обеспечивающее заданный коэффициент излучательной способности. В находящийся внутри ИПТ резервуар через горловину, расположенную в его верхней части, заливается теплоноситель - дистиллированная вода (около 18,5 л). Уровень теплоносителя при этом контролируется по указателю уровня, расположенному на боковой стенке ИПТ.

Поддержание температуры излучающей поверхности ПЧТ-540/40/100 поддерживается путем регулирования температуры теплоносителя.



ИПТ-540/40/100 и мира круговая с переменной щелью ДДШ 3.897.003



В7-99



БУ-7-8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЧТ-540/40/100
Диапазон воспроизводимых температур, °С	30*...95
Коэффициент излучательной способности, не менее	0,96
Размеры излучающей поверхности, мм	540x540
Доверительная погрешность излучателя при доверительной вероятности 0,95, °С, не более	1,1
Неравномерность температуры излучающей поверхности относительно центра, °С, не более:	
- в диапазоне 30...50 °С	±1
- в диапазоне 50...95 °С	±2
Погрешность поддержания температуры в стационарном режиме за 15 мин, °С, не более	± 0,15
Дрейф температуры излучателя за 15 минут для стационарного режима поддержания температуры, °С, не более	± 0,1
Время выхода излучателя на стационарный режим, мин, не более, для температур:	
- от 30 до 60 °С	50
- от 60 до 95 °С	90
Время перехода с одного стационарного режима на другой, в диапазоне от 30 до 95 °С мин, не более	50
Связь с ЭВМ	RS-232 (передается значение температуры, измеренное блоком управления)
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1 с категорией размещения 4.2
Температура окружающего воздуха, °С	20±5
Питание	~ 220 В; 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более	4,8
Габаритные размеры, мм, не более:	
- ИПТ	696x690x320
- БУ-7-8	245x110x360
- мира с переменной щелью	665x610x70
- мира с метками	600x600x1
- мира круговая с переменной щелью	610x610x61
Масса, кг, не более:	
- ИПТ без теплоносителя	60
- БУ-7-8	4,5
- мира с переменной щелью	8
- мира с метками	3
- мира круговая с переменной щелью	5
*при окружающей температуре не более 20 °С	



**УНИКАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ:** ПЧТ-540/40/100 не имеет российских аналогов.

На сегодняшний день ПЧТ-540/40/100 является единственным в России средством поверки, калибровки и градуировки тепловизоров и сканирующих пирометров.

Блок управления БУ-7-8 при помощи датчика, расположенного в резервуаре, определяет приближенное значение температуры теплоносителя и поддерживает температуру теплоносителя, примерно соответствующую заданной. За счет использования внутри резервуара теплового экрана специальной конструкции и системы принудительного перемешивания жидкости температура излучающей поверхности поддерживается практически равной температуре теплоносителя, и обеспечивается заданный градиент температуры по излучающей поверхности.


Точное значение температуры излучающей поверхности измеряется при помощи эталонного термометра сопротивления ЭТС-100, который устанавливается в специальный колодезь. Для определения температуры производится измерение сопротивления ЭТС-100 при помощи измерителя универсального прецизионного В7-99, затем значение сопротивления пересчитывается в значение температуры.

**ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЧТ-540/40/100:**


В процессе моделирования и разработки конструкции ПЧТ-540/40/100 принимали участие ведущие специалисты по температурным измерениям в области бесконтактной термометрии Всероссийского научно-исследовательского института им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ, С-Петербург).

Первый образец излучателя ПЧТ-540/40/100 с комплектом мир был изготовлены в 2001 году по техническому заданию ВНИИМ для использования как средство измерений технических характеристик тепловизионных систем, а также как средство их поверки. Данный образец ПЧТ-540/40/100 был проверен во ВНИИМ на соответствие заявленным техническим характеристикам.



На сегодняшний момент ПЧТ-540/40/100 применяется во ВНИИМ для исследования технических характеристик тепловизионных приборов.



Мира с переменной щелью

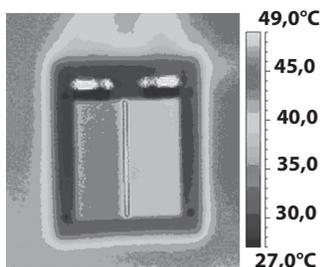

Вид на экране тепловизора Thermovision 470 фирмы AGEMA щелевой и крестовой миры на фоне излучающей поверхности ПЧТ-540/40/100

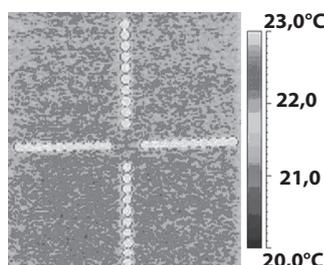

Мира с метками



ИПТ-540/40/100 и мира с переменной щелью



ИПТ-540/40/100 и мира с метками

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:**

- тепловой излучатель ИПТ 540/40/100;
- блок управления БУ-7-8;
- мира с переменной щелью ДДШ 3.897.001;
- мира с метками ДДШ 7.216.002;
- мира круговая с переменной щелью ДДШ 3.897.003;
- эталонный термометр ЭТС-100;
- кабели соединительные (3 шт.);
- методика поверки;
- руководство по эксплуатации;
- программное обеспечение 643.02566540.00019-01, позволяющее отображать график работы ПЧТ в режиме реального времени на компьютере;
- кабель интерфейсный ДДШ 6.644.033.

**ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:**

- измеритель универсальный прецизионный В7-99 (универсальный вольтметр В7-54/3 или омметр Щ306/1)\*.
- \* Допускается вместо В7-99 использовать другие приборы класса точности не хуже 0,01 с разрешающей способностью не более 0,01 Ом на пределе измерения 1 кОм.



## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

### ОБЪЕКТ-МИКРОМЕТР ОМ-О, ОМ-П





**ТУ 4381-018-02566540-2004**

Тип средства измерения зарегистрирован  
в Федеральном информационном фонде по обеспечению  
единства измерений под № 28962-16.


#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Объект-микрометры ОМ предназначены для определения увеличения поля зрения микроскопов, проекторов, цены деления окулярных шкал и сеток.

Изготавливаются в виде двух исполнений - для отраженного света (ОМ-О) и для проходящего света (ОМ-П).

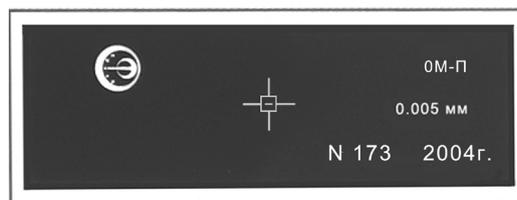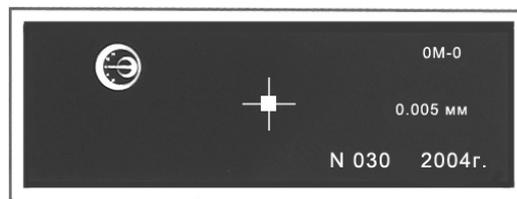

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОМ
Длина основной шкалы, мм	1±0,0005
Расстояние между серединами соседних штрихов первых десяти интервалов основной шкалы, мм	0,005±0,0003
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ОМ, мм	±0,0001
Ширина штрихов шкалы, мм	0,002±0,0005
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2
Габаритные размеры (без футляра), мм, не более	80x30x3
Масса (без футляра), кг, не более	0,035

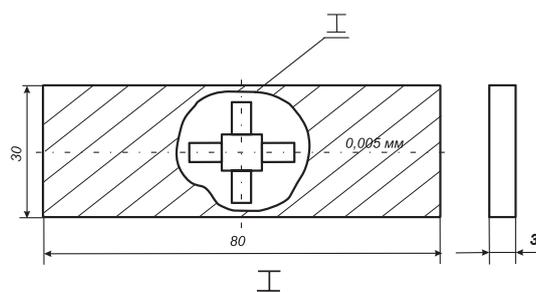


#### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- объект микрометр;
- футляр;
- упаковка;
- паспорт;
- методика поверки.



#### ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«Объект-микрометр ОМ-П»

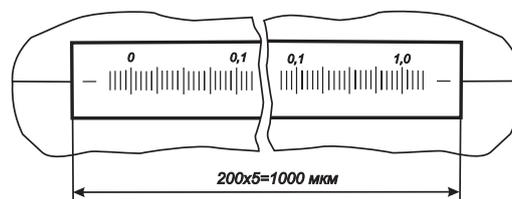


# ФИЛЬТРЫ НА ПАВ

## ФИЛЬТРЫ НА ПАВ

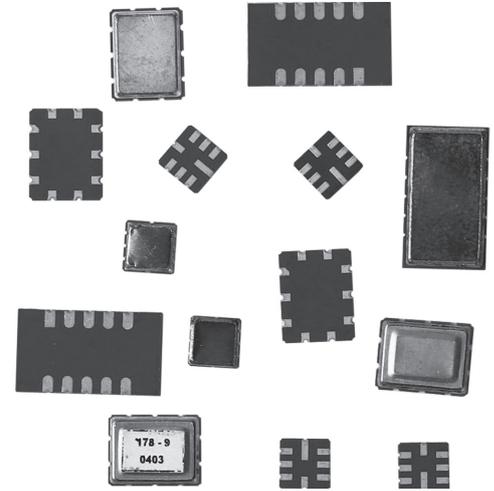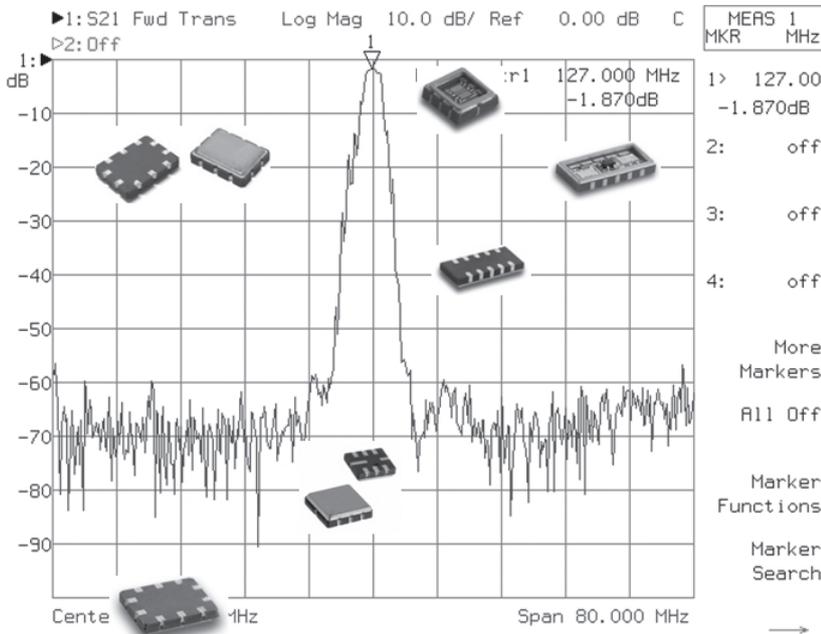

Фильтры на ПАВ

### Типы корпусов и схемы включения

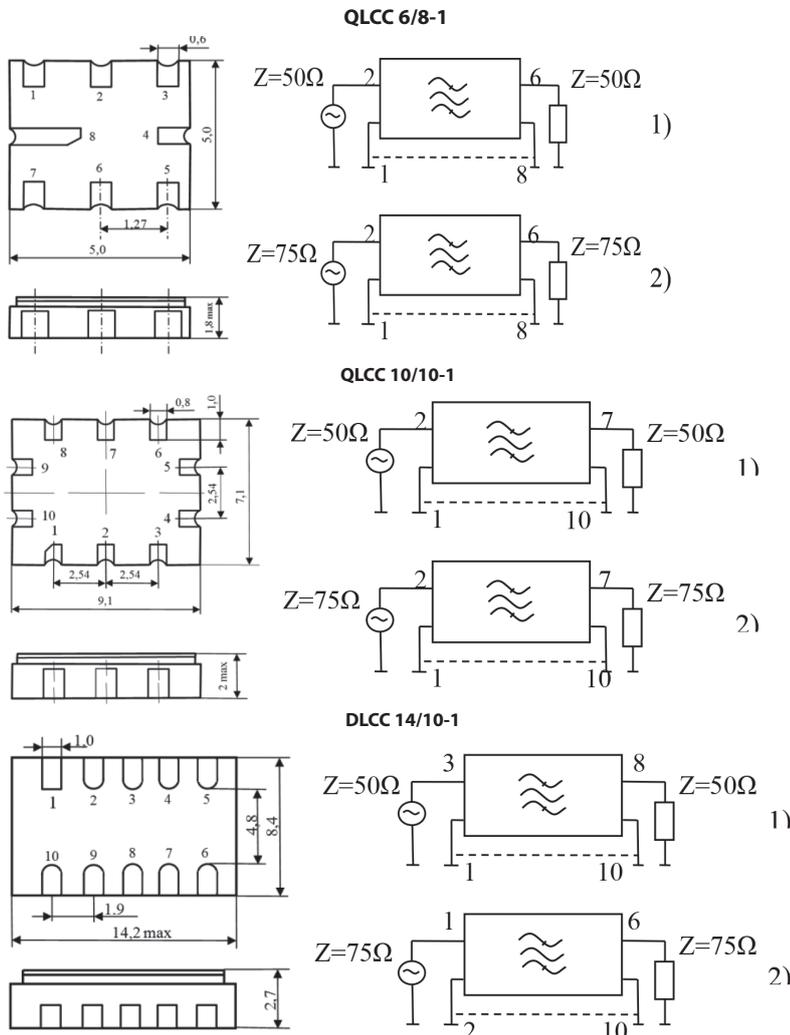

АО «НПП «Эталон» более 30 лет занимается разработкой и изготовлением фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ) с малыми потерями. Технологическая база АО «НПП «Эталон» на основе участка микроэлектроники, имеющего всю необходимую инфраструктуру, позволяет осуществлять полный цикл производства, включая разработку, изготовление фотошаблонов и кристаллов, а также сборку и тестирование устройств.

Устройства на поверхностных акустических волнах (ПАВ) являются ключевыми элементами современных средств телекоммуникаций, широко используются во входных каскадах мобильных и носимых радиостанций, в преселекторах и каскадах ПЧ современных приемников.

АО «НПП «Эталон» разрабатывает и производит фильтры на ПАВ с малыми потерями 1-5 дБ и ПАВ-микросборки с высокой избирательностью 80-90 дБ. Фильтры на ПАВ, изготовленные АО «НПП «Эталон», имеют малые габариты, не требуют согласования и настройки, совместимы с технологией поверхностного монтажа. Компьютерное моделирование, современная измерительная техника, высокотехнологичная база позволяют вести разработки ПАВ-компонентов на уровне лучших мировых образцов в широком диапазоне частот.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- входные и выходные каскады мобильных радиостанций;
- входные каскады профессиональных приемников;
- каскады ПЧ для фильтрации широкополосных и узкополосных сигналов.



Условное обознач. фильтра	Центр. частота $f_c$ , МГц				Полоса @-3 дБ, МГц		Потери, дБ		Подавление, дБ	ТКЧ $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$		Тип корпуса		Схема вкл.	Тип АЧХ		
1	2				3		4		5	6		7		8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФПА1-70-6	70±0,2	5,6	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	8	ФПА1-156-2А	156±0,2	2,2	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1
ФПА1-73-6	73±0,2	5,7	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	8	ФПА1-156-2Б	156±0,2	2,2	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-75-4	75,3±0,2	3,6	3,0	32	-67	DLCC 14/10-1	2	7	ФПА1-157-2А	157,1±0,2	2,3	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1
ФПА1-75-6	75±0,2	5,7	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	8	ФПА1-157-2Б	157±0,2	2,3	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-76-6	75,6±0,2	5,7	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	8	ФПА1-158-13	158,0±0,3	12,5	5,2	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8
ФПА1-77-6	77±0,2	5,8	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	8	ФПА1-159-7	159,3±0,3	7,8	4,5	50	-67	QLCC 10/10-1	2	6
ФПА1-78-6	78±0,2	5,8	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	8	ФПА1-160-12	160,4±0,4	12,0	5,2	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8
ФПА1-79-6	79,3±0,2	5,9	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	8	ФПА1-160-2Б	160±0,2	2,3	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-92-7	92±0,2	7,0	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	8	ФПА1-161-2	160,8±0,2	2,3	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-96-2	96±0,1	1,7	1,5	28	-75	DLCC 14/10-1	1	1	ФПА1-161-5	161±0,2	4,4	5,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	4
ФПА1-96-5	96,5±0,2	4,3	4,0	55	-67	DLCC 14/10-1	2	6	ФПА1-161-8Б	161,0±0,3	7,3	4,3	50	-67	QLCC 10/10-1	2	6
ФПА1-96-6	96,3±0,2	6,3	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	8	ФПА1-162-2А	162±0,2	2,3	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1
ФПА1-103-8	102,5±0,3	7,9	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	8	ФПА1-162-2Б	162±0,3	2,3	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-110-2	110,0±0,1	1,8	3,0	55	-75	DLCC 14/10-1	1	2	ФПА1-163-13	163,3±0,4	12,5	5,2	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8
ФПА1-111-5	111,2±0,2	5,3	4,0	55	-67	DLCC 14/10-1	2	6	ФПА1-163-2А	163,1±0,2	2,3	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1
ФПА1-113-9	113±0,3	9,0	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	6	ФПА1-163-2Б	163±0,2	2,4	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-116-6	116±0,2	5,6	4,0	55	-67	DLCC 14/10-1	2	6	ФПА1-163-5	163±0,2	4,4	5,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	4
ФПА1-117-8	117,4±0,3	7,9	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	8	ФПА1-164-2	164,5±0,2	2,4	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1
ФПА1-118-6	118±0,2	5,7	4,0	55	-67	DLCC 14/10-1	2	6	ФПА1-165-13Б	165±0,4	13,0	5,2	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8
ФПА1-118-9	118±0,3	8,0	4,7	55	-67	DLCC 14/10-1	2	6	ФПА1-165-2А	165,2±0,2	2,4	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1
ФПА1-119-6	119±0,2	5,8	4,0	55	-67	DLCC 14/10-1	2	6	ФПА1-165-2Б	165,2±0,2	2,3	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-121,5-2Б	121,5±0,2	1,9	2,8	55	-75	QLCC 10/10	1	2	ФПА1-165-5	165±0,2	4,4	5,2	50	-75	QLCC 10/10-1	1	4
ФПА1-122-2А	122,2±0,1	1,7	1,7	28	-75	DLCC 14/10-1	1	1	ФПА1-165-8Б	165±0,3	7,4	4,3	50	-67	QLCC 10/10-1	2	6
ФПА1-122-2Б	122±0,1	1,9	3,0	55	-75	DLCC 14/10-1	1	2	ФПА1-166-2Б	166,2±0,2	2,4	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-123-2	123±0,1	1,7	1,7	28	-75	DLCC 14/10-1	1	1	ФПА1-166-5	166±0,2	4,4	5,2	50	-75	QLCC 10/10-1	1	4
ФПА1-127-2	126,8±0,1	1,9	1,7	28	-75	DLCC 14/10-1	1	1	ФПА1-167-2	167±0,2	2,4	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-127-2Б	127,2±0,1	1,8	3,0	55	-75	DLCC 14/10-1	1	2	ФПА1-168-16	168,3±0,4	15,3	5,2	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8
ФПА1-127-4	127,3±0,2	3,5	5,0	55	-75	DLCC 14/10-1	1	4	ФПА1-168-2	168,1±0,2	2,5	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-135-4	135±0,2	3,6	5,0	55	-75	DLCC 14/10-1	1	4	ФПА1-169-2	169±0,2	2,5	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1
ФПА1-137-2	137±0,1	2,2	3,0	55	-75	DLCC 14/10-1	1	2	ФПА1-170-2Б	170±0,2	2,5	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-145-2А	145±0,2	2,1	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1	ФПА1-170-8	170±0,3	7,5	4,3	50	-67	QLCC 10/10-1	2	6
ФПА1-145-2Б	145±0,2	2,2	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2	ФПА1-171-2	171±0,2	2,5	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1
ФПА1-146-2	146±0,2	2,1	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1	ФПА1-171-8	171±0,3	7,6	4,3	50	-67	QLCC 10/10-1	1	6
ФПА1-147-10	146,8±0,3	10,8	5,2	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8	ФПА1-172-2А	172±0,2	2,5	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1
ФПА1-147-2	147±0,2	2,1	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1	ФПА1-172-2Б	172±0,2	2,6	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-148-2	148±0,2	2,1	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1	ФПА1-172-5	172,2±0,2	4,6	5,2	50	-75	QLCC 10/10-1	1	4
ФПА1-149,5-2Б	149,4±0,2	2,2	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2	ФПА1-173-3	173,4±0,2	2,5	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-149-2А	149±0,2	2,1	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1	ФПА1-175-5	175,1±0,3	4,6	5,2	50	-75	QLCC 10/10-1	1	4
ФПА1-149-2Б	149±0,2	2,2	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2	ФПА1-178-16	178±0,4	15,6	5,2	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8
ФПА1-149-5	149,4±0,2	4,1	5,0	50	-75	DLCC 14/10-1	1	4	ФПА1-178-9	178±0,3	8,5	4,3	50	-67	QLCC 10/10-1	2	6
ФПА1-150-13	150,0±0,3	12,7	5,2	50	-67	QLCC 10/10-1	1	8	ФПА1-185-3	185±0,2	2,7	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1
ФПА1-150-2А	150±0,2	2,2	1,7	28	-75	QLCC 10/10-1	1	1	ФПА1-187-17	187±0,4	17,0	5,2	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8
ФПА1-150-5	150±0,2	4,1	5,0	50	-75	DLCC 14/10-1	1	4	ФПА1-187-9	187±0,3	8,6	4,3	50	-67	QLCC 10/10-1	2	6
ФПА1-151-5	151±0,2	4,2	5,0	50	-75	DLCC 14/10-1	1	4	ФПА1-189-17	189±0,4	17,6	5,2	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8
ФПА1-151-8	150,8±0,3	7,8	4,3	50	-67	QLCC 10/10-1	2	6	ФПА1-200-11	200±0,3	10,4	4,3	50	-67	QLCC 10/10-1	2	6
ФПА1-153-13А	152,5±0,5	12,7	5,0	28	-67	QLCC 10/10-1	2	7	ФПА1-200-3	199,8±0,3	2,8	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-153-13Б	152,5±0,5	12,5	5,2	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8	ФПА1-202-12	202±0,3	10,2	4,5	50	-67	QLCC 10/10-1	2	6
ФПА1-153-2	153,0±0,2	2,3	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2	ФПА1-202-16	202±0,6	15,0	5,5	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8
ФПА1-154-13	154,5±0,4	12,5	5,2	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8	ФПА1-202-3	202±0,3	2,9	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-154-2	154±0,2	2,3	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2	ФПА1-203,5-16	203,1±0,6	15,1	5,5	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8
ФПА1-154-5	154±0,2	4,2	5,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	4	ФПА1-203,5-9	203,5±0,3	9,6	4,3	50	-67	QLCC 10/10-1	2	6
ФПА1-155-5	155,2±0,2	4,3	5,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	4	ФПА1-203-3	203,3±0,3	3,0	3,0	50	-75	QLCC 10/10-1	1	2



1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФПА1-203-5	203±0,3	4,5	3,0	45	-40	QLCC 10/10-1	1	9
ФПА1-205-10	205,0±0,3	9,8	4,3	50	-67	QLCC 10/10-1	2	6
ФПА1-207-15	206,8±0,6	15,1	5,5	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8
ФПА1-209-16	208,8±0,6	15,2	5,5	50	-67	QLCC 10/10-1	2	8
ФПА1-209-3Б	209±0,3	3,2	3,0	50	75	QLCC 10/10-1	1	2
ФПА1-210-5	209,7±0,3	5,5	5,2	50	-75	QLCC 10/10-1	1	4
ФПА1-218-11	218±0,3	10,5	4,5	50	-67	QLCC 10/10-1	2	6
ФПА1-235-12	235±0,4	11,4	4,3	50	-67	QLCC 6/8-1	2	6
ФПА1-244-4	244±0,3	3,6	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-245-12	245±0,4	11,6	4,3	50	-67	QLCC 6/8-1	2	6
ФПА1-246-5	246,5±0,3	4,9	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-247-5	247±0,3	4,9	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-248-12	248±0,4	11,6	4,3	50	-67	QLCC 6/8-1	2	6
ФПА1-248-4	247,8±0,3	3,6	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-251-4А	251,25±0,3	3,7	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-251-4Б	251,25±0,3	3,7	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-251-5	251,25±0,3	5,1	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-252-4	252±0,3	3,5	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-254-4А	253,75±0,3	3,7	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-254-4Б	253,9±0,3	3,7	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-254-5	253,75±0,3	5,2	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-255-12	255±0,4	12,0	4,3	50	-67	QLCC 6/8-1	2	6
ФПА1-256-4	256±0,3	3,7	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-256-4А	256,25±0,3	3,8	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-256-4Б	256,25±0,3	3,8	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-256-5	256,25±0,3	5,3	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-259-4А	258,75±0,3	3,8	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-259-4Б	258,75±0,3	3,8	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-259-5	258,75±0,3	5,4	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-260-21	260±0,6	20,0	5,5	50	-67	QLCC 6/8-1	2	8
ФПА1-260-4	260±0,3	3,7	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-261-4А	261,25±0,3	3,8	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-261-4Б	261,25±0,3	3,8	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-261-6	261,25±0,3	5,5	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-264-4	264±0,3	3,8	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-264-4А	263,75±0,3	3,9	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-264-4Б	263,75±0,3	3,9	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-264-6	263,75±0,3	5,6	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-265-13	265±0,4	13,0	4,3	50	-67	QLCC 6/8-1	2	6
ФПА1-266-4А	266,25±0,3	3,9	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-266-4Б	266,25±0,3	3,9	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-266-6	266,25±0,3	5,7	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-268-4	268±0,3	3,8	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-269-4А	268,75±0,3	3,9	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-269-4Б	268,75±0,3	3,9	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-269-6	268,75±0,3	5,7	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-271-4А	271,25±0,3	4,0	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-271-4Б	271,25±0,3	4,0	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-271-7	271,25±0,3	6,4	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-272-4	272±0,3	4,0	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-274-4А	273,75±0,3	4,0	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-274-4Б	273,75±0,3	4,0	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-274-7	273,75±0,3	6,5	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-275-13	275±0,4	13,1	4,3	50	-67	QLCC 6/8-1	2	6
ФПА1-276-4	276±0,3	3,8	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФПА1-276-4А	276,25±0,3	4,1	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-276-4Б	276,25±0,3	4,1	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-276-7	276,25±0,3	6,6	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-279-4А	278,75±0,3	4,1	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-279-4Б	278,75±0,3	4,1	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-279-7	278,75±0,3	6,6	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-280-23	280±0,6	22,6	5,5	50	-67	QLCC 6/8-1	2	8
ФПА1-280-4	280±0,3	4,1	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-281-4А	281,25±0,3	4,1	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-281-4Б	281,25±0,3	4,1	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-281-7	281,25±0,3	6,7	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-282-4	282±0,3	4,0	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-284-4	284±0,3	4,2	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-284-4А	283,75±0,3	4,2	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-284-4Б	283,75±0,3	4,2	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-284-7	283,75±0,3	6,7	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-285-14	285±0,4	13,5	4,4	50	-67	QLCC 6/8-1	2	6
ФПА1-285-4	285±0,3	4,2	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-286-4	286±0,3	4,3	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-286-4А	286,25±0,3	4,2	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-286-4Б	286,25±0,3	4,2	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-286-7	286,25±0,3	6,8	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-288-4	288±0,3	4,2	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-289-4А	288,75±0,3	4,2	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-289-4Б	288,75±0,3	4,2	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-289-7	288,75±0,3	6,8	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-300-5	300,00±0,3	4,6	4,5	40	-40	QLCC 6/8-1	1	12
ФПА1-300-5Б	299,8±0,3	5,0	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-304-10	303,8±0,4	10,3	5,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	3
ФПА1-306-3	306,00±0,3	2,8	4,0	40	-40	QLCC 6/8-1	1	12
ФПА1-306-5	306,00±0,3	4,7	4,5	40	-40	QLCC 6/8-1	1	12
ФПА1-311-5А	311,25±0,4	4,6	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-311-5Б	311,25±0,4	4,6	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-311-8	311,25±0,4	7,5	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-314-5А	313,75±0,4	4,6	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-314-5Б	313,75±0,4	4,6	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-314-8	313,75±0,4	7,5	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-316-5А	316,25±0,4	4,7	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-316-5Б	316,25±0,4	4,7	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-316-8	316,25±0,4	7,5	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-319-5А	318,75±0,4	4,7	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-319-5Б	318,75±0,4	4,7	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-319-8	318,75±0,4	7,6	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-321-5А	321,25±0,4	4,7	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-321-5Б	321,25±0,4	4,7	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-321-8	321,25±0,4	7,6	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-324-5А	323,75±0,4	4,8	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-324-5Б	323,75±0,4	4,8	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-324-8	323,75±0,4	7,7	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-326-5А	326,25±0,4	4,8	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-326-5Б	326,25±0,4	4,8	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-326-8	326,25±0,4	7,7	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-329-5А	328,75±0,4	4,9	2,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-329-5Б	328,75±0,4	4,9	3,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-329-8	328,75±0,4	7,7	3,0	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9



1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФПА1-332-5	332±0,4	4,9	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-336-5	336,00±0,3	4,9	4,5	40	-40	QLCC 6/8-1	1	12
ФПА1-342-6	342,00±0,4	5,3	4,5	40	-40	QLCC 6/8-1	1	12
ФПА1-360-16	360±0,5	15,5	4,5	45	-65	QLCC 6/8-1	1	10
ФПА1-365-32	365±0,7	32,8	6,0	50	-67	QLCC 6/8-1	2	8
ФПА1-367-6	367,4±0,4	5,7	3,5	40	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-381-6А	381,5±0,4	5,6	3,0	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-381-6Б	381,5±0,4	5,6	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-381-9	381,5±0,4	9,1	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-384-10	384,3±0,4	9,2	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-384-6А	384,2±0,4	5,6	3,0	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-384-6Б	384,3±0,4	5,6	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-386-6Б	386±0,4	5,7	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-387-10	387±0,4	9,3	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-387-6А	387±0,4	5,7	3,0	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-387-6Б	387±0,4	5,7	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-390-10	390±0,4	9,3	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-390-6А	390±0,4	5,8	3,0	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-390-6Б	390±0,4	5,8	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-393-10	393±0,4	9,4	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-393-6А	393±0,4	5,8	3,0	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-393-6Б	393±0,4	5,8	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-396-10	395,7±0,4	9,4	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-396-6А	395,7±0,4	5,8	3,0	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-396-6Б	395,7±0,4	5,8	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-399-10	398,5±0,4	9,5	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-399-6А	398,5±0,4	5,8	3,0	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-399-6Б	398,5±0,4	5,8	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-401-10	401,4±0,5	9,5	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-401-14	400,7±0,5	12,6	5,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	3
ФПА1-401-6Б	401,4±0,5	5,9	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-401-8	401±0,5	7,2	3,5	50	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-402-38	402,0 0,7	38,0	7,0	50	-67	QLCC 6/8-1	2	8
ФПА1-404-10	404±0,5	9,6	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-404-6Б	404,3±0,5	5,9	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-404-8	404±0,5	7,3	3,5	50	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-405-6Б	405±0,5	5,9	3,8	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-406-14	406±0,5	12,8	5,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	3
ФПА1-406-6А	406±0,5	5,9	3,0	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-406-6Б	406±0,5	5,9	3,8	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-407-10	407±0,5	9,6	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-407-6А	407±0,5	5,9	3,0	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-407-6Б	407±0,5	6,0	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-407-8	407±0,5	7,4	3,5	50	-40	QLCC 6/8-1	1	8
ФПА1-408-6	408±0,5	6,0	3,8	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-409-6	409±0,5	6,0	3,8	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-410-10	410±0,5	9,7	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-410-6Б	410±0,5	6,0	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-410-8	410±0,5	7,4	3,5	50	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-413-10	413±0,5	9,7	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-413-6Б	413±0,5	6,0	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-413-8	413±0,5	7,5	3,5	50	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-414-14	413,7±0,5	13,2	5,5	28	-75	QLCC 6/8-1	1	3
ФПА1-416-10	416±0,5	9,7	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-416-6Б	415,7±0,5	6,1	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2












1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФПА1-416-8	416±0,5	7,5	3,5	50	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-419-10	418,5±0,5	9,8	3,3	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-419-6Б	418,6±0,5	6,1	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-419-8	419±0,5	7,5	3,5	50	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-420-7Б	420±0,5	6,2	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-422-9	422,3±0,5	8,2	3,5	50	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-430-6	430±0,5	6,2	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-431-6	431±0,5	6,2	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-432-6Б	432±0,5	6,2	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-434-6	434±0,5	6,2	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-434-7А	433,9±0,5	7,5	3,0	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-436-6Б	436±0,5	6,4	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-440-6	440±0,5	6,3	3,8	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-459-6А	459±0,5	6,5	3,0	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-459-6Б	459±0,5	6,6	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-460-6А	460±0,5	6,5	3,0	28	-75	QLCC 6/8-1	1	1
ФПА1-460-6Б	460±0,5	6,6	3,5	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-486-13	486,3±0,5	12,5	3,5	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-489-8	489,0±0,5	7,5	4,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-490-12	490±0,5	11,4	3,5	45	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-490-8	490±0,5	7,5	4,0	50	-75	QLCC 6/8-1	1	2
ФПА1-500-11	500±0,6	10,4	4,0	50	-40	QLCC 6/8-1	1	9
ФПА1-518-13	518,4±0,6	12,4	4,5	50	-40	QLCC 6/8-1	1	9

За подробной информацией обращаться тел. (3812) 588-409.






## ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

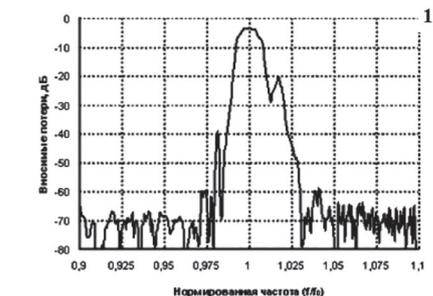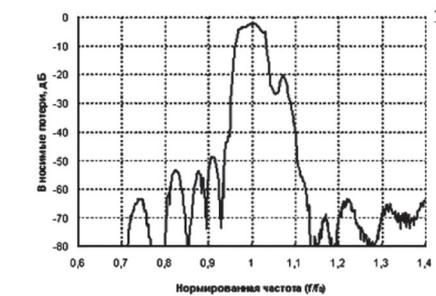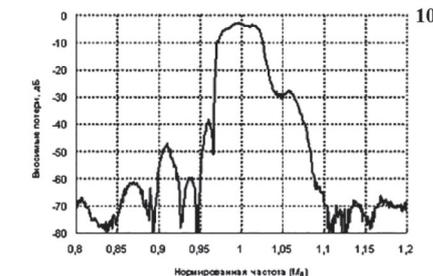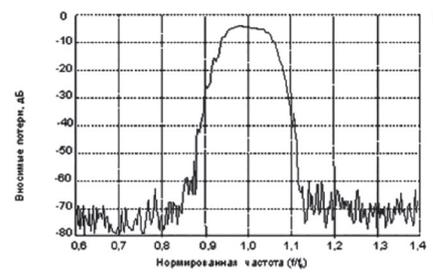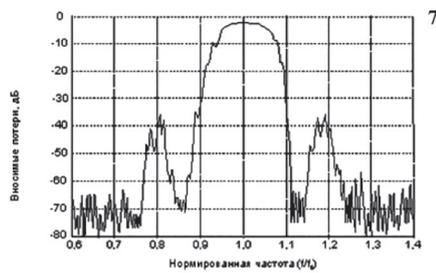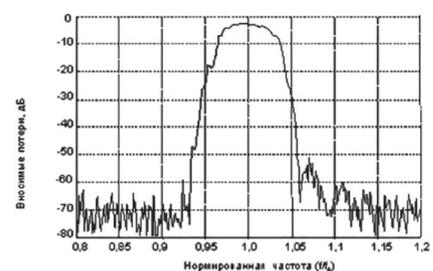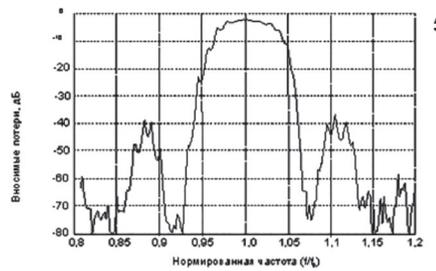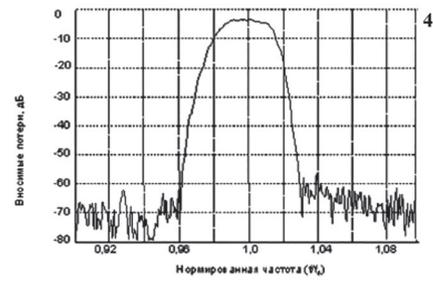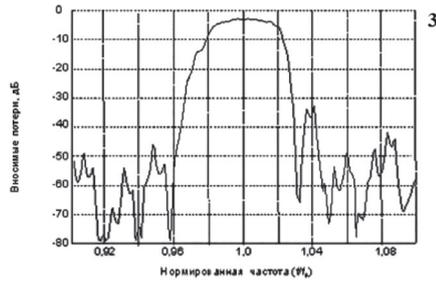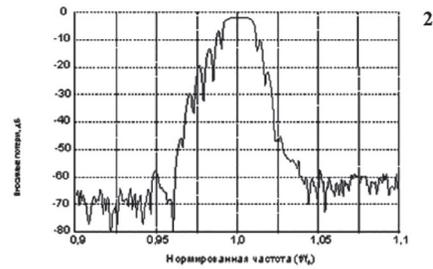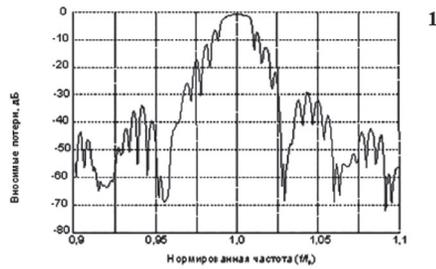



# ПАВ-МИКРОСБОРКИ

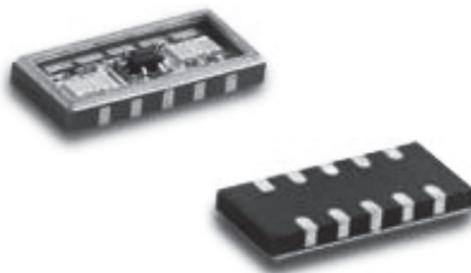

## МИКРОСБОРКА 04КП015


### НАЗНАЧЕНИЕ:

Микросборка 04КП015 предназначена для использования в качестве электронного четырехканального коммутатора высокочастотных сигналов.

### Гарантируемые электрические параметры


Минимальное вносимое затухание каждого канала микросборки в открытом состоянии, дБ	Напряжение управления, В	Ток потребления, мА	Диапазон частот, МГц
0,5	5	5	130-500
35	0	0	130-500

### Схема включения

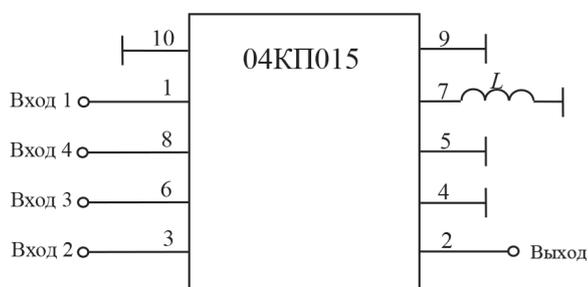

$L$  – индуктивность В82498F3561J

### Тип корпуса QLCC 10/10-1

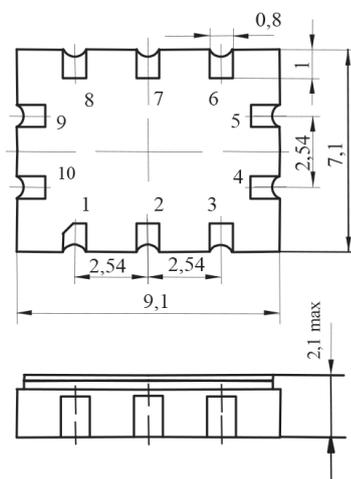

### ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Повышенная рабочая температура - не более 55 °С;  
Пониженная рабочая температура - не менее минус 20 °С.

Масса микросборки не более 0,5 г

Номер вывода	Назначение вывода	Рекомендации и по включению
1	Вход 1	
2	Выход	
3	Вход 2	
4	Корпус	Заземлить
5	Корпус	Заземлить
6	Вход 3	
7	Выход	
8	Вход 4	
9	Корпус	Заземлить
10	Корпус	Заземлить

За подробной информацией обращаться тел. (3812) 588-409

## МИКРОСБОРКА 04ХА042

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Микросборка 04ХА042 предназначена для использования в качестве частотно-избирательных звеньев многоканальных частотно-селективных устройств с фильтрами на ПАВ на частоты от 200 до 500 МГц. Микросборка представляет собой функциональный элемент тракта преселектора радиоприемного устройства, выполненный по схеме «коммутатор – фильтр – усилитель – фильтр – коммутатор».

### Гарантируемые электрические параметры

Центральная частота, $f_0$ , МГц	200-500
Полоса $\Delta f$ , по уровню -2дБ, МГц	2,5-2,86
Усиление, дБ	14
Подавление <sup>1</sup> , дБ	90
Интермодуляц избирательность по 3-му порядку <sup>2</sup> , дБмкВ	63
Интермодуляц избирательность по 2-му порядку <sup>3</sup> , дБмкВ	90
Максимальные пульсации АЧХ в полосе пропускания, дБ	2
ТКЧ 10%/°С	-40


<sup>1</sup> при частотной отстройке  $\pm 5\%$  и более от  $f_0$   
<sup>2</sup> для сигналов помех в полосе пропускания:  $f_{n1} = F_n + 0,5$  МГц,  $f_{n2} = F_n + 1,0$  МГц  
<sup>3</sup> для сигналов помех:  $f_{n1} = 100,0$  МГц,  $f_{n2} = (F_n + 1,25$  МГц) - 100,0 МГц;  
 где  $F_n$  – нижняя частота среза полосы пропускания измеряемой микросборки в условиях воздействия климатических факторов

Масса микросборки не более 0,8 г  
 Содержание драгоценных металлов: золото (проволока) 0,00224 г


### Предельные значения режимов эксплуатации

Наименование параметра	Норма	
	не менее	не более
Напряжение питания, В	4	6
Ток потребления, мА	16	26
Коэффициент усиления, дБ	12	16
Повышенная рабочая температура	-	55°C
Пониженная рабочая температура	минус 20°C	-

### Тип корпуса DLCC 10/10


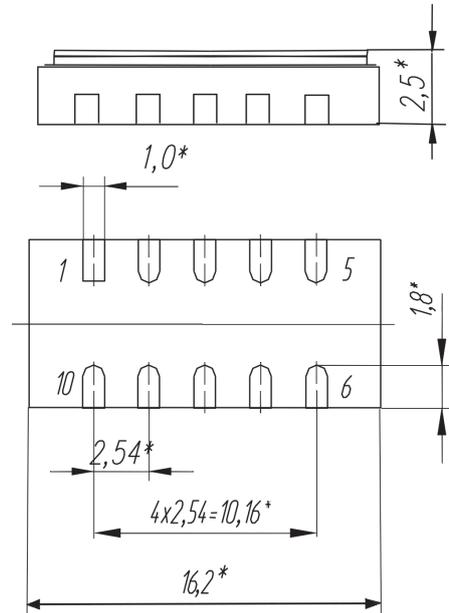


### Схема включения

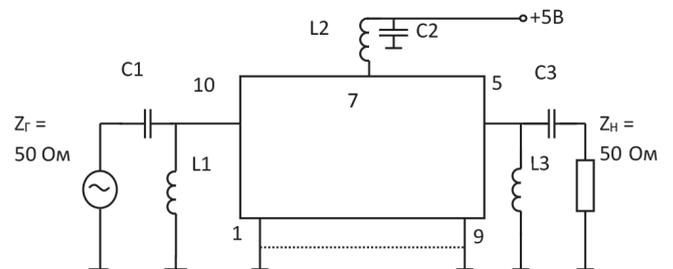

C1 ... C3 Керамические ЧИП-конденсаторы NPO 1000 пФ  $\pm 5\%$ .  
 L1 ... L3 Индуктивности высокочастотные B82498-F3561-K (560 нГн  $\pm 5\%$ ).

### Типовые нормированные частотные характеристики

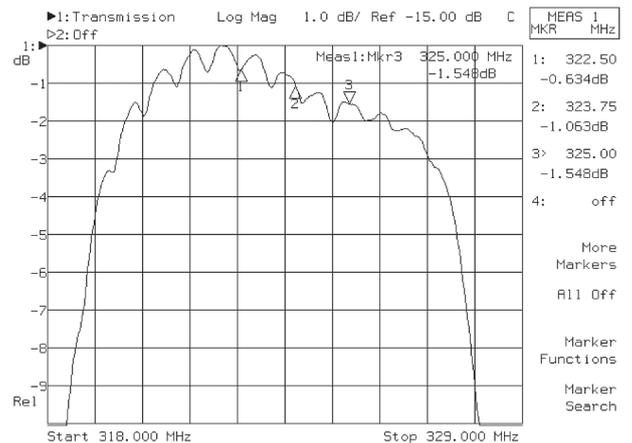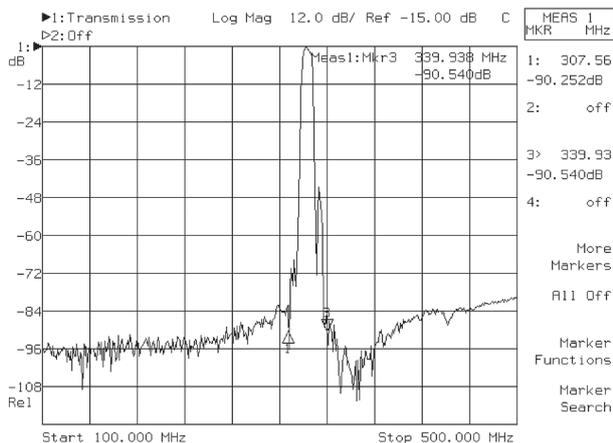



# НАБОРЫ ЭТАЛОННЫХ МЕР СВЧ ДИАПАЗОНА

## НАБОР МЕР КСВН И ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 1 РАЗРЯДА ЭК9-140



ТУ 4381-080-02566540-2007

Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.35.007.A № 29393/1, внесен в государственный реестр средств измерений под № 36021-07.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Набор мер КСВН и полного сопротивления 1 разряда ЭК9-140 предназначен для настройки и поверки измерителей модуля коэффициента передачи и отражения (приборы вида Р2), полного сопротивления (приборы вида Р3) и комплексного коэффициента передачи и отражения (приборы вида Р4) с соединителями типа III ГОСТ 13317 и ГОСТ РВ 51914, а также для измерения параметров четырехполюсников в радиоизмерительной, антенной технике и технике СВЧ в лабораторных и цеховых условиях.

Набор мер состоит из нагрузок и фазосдвигающих отрезков. Каждая нагрузка может использоваться как мера КСВН или как мера полного сопротивления.



ЭК9-140

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА МЕР	Значение характеристики
Диапазон рабочих частот, ГГц	0...4,0
Волновое сопротивление мер, Ом	50
Габаритные размеры набора мер в футляре, мм	330x280x110
Масса набора мер в футляре, кг	4,5

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗОК:

Тип нагрузки	КСВН	Погрешность КСВН, %	Погрешность фазы, градус
Э9-140	1,2±0,050	±1,0	±2,0
Э9-141	1,4±0,050	±1,0	±1,5
Э9-142	1,4±0,050	±1,0	±1,5
Э9-143	2,0±0,050	±1,5	±1,0
Э9-144	2,0±0,050	±1,5	±1,0
Э9-159	1,0±0,025	±1,0	Не нормируется
Э9-160	3,0±0,100	±2,0	±1,0
Э9-161	3,0±0,100	±2,0	±1,0

### ДЛИНЫ КОАКСИАЛЬНЫХ ОТРЕЗКОВ:

Тип отрезка	Длина отрезка, мм	
	Номин.	Пред. откл.
Э2-146	37,5	-0,015
Э2-147	46,9	
Э2-148	56,3	
Э2-149	75,0	

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Наименование	Количество
Нагрузка Э9-140	1 шт.
Нагрузка Э9-141	1 шт.
Нагрузка Э9-142	1 шт.
Нагрузка Э9-143	1 шт.
Нагрузка Э9-144	1 шт.
Нагрузка Э9-159	1 шт.
Нагрузка Э9-160	1 шт.
Нагрузка Э9-161	1 шт.
Отрезок коаксиальный Э2-146	1 шт.
Отрезок коаксиальный Э2-147	1 шт.
Отрезок коаксиальный Э2-148	1 шт.
Отрезок коаксиальный Э2-149	1 шт.
Игла	4 шт.
Ключ тарированный	1 шт.
Футляр	1 шт.
Руководство по эксплуатации МКСН.411928.001 РЭ	1 экз.
Свидетельство о поверке	1 экз.
Методика поверки МКСН.411928.001 Д	1 экз.
Примечание – По заявке потребителя возможна поставка отдельных нагрузок и отрезков коаксиальных из набора мер.	



**644009, г. Омск, ул.Лермонтова,175**

**Тел.: (3812) 36-79-18**

**E-mail: [fgup@omsketalon.ru](mailto:fgup@omsketalon.ru)**

**[omsketalon.ru](http://omsketalon.ru)**